
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\EDUV20241014 162826.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2024-10-14 16:29:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-02-14 14:18:27-03:00		

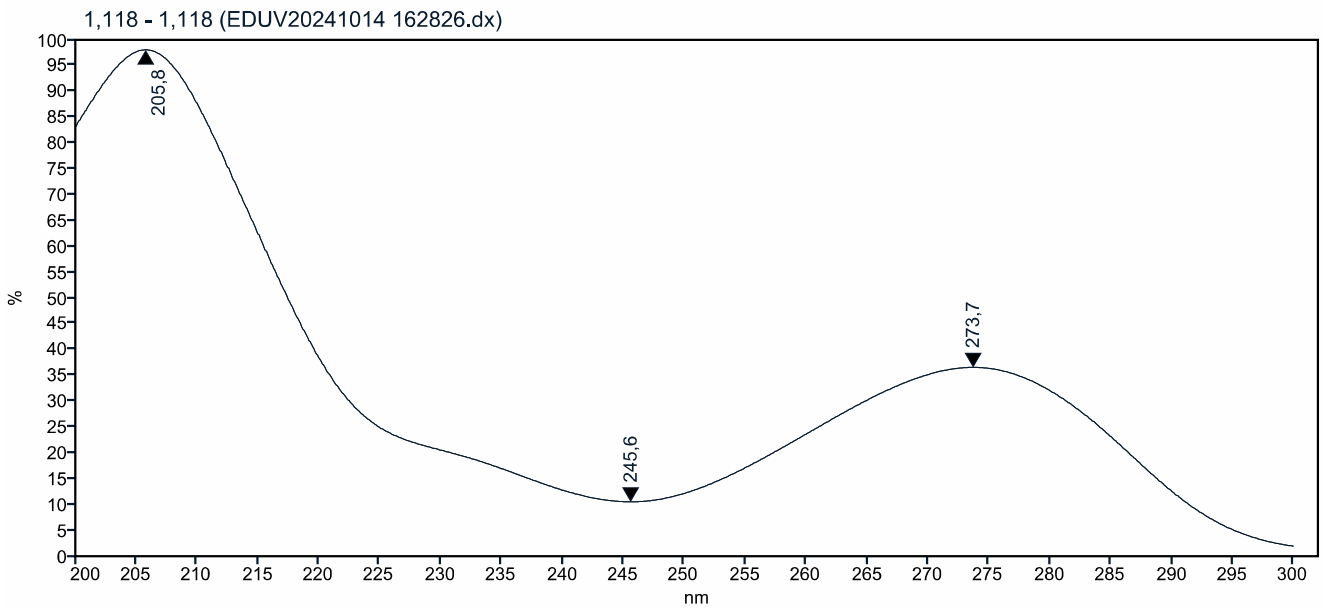

Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
EDUV		1,118	256,9863	66,946		