
# Relatório de Injeção Única

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Gradiente20241015 154644.rslt\Gradiente CD20241015 160747.dx | | |
| **Nome da amostra:** | Gradiente CD | | |
| **Descrição:** | | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P2-A2 |
| **Data da injeção:** | 2024-10-15 16:08:39-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Gradiente CD.amx | **Volume de injeção:** | 0,100 µL |
| **Método de análise:** | *GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2024-10-16 09:59:35-03:00 | | |

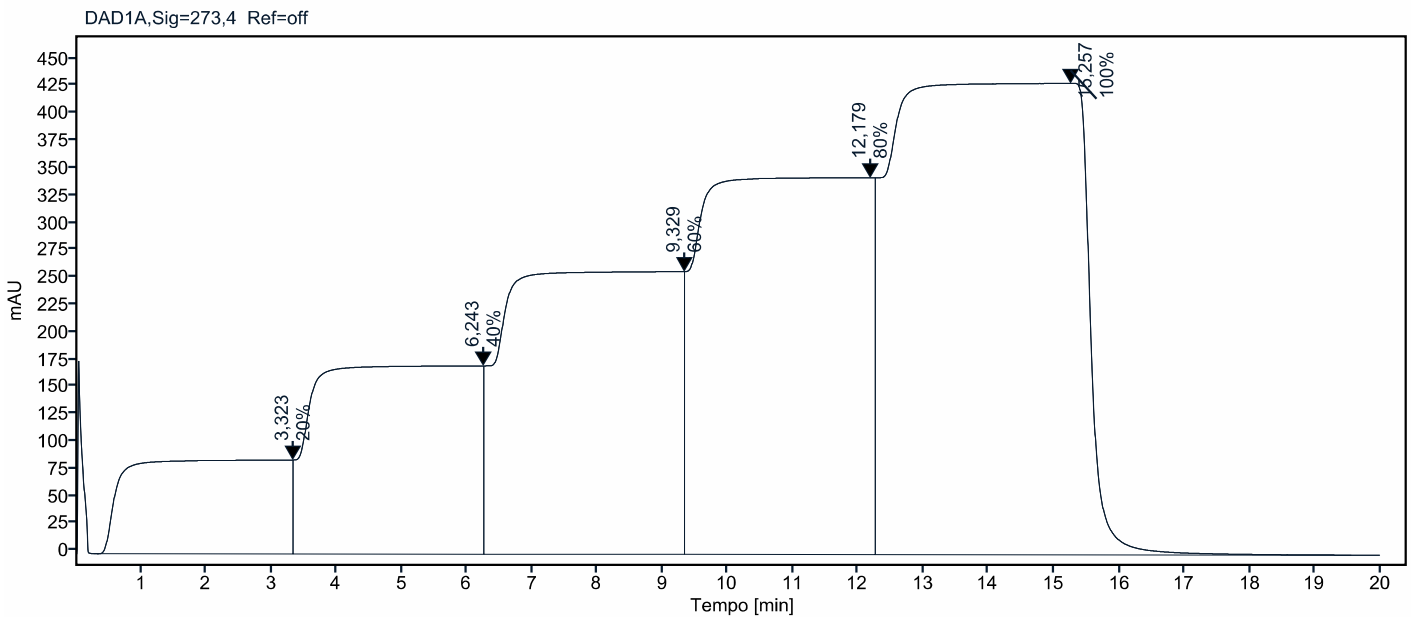


| Nome da Amostra | Nome | RT | Área | Altura | Ruído | Sinal-Ruído |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gradiente CD | 20% | 3,323 | 13995,7169 | 85,889 | | |
| Gradiente CD | 40% | 6,243 | 28805,3996 | 172,156 | | |
| Gradiente CD | 60% | 9,329 | 45886,2063 | 258,597 | | |
| Gradiente CD | 80% | 12,179 | 59153,9329 | 344,660 | | |
| Gradiente CD | 100% | 15,257 | 84623,2063 | 431,163 | | |