
Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\Gradiente AD20241016 084017.sirslt\Gradiente AD20241016 084017.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-16 08:41:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AD.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 09:17:13-03:00		

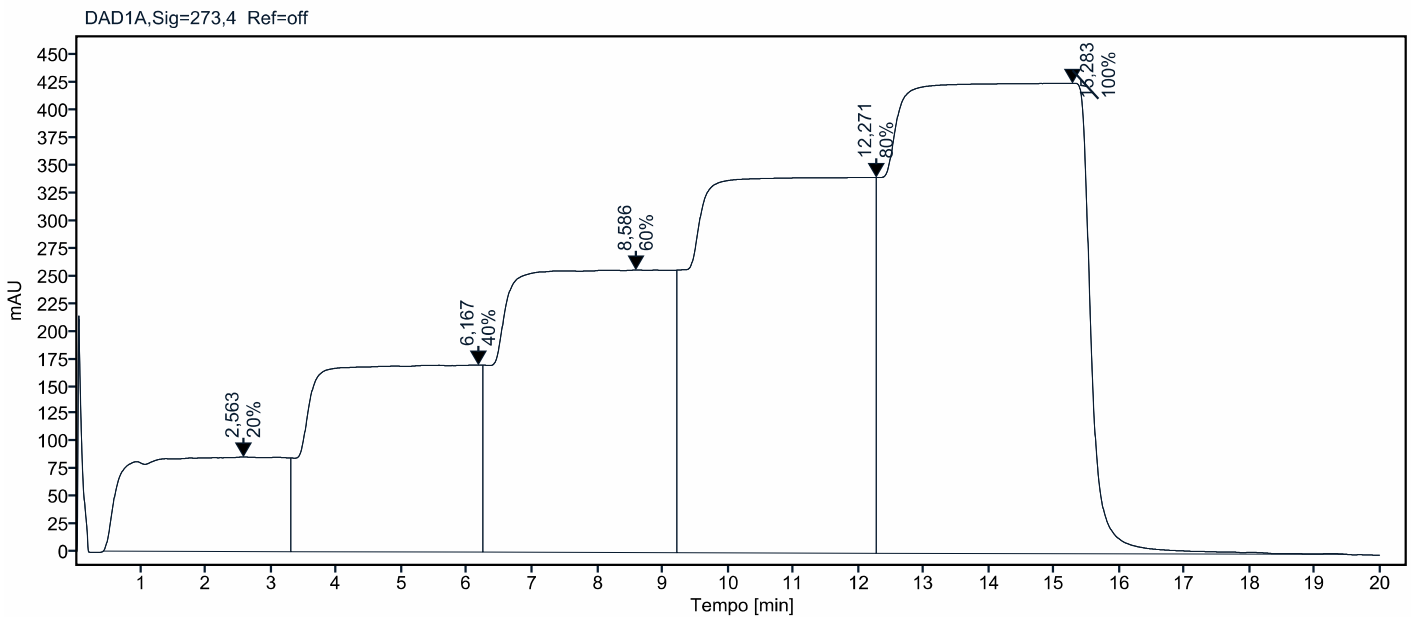

Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Gradiente AD	20%	2,563	13659,1597	85,734		
Gradiente AD	40%	6,167	28348,2793	169,716		
Gradiente AD	60%	8,586	43857,0954	256,240		
Gradiente AD	80%	12,271	60571,7527	340,740		
Gradiente AD	100%	15,283	83512,8165	426,589		