
Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\SINAL RUÍDO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\SINAL RUIDO2023-01-04 09-00-15 (GMT -03-00).rslt\SINAL RUIDO.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 09:01:23 (GMT -03:00)
Impresso: 07/01/2023 10:14:11 (GMT -03:00)

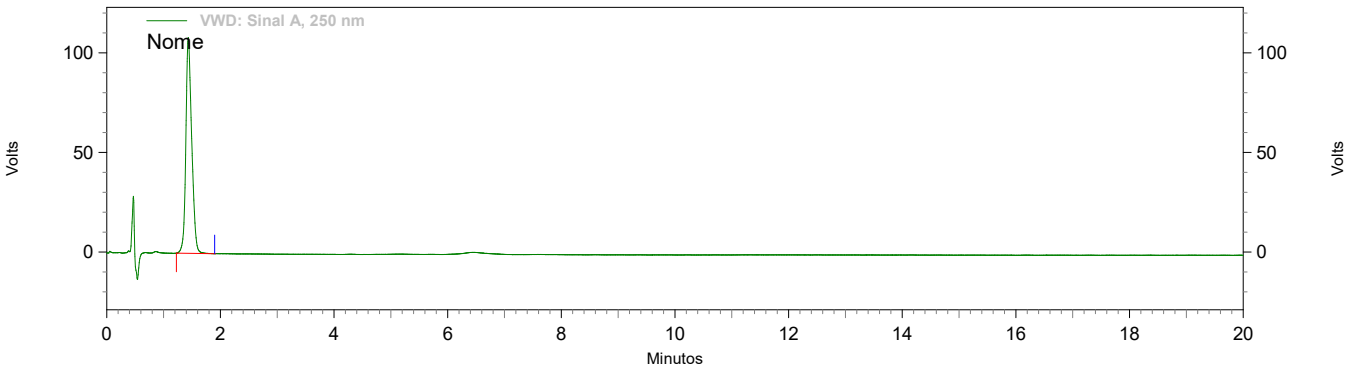


Resultados VWD:
Sinal A, 250 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*

Relatório SRELB

Detector VWD – G1314A – N/S JP73705923	Data: 04/01/2023
Ruído:	
Valor máximo: -1.61183 mAU	**Diferença: 0.01436 mAU**
Valor mínimo: -1.62619 mAU	

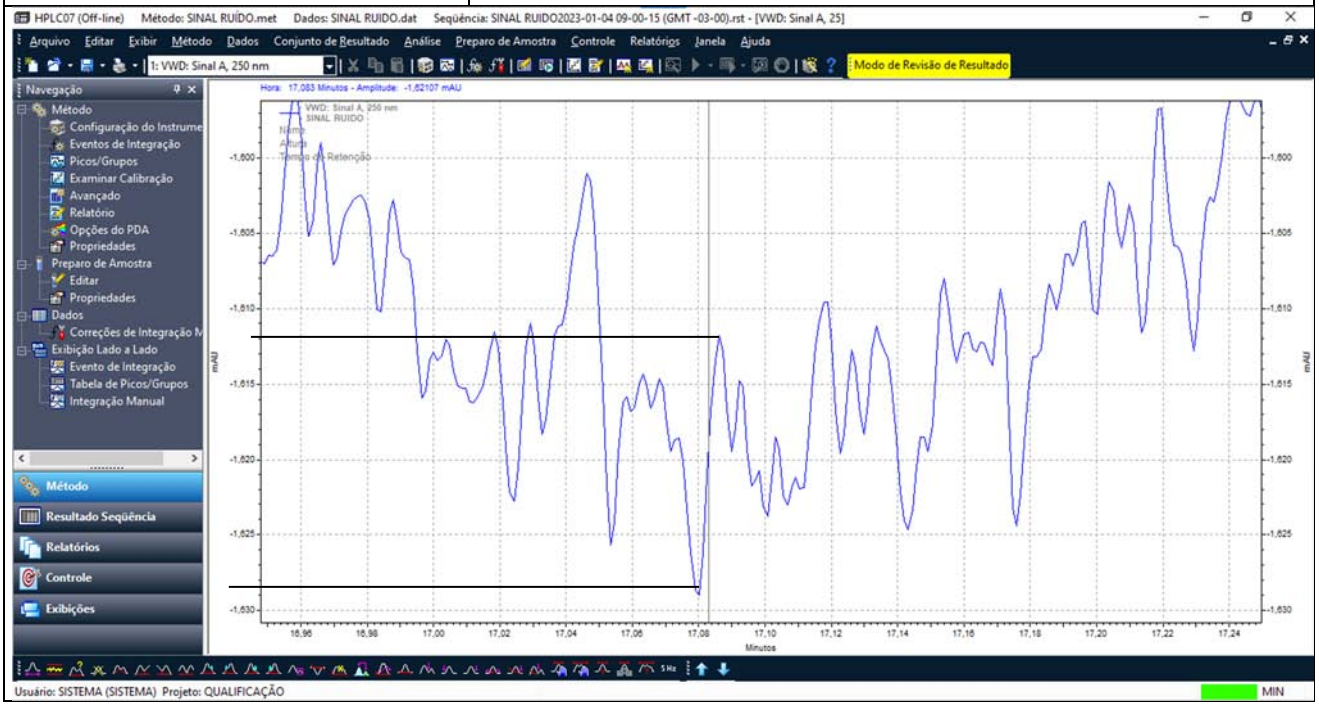

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


#

#

#

#

Estabilidade da Linha de Base:	
Valor máximo: -0.407517 mAU	**Diferença (em 20 minutos): 1.2334mAU**
Valor mínimo: -1.64098 mAU	**Diferença (em 60 minutos): 1.2334 x 3 = 3.7002 mAU**

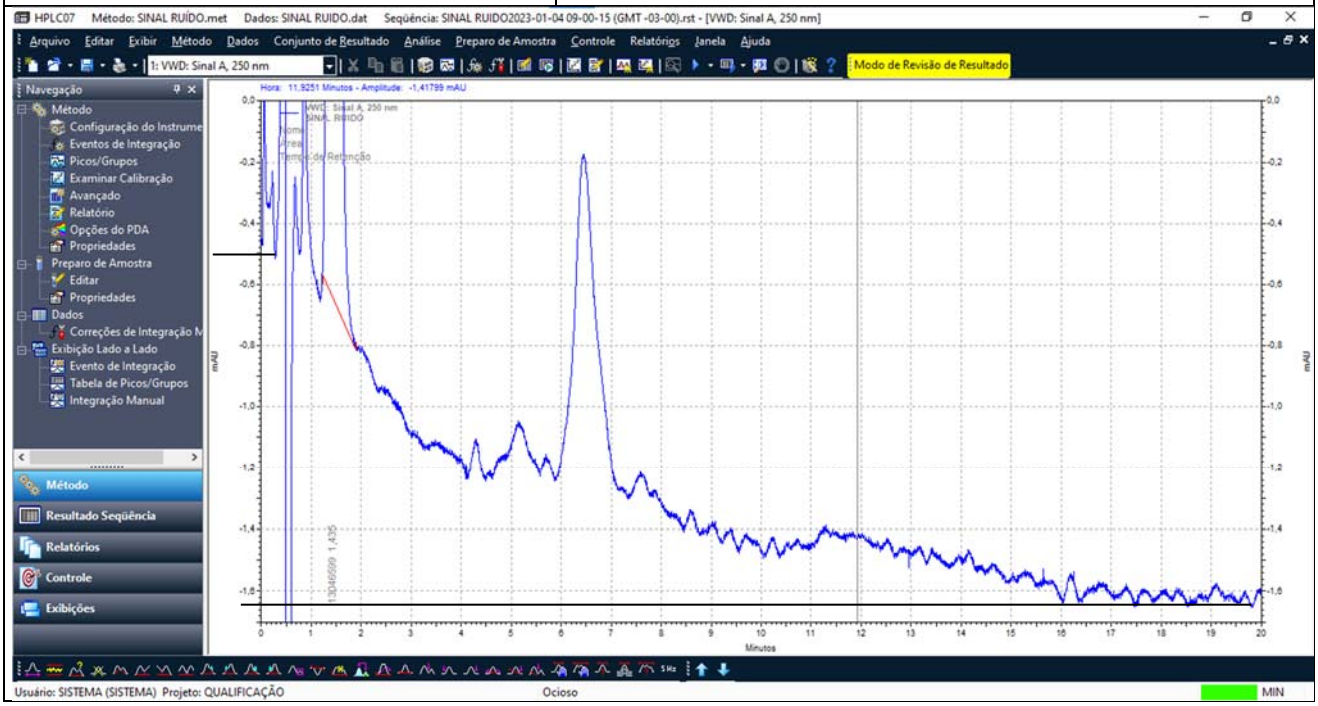

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


#

#

#

#

Altura do Pico:
Valor: 107.677 mAU

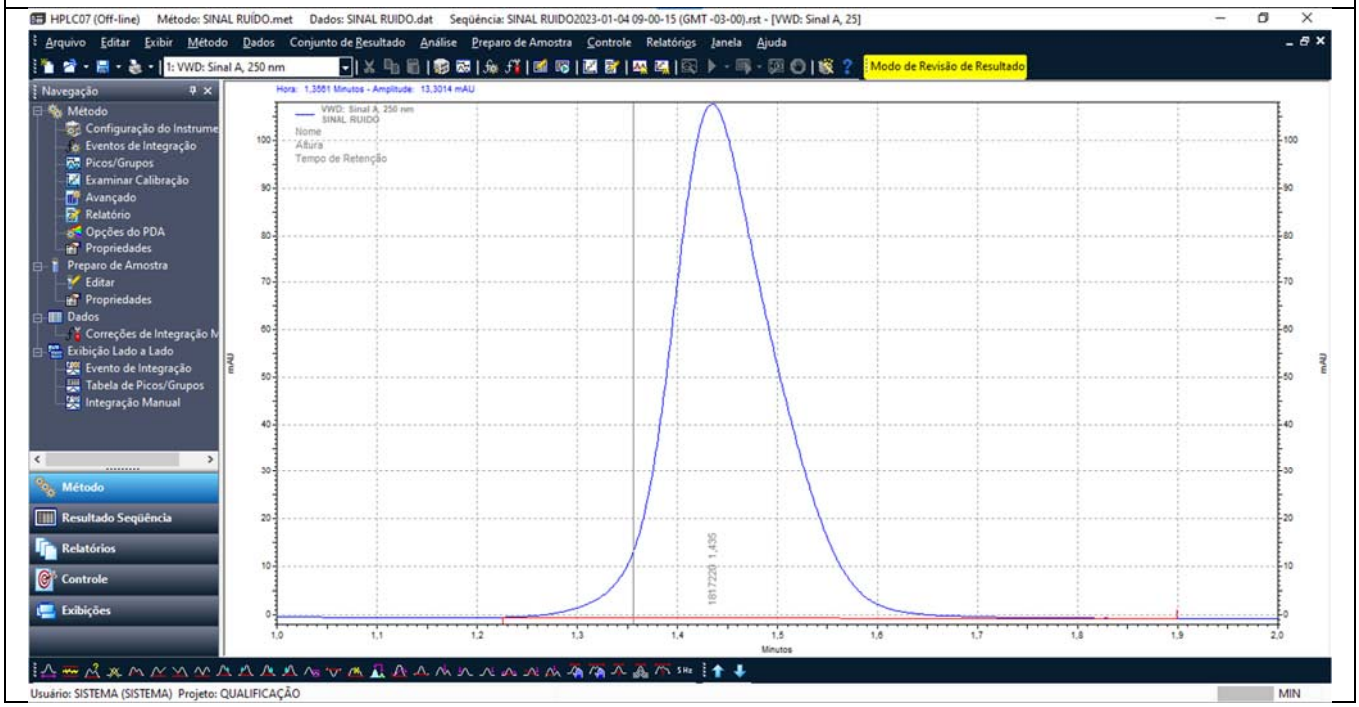

Zoetis 07 - Agilent Lab Advisor

Agilent Lab Advisor

Service & Diagnostics

Advanced Version

Tasks

Spectral Scan

Zoetis 07 » Zoetis 07 » G1314A:JP73705923

Lab Advisor

- System Overview
- Configuration
- Apps
- Firmware Update
- Logs & Results

Zoetis 07

- Service & Diagnostics
- Instrument Control
- EMFs
- System Report


Help

- Context Help (F1)
- Help Topics
- What's New?

Spectral Scan - VWD [JP73705923]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

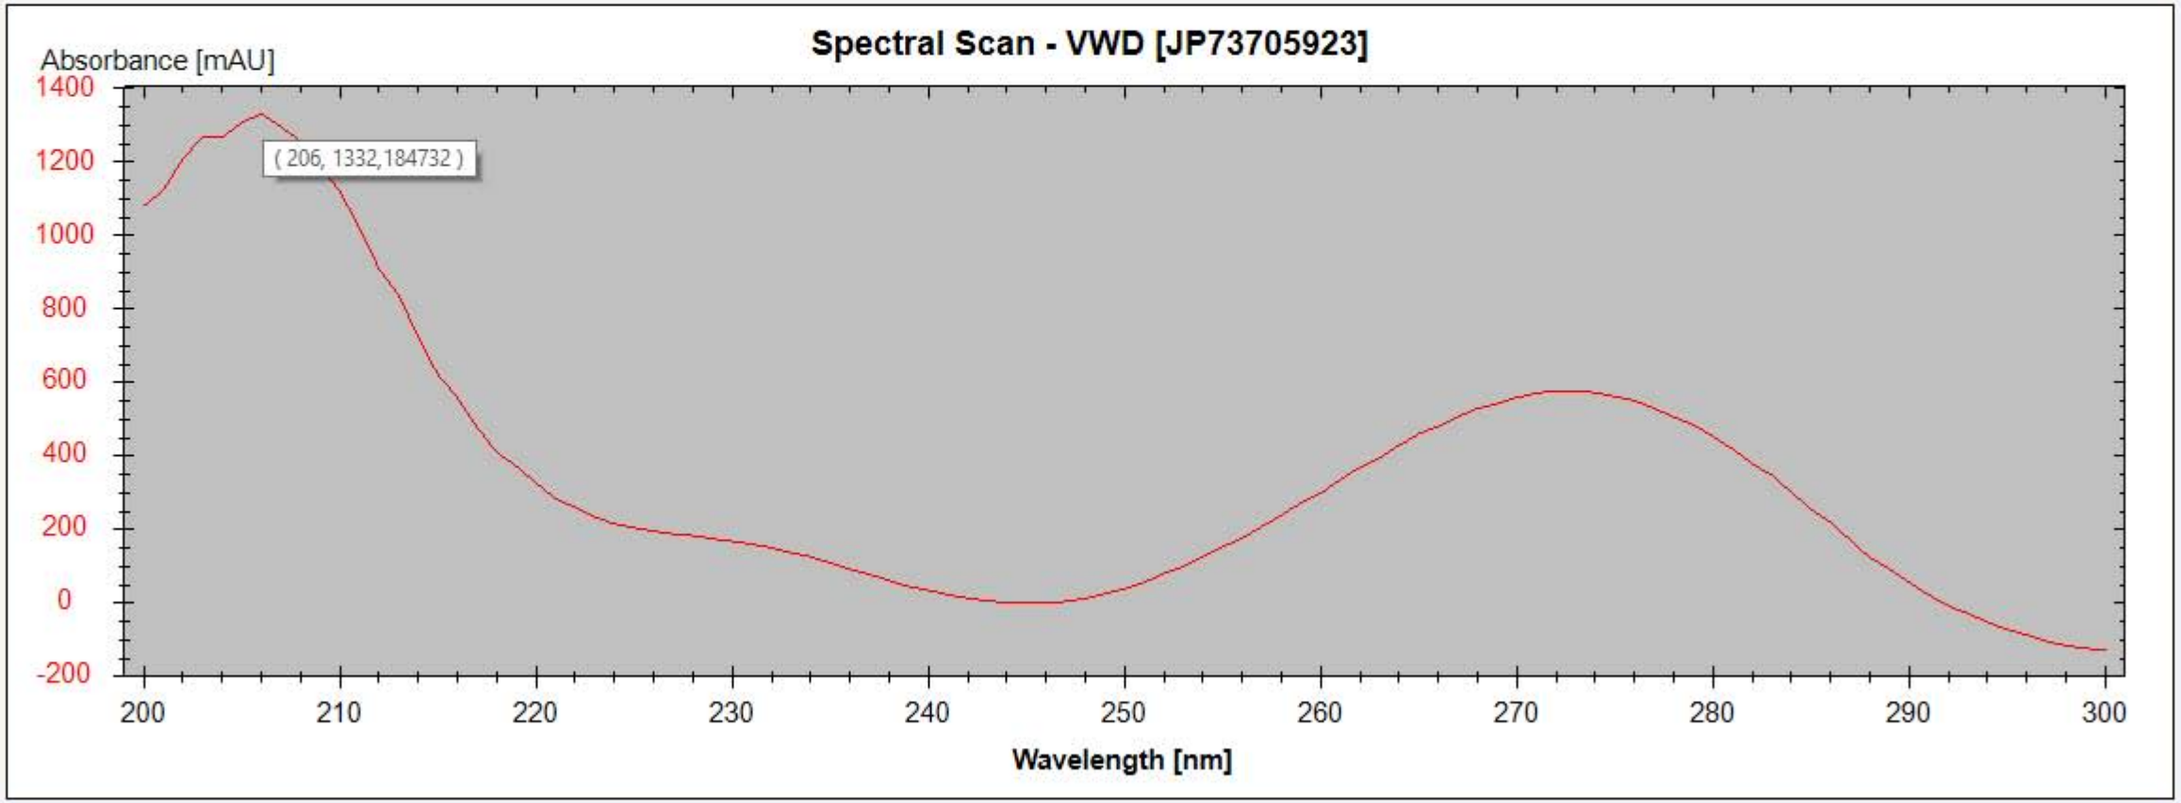

more... | Print Result | Back

Connection Address: 192.168.0.7


Version B.02.10 [253] SP1 - Advanced | Licenses 4/10

POR PTB2 10:00 04/01/2023

Spectral Scan - VWD [JP73705923]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

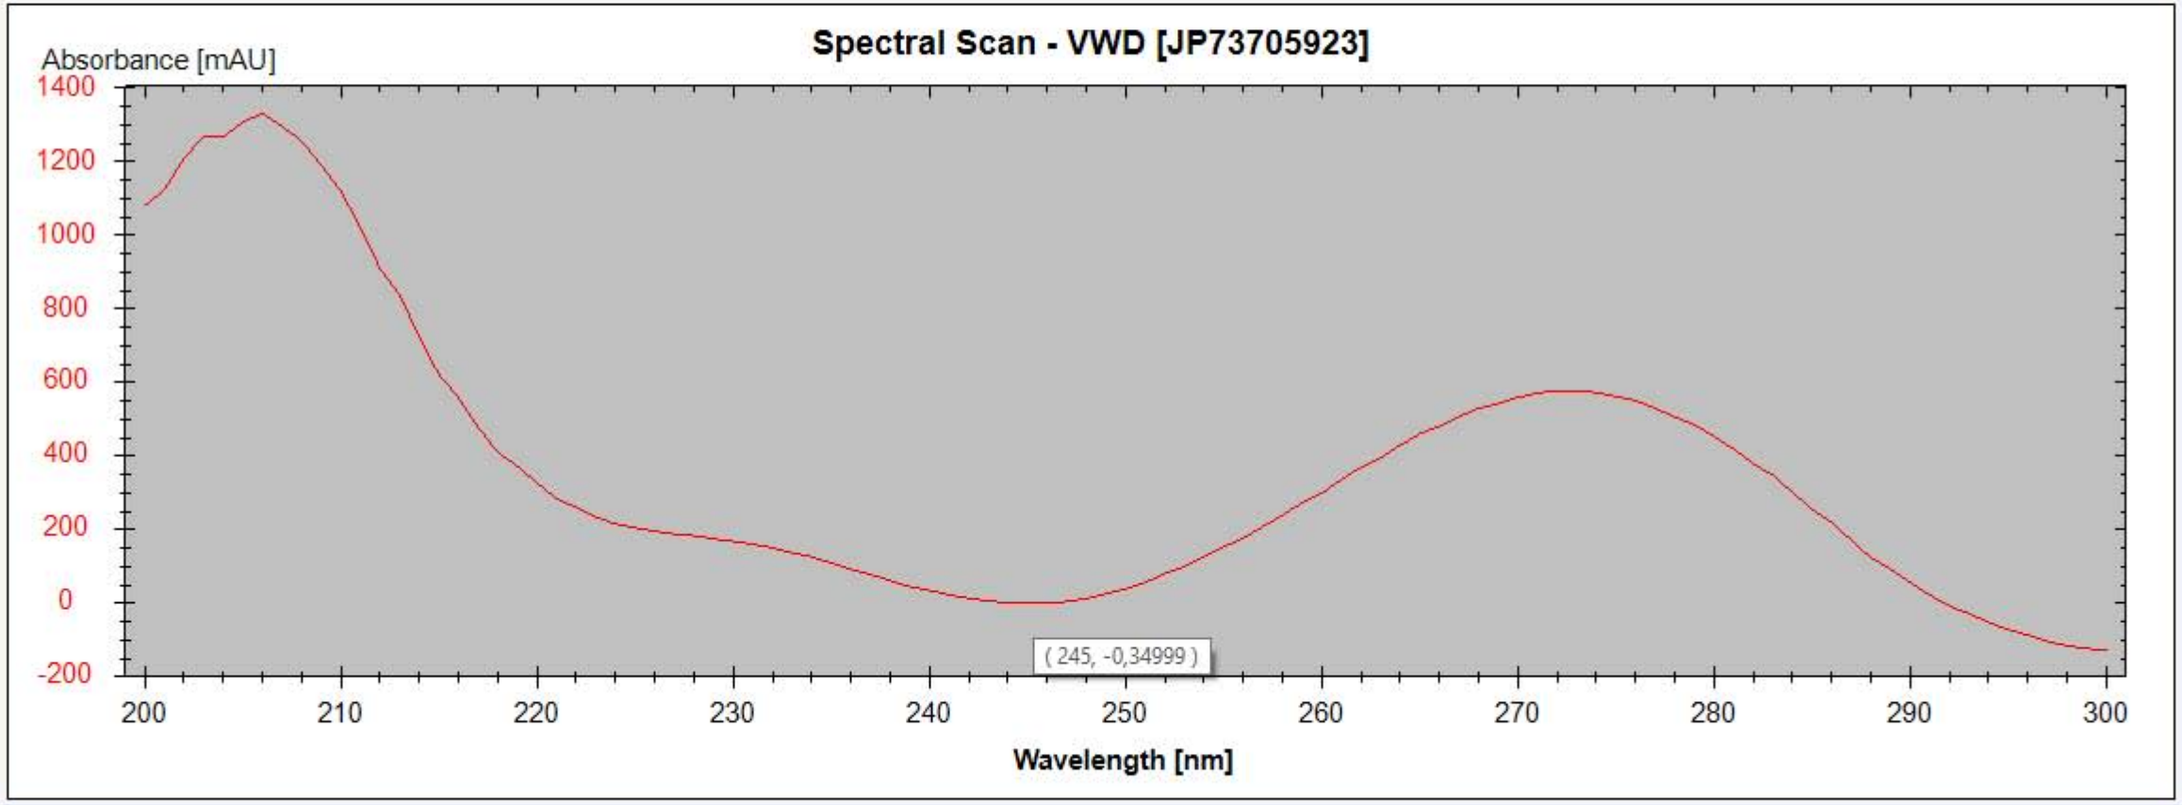

Tasks

Lab Advisor

System Overview

Configuration

Apps

Firmware Update

Logs & Results

Zoetis 07

Service & Diagnostics

Instrument Control

EMFs

System Report

Help

Context Help (F1)


Help Topics

What's New?

Spectral Scan - VWD [JP73705923]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

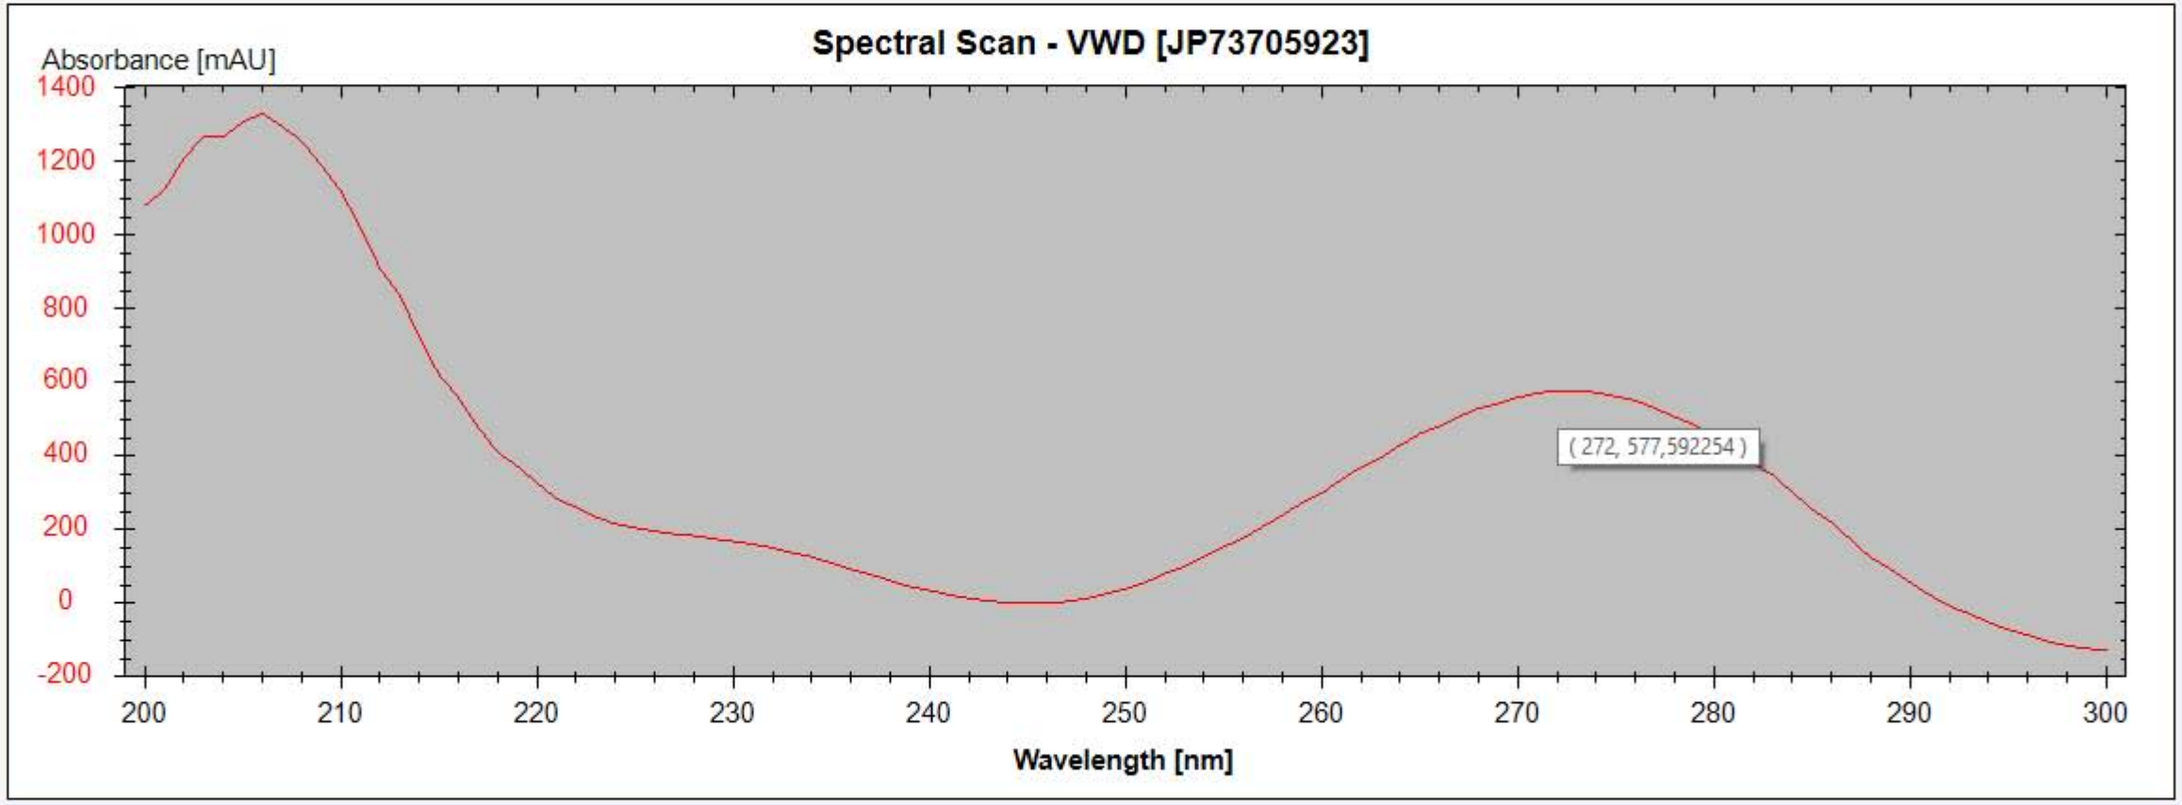

more... | Print Result | Back

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\Branco 01.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:32:01 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:50:36 (GMT -03:00)**

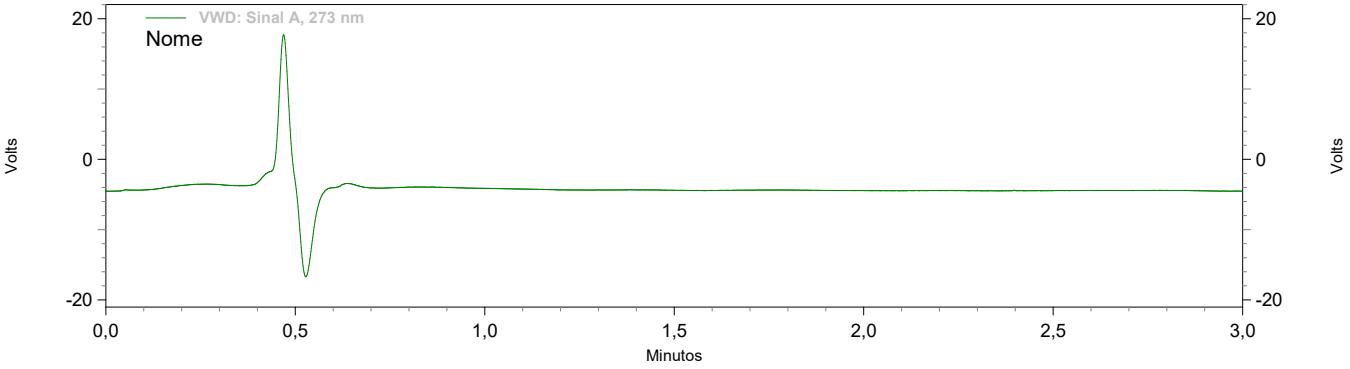


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:35:57 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:51:19 (GMT -03:00)**

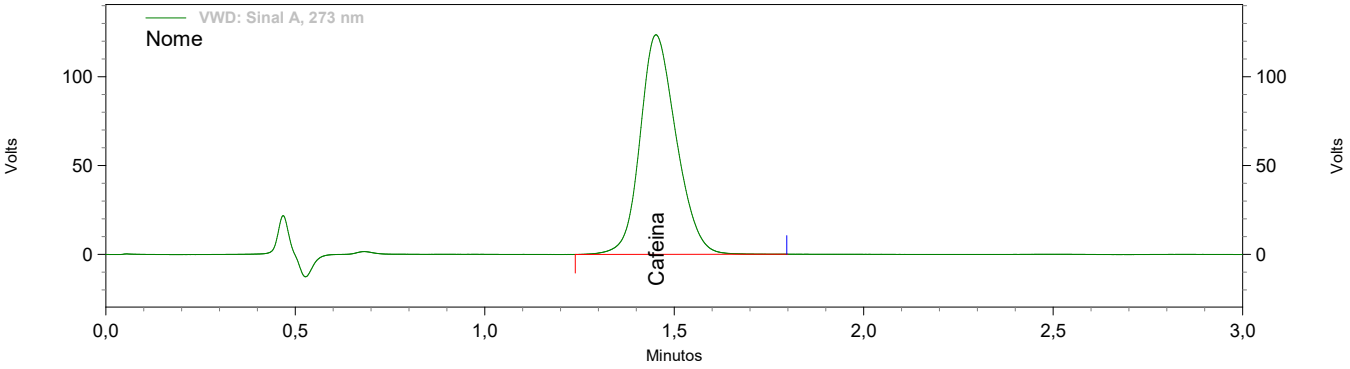


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,452	13754882	**0,000**

Totais			13754882	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:39:50 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:51:42 (GMT -03:00)**

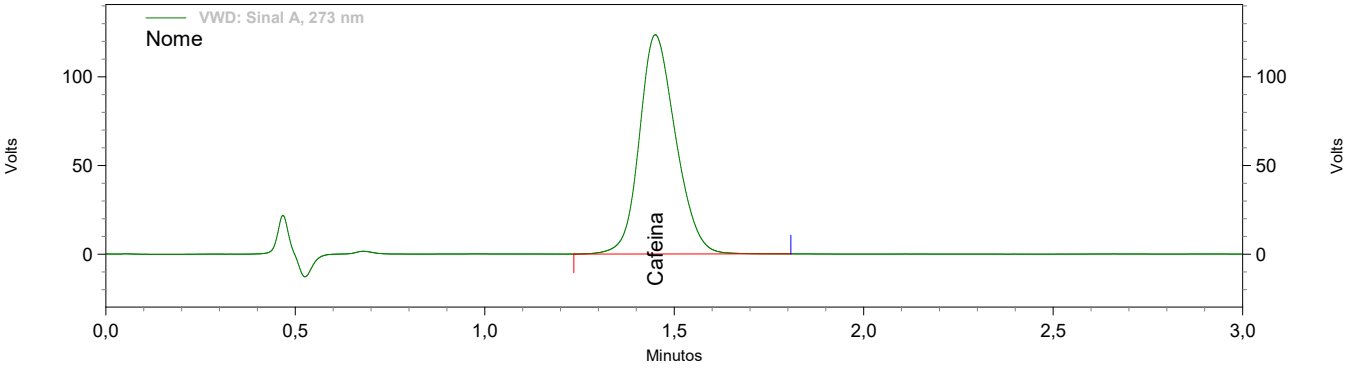


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,450	13813472	**0,000**

Totais			13813472	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:43:44 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:51:59 (GMT -03:00)**

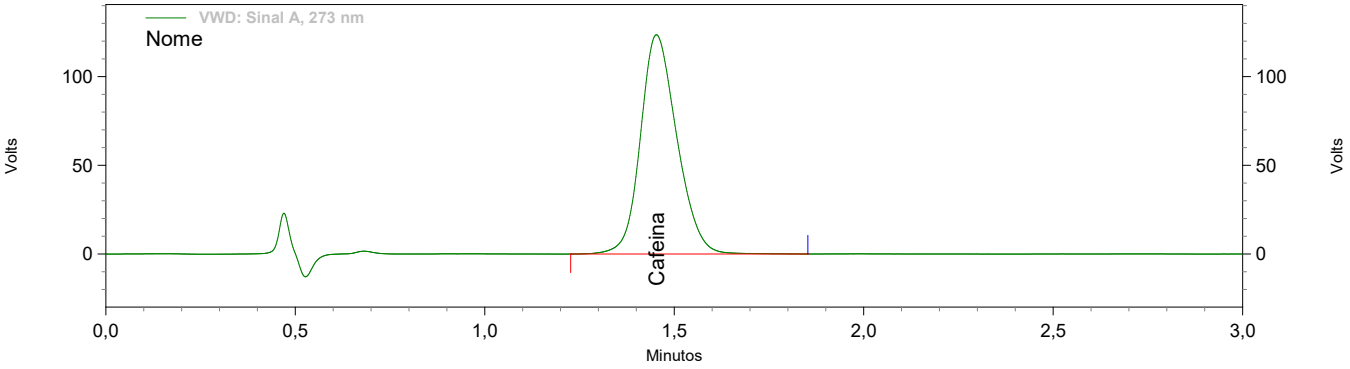


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,454	13874464	**0,000**

Totais			13874464	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\Branco 02**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:47:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:52:15 (GMT -03:00)**

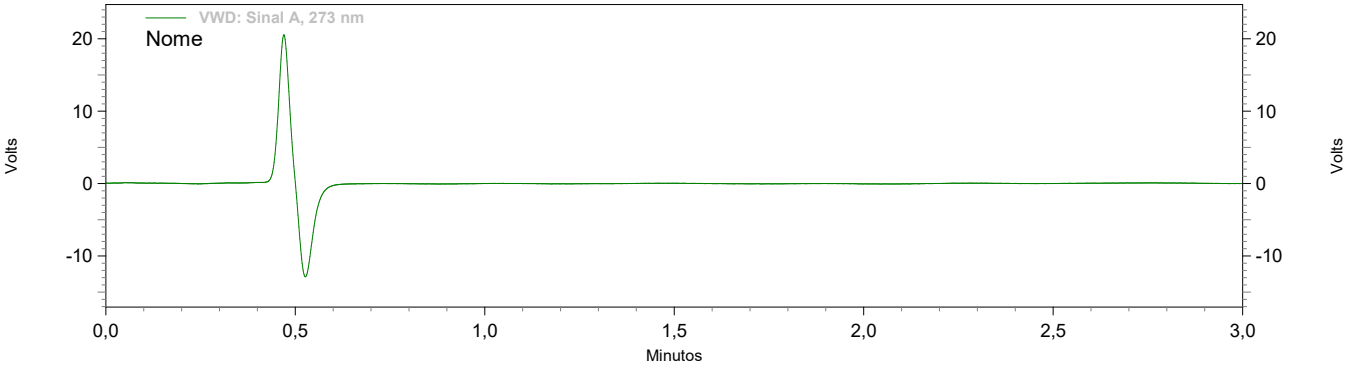


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 15:51:32 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:52:31 (GMT -03:00)

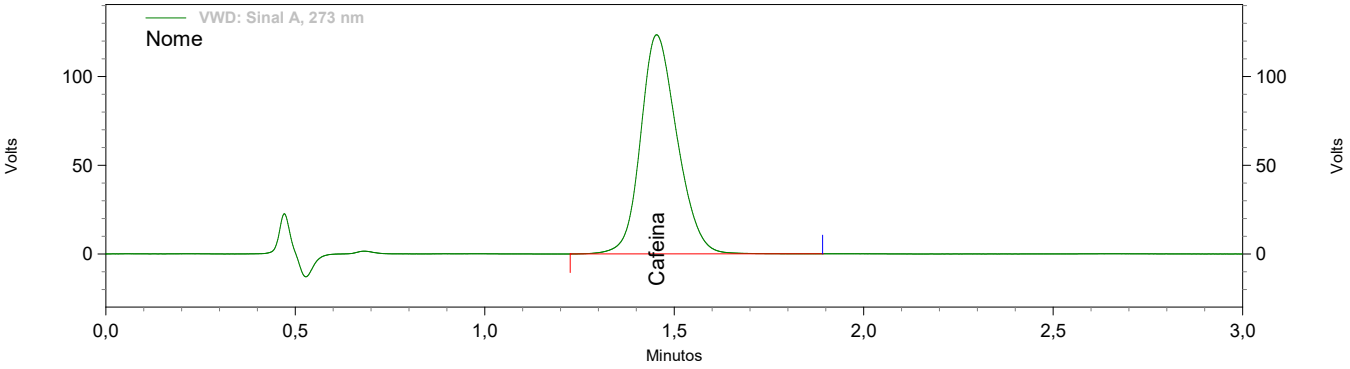


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,454	13870849	**0,000**

Totais			13870849	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:55:26 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:52:41 (GMT -03:00)**

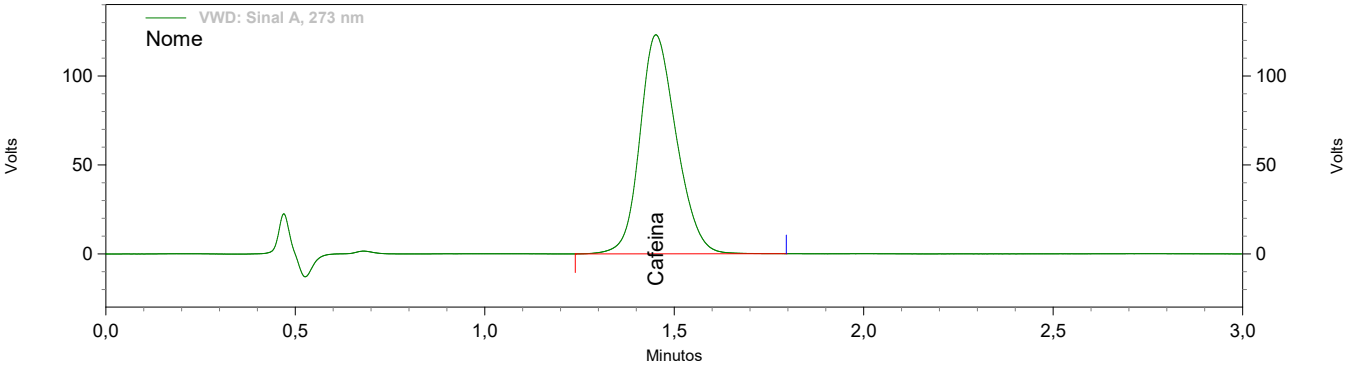


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,451	13838316	**0,000**

Totais			13838316	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 15:59:17 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:52:55 (GMT -03:00)**

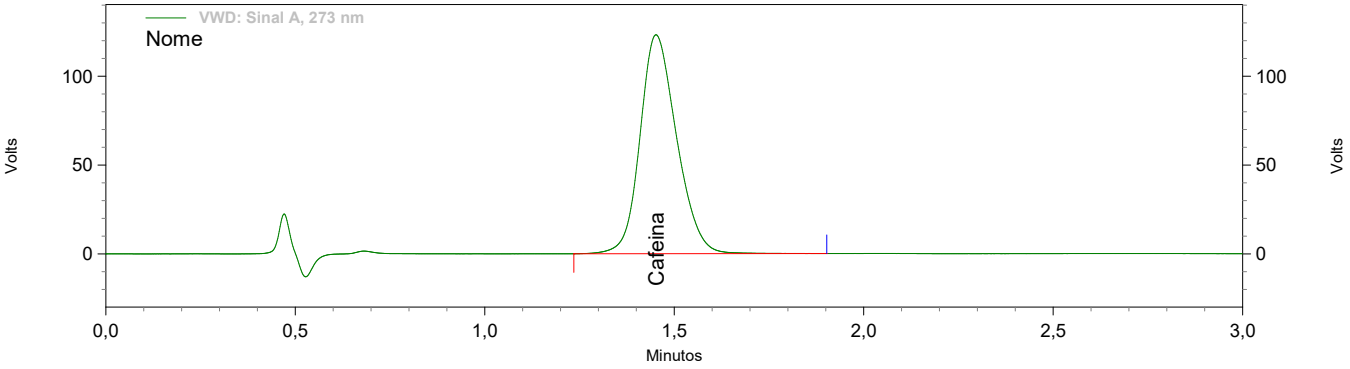


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,452	13878977	**0,000**

Totais			13878977	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\Branco 03**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:03:15 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:54:59 (GMT -03:00)**

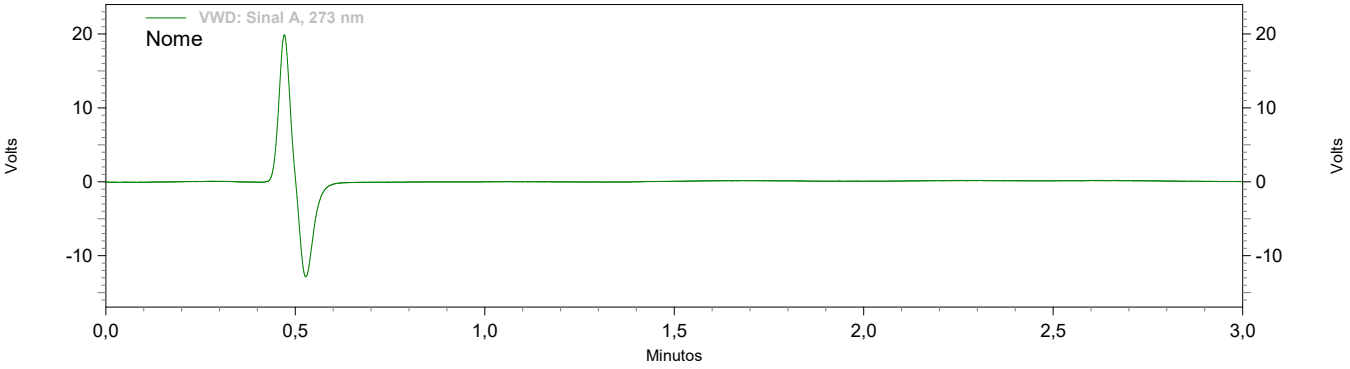


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:07:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:55:24 (GMT -03:00)**

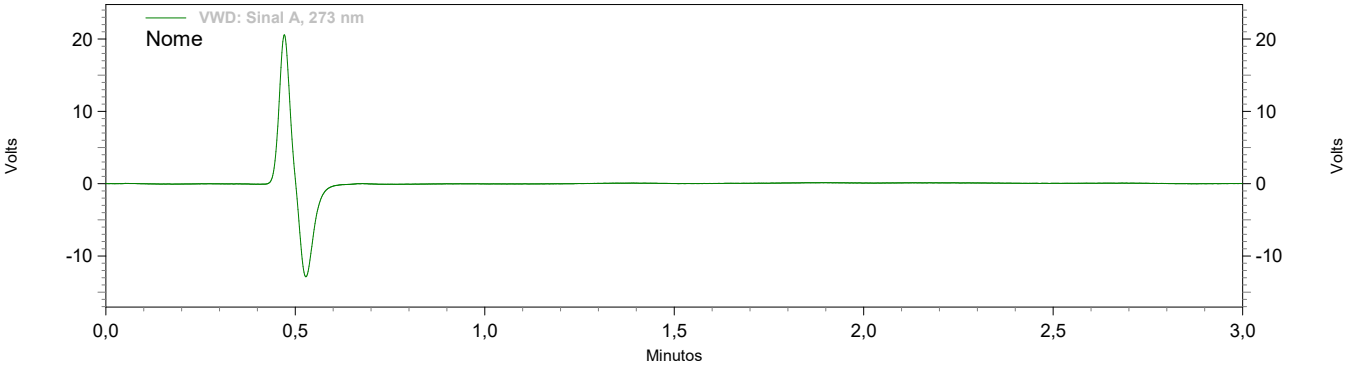


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:11:03 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:55:41 (GMT -03:00)**

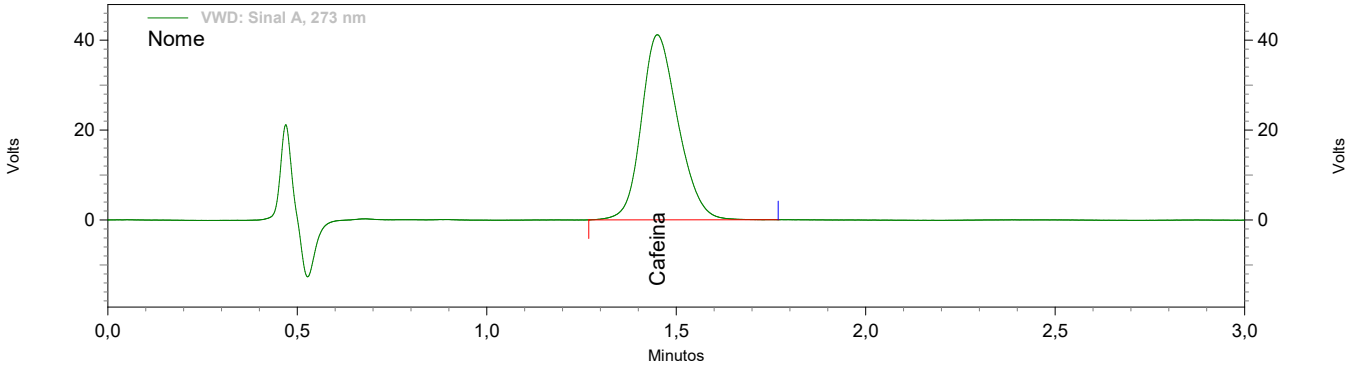


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,450	4628954	**0,000**

Totais			4628954	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 16:14:58 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:56:04 (GMT -03:00)

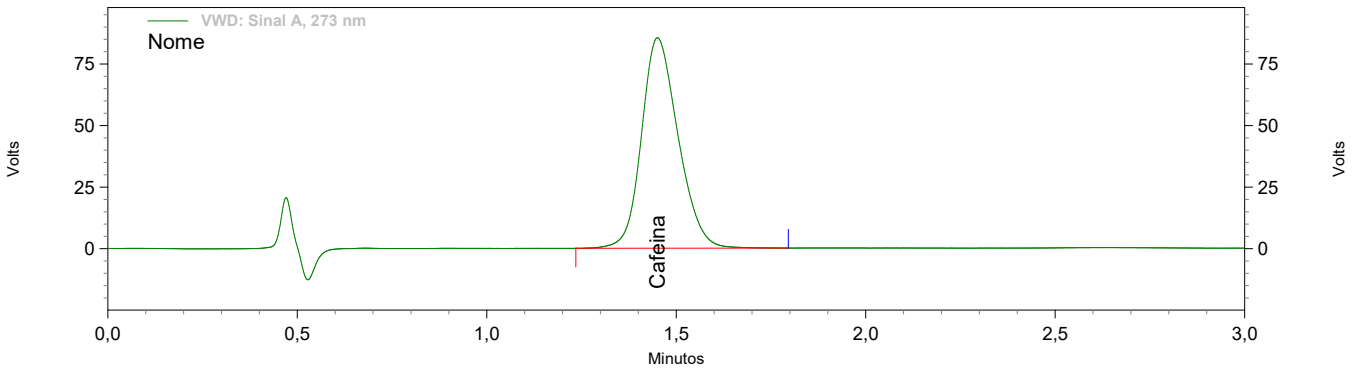


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,450	9627526	**0,000**

Totais			9627526	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:18:51 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:56:16 (GMT -03:00)**

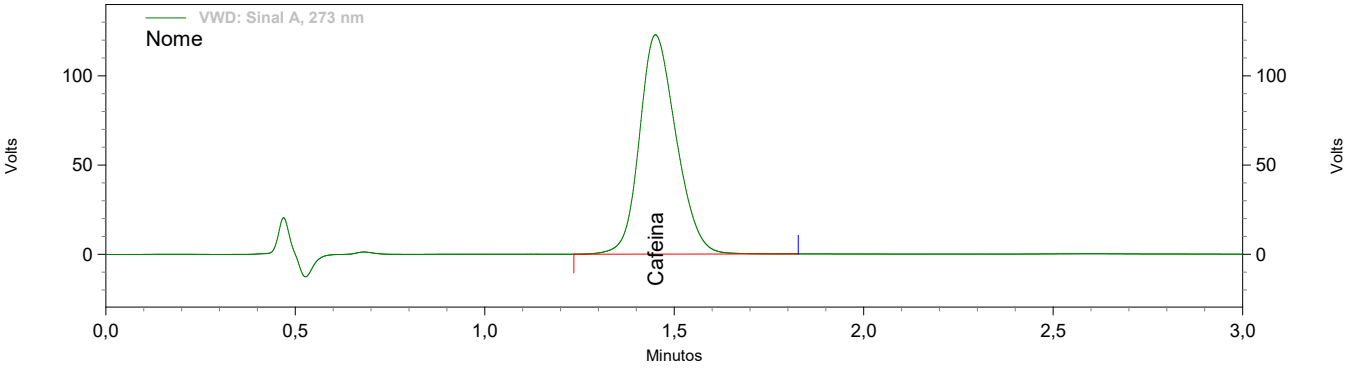


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,451	13868184	**0,000**

Totais			13868184	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:22:49 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:56:30 (GMT -03:00)**

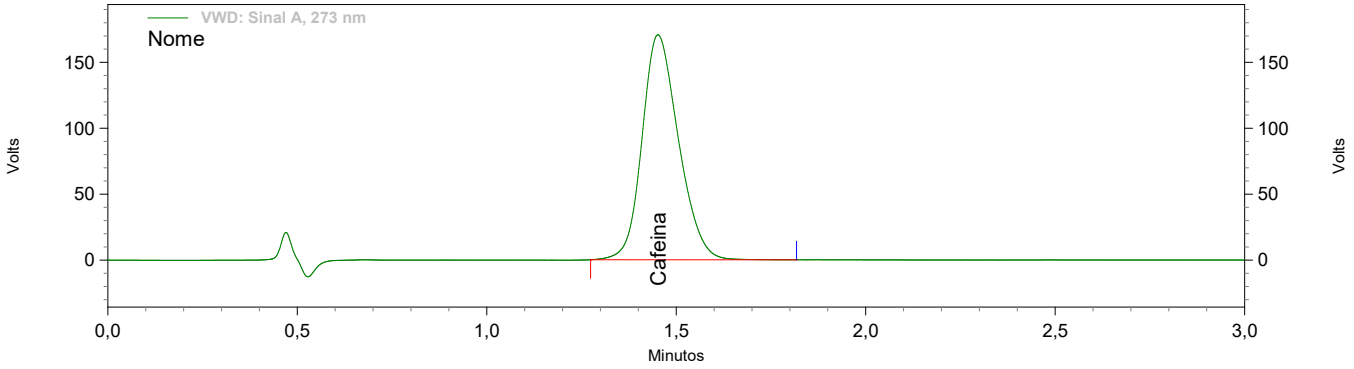


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,452	19127979	**0,000**

Totais			19127979	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 16:26:39 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:56:47 (GMT -03:00)

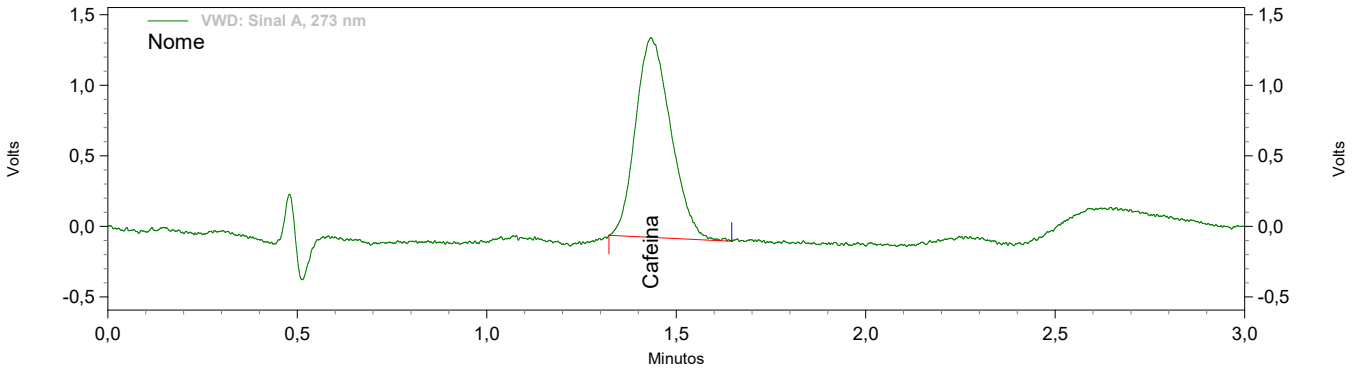


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,433	153445	**0,000**

Totais			153445	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 16:30:26 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:56:55 (GMT -03:00)

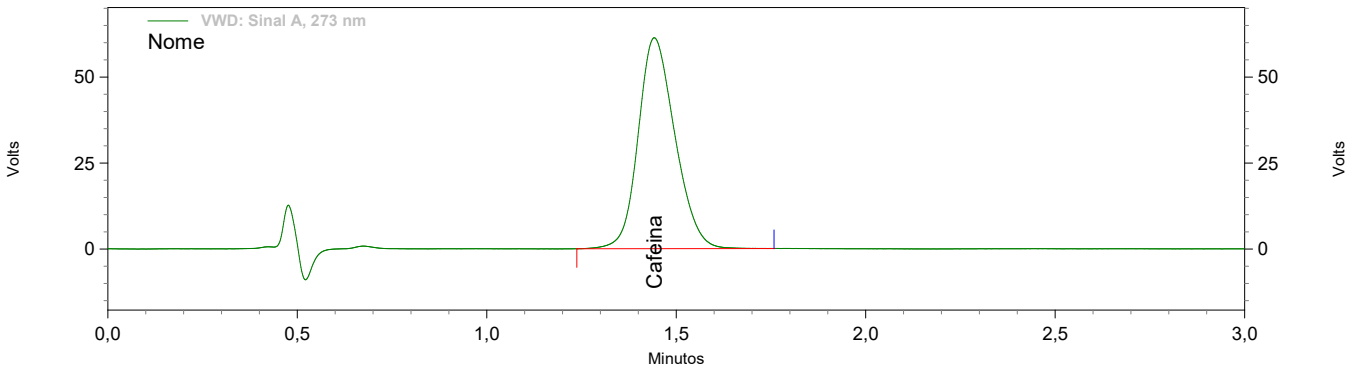


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,443	6938793	**0,000**

Totais			6938793	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 16:34:20 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:57:05 (GMT -03:00)

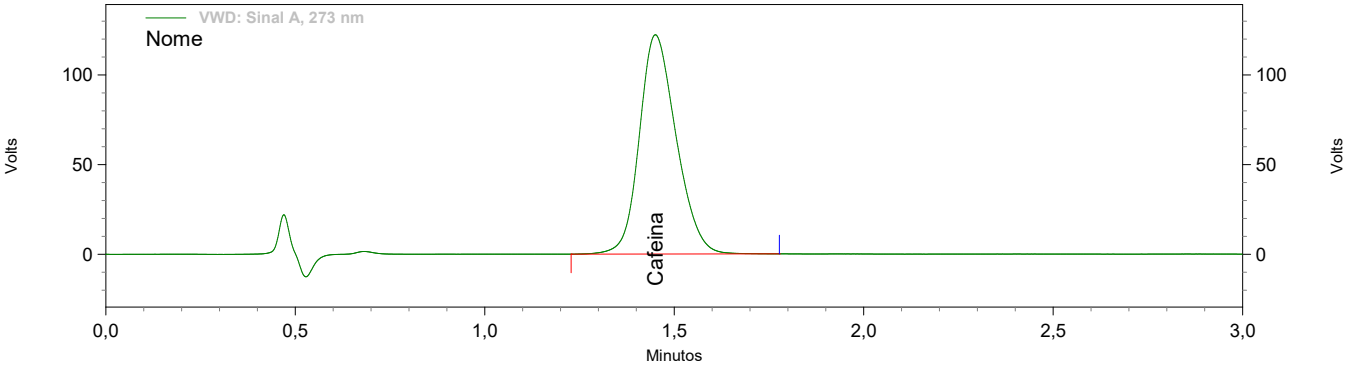


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,450	13860532	**0,000**

Totais			13860532	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **03/01/2023 16:38:13 (GMT -03:00)**
Impresso: **06/01/2023 10:57:15 (GMT -03:00)**

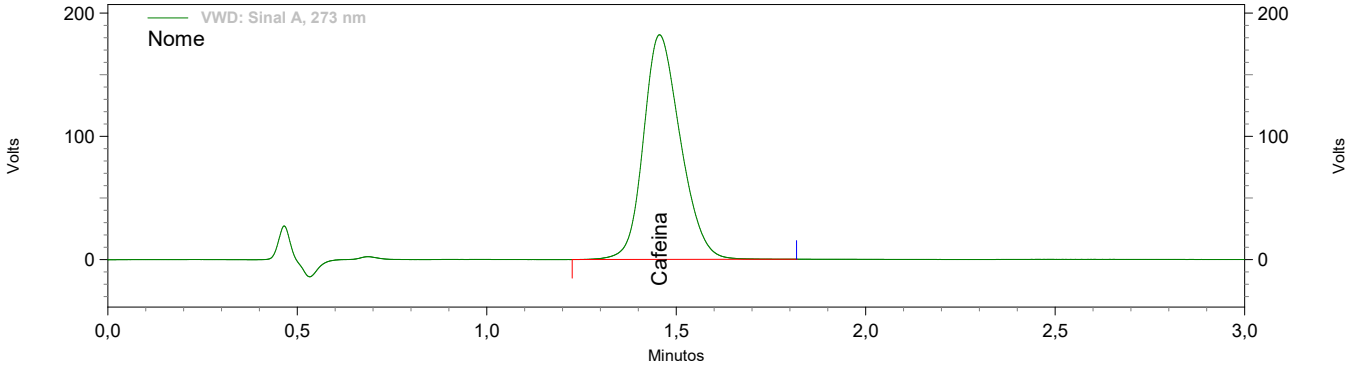


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,456	20738799	**0,000**

Totais			20738799	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\qualificação.seq2023-01-03 15-31-00 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 03/01/2023 16:42:11 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:57:25 (GMT -03:00)

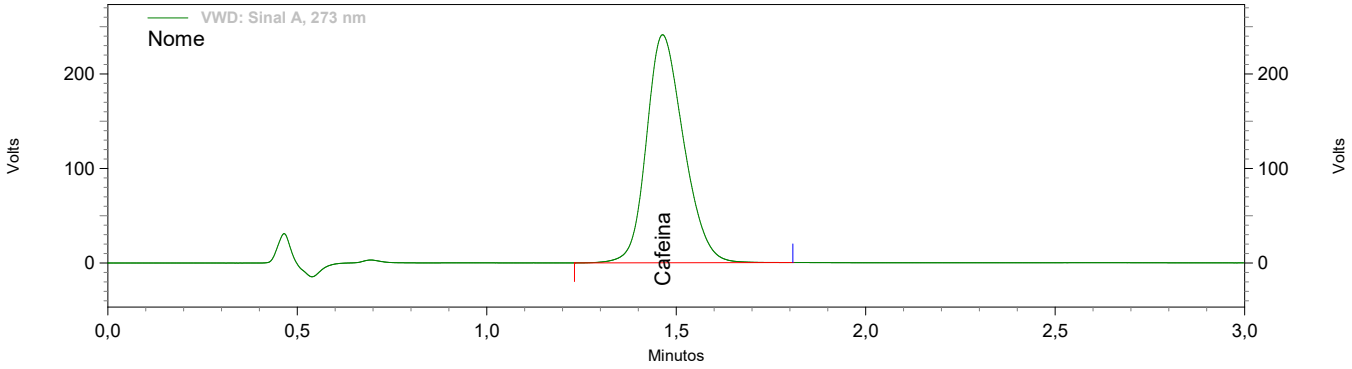


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,464	27640300	**0,000**

Totais			27640300	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\GRADIENTE AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\GRADIENTE AB2023-01-04 10-25-31 (GMT -03-00).rslt\GRADIENTE AB.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 10:28:56 (GMT -03:00)
Impresso: 07/01/2023 07:51:35 (GMT -03:00)

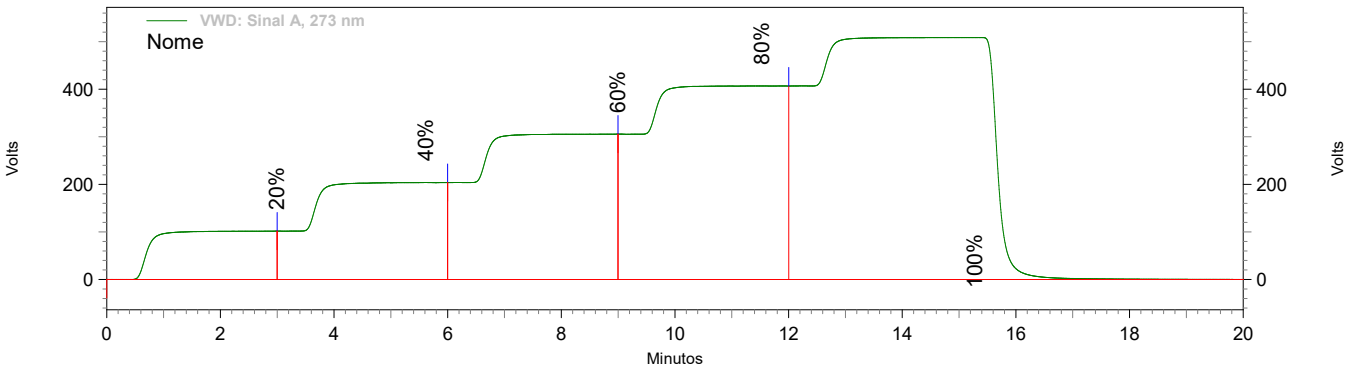


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	2,995	1706548	**0,000**
2	40%	5,615	3420190	**0,000**
3	60%	8,993	5127968	**0,000**
4	80%	11,527	6827110	**0,000**
5	100%	15,273	8533543	**0,000**

Totais			25615359	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\GRADIENTE CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\GRADIENTE CD2023-01-04 10-40-00 (GMT -03-00).rslt\GRADIENTE CD.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 10:49:26 (GMT -03:00)
Impresso: 07/01/2023 09:38:47 (GMT -03:00)

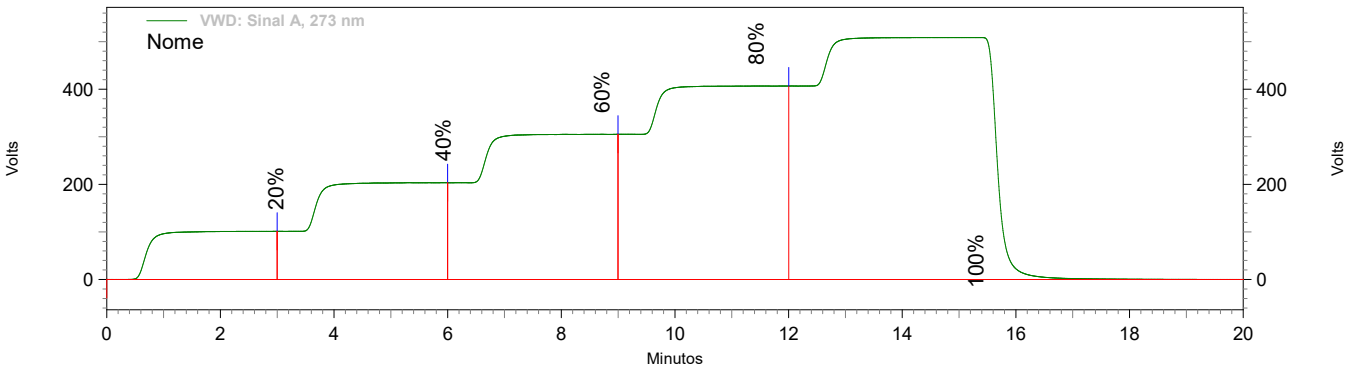

Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	2,985	1698185	**0,000**
2	40%	5,921	3412854	**0,000**
3	60%	8,717	5121084	**0,000**
4	80%	11,430	6823977	**0,000**
5	100%	15,298	8533088	**0,000**
Totais			25589188	**0,000**