
Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\SINAL RUÍDO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\Sinal ruido_01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:36:20 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 18:51:36 (GMT -03:00)

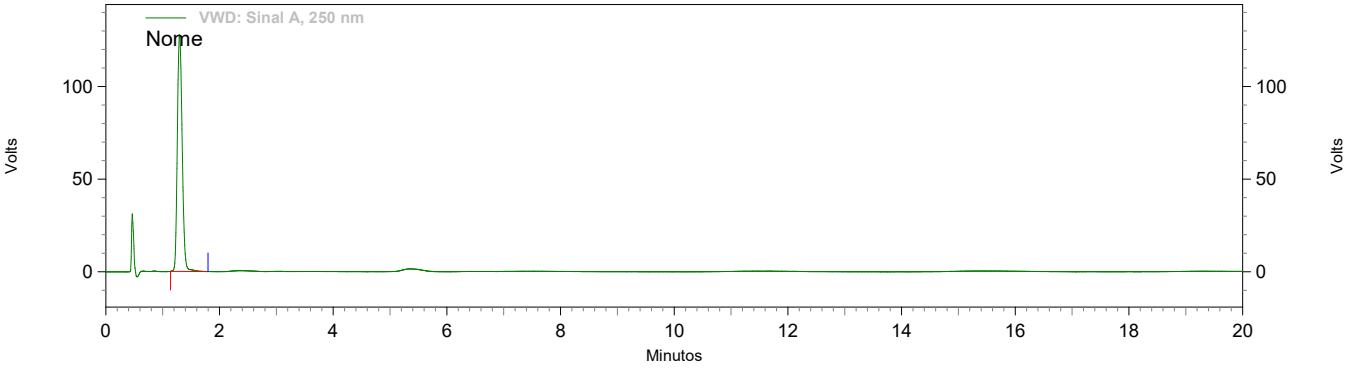


Resultados VWD:
Sinal A, 250 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*

Relatório SRELB

Detector VWD – G1314A – N/S JP92111021	Data: 05/01/2023
Ruído:	
Valor máximo: 0.02527 mAU	**Diferença: 0.00686 mAU**
Valor mínimo: 0.01841 mAU	

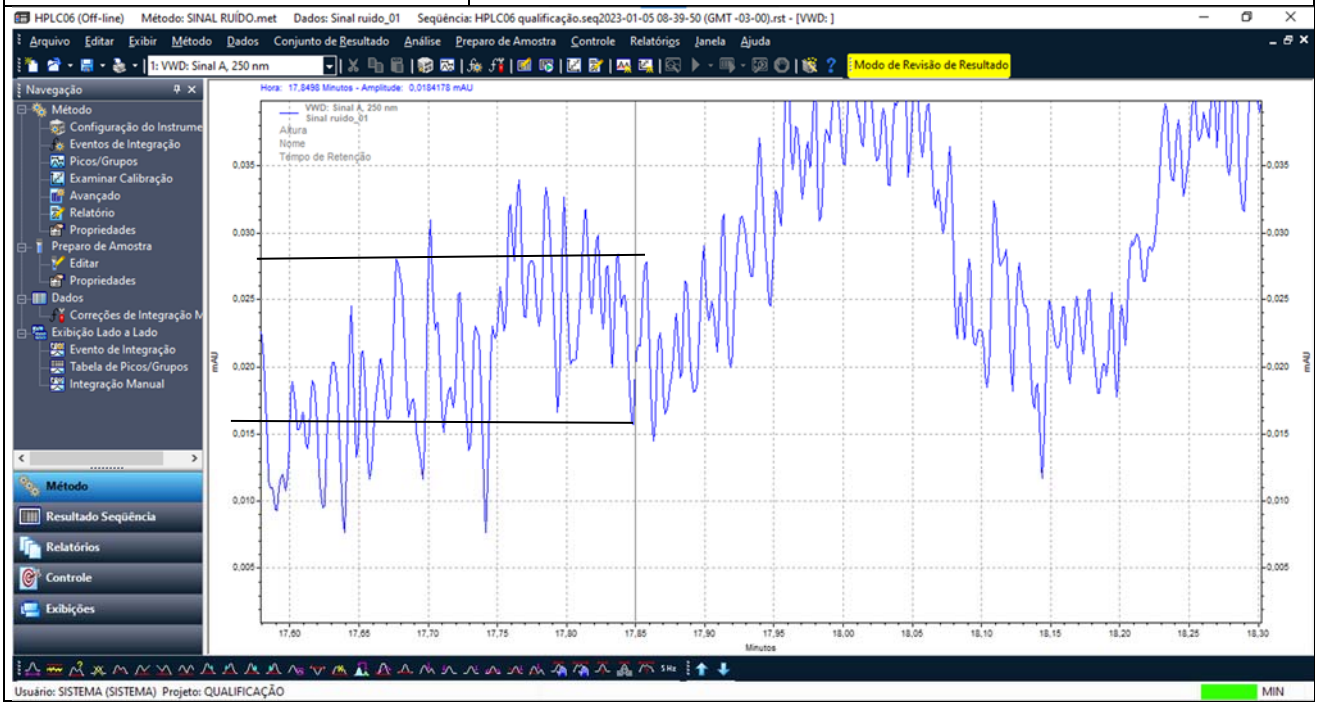

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


#

#

#

#

Estabilidade da Linha de Base:	
Valor máximo: -0.025 mAU	**Diferença (em 20 minutos): 0.027mAU**
Valor mínimo: -0.052 mAU	**Diferença (em 60 minutos): 0.098 x 3 = 0.081 mAU**

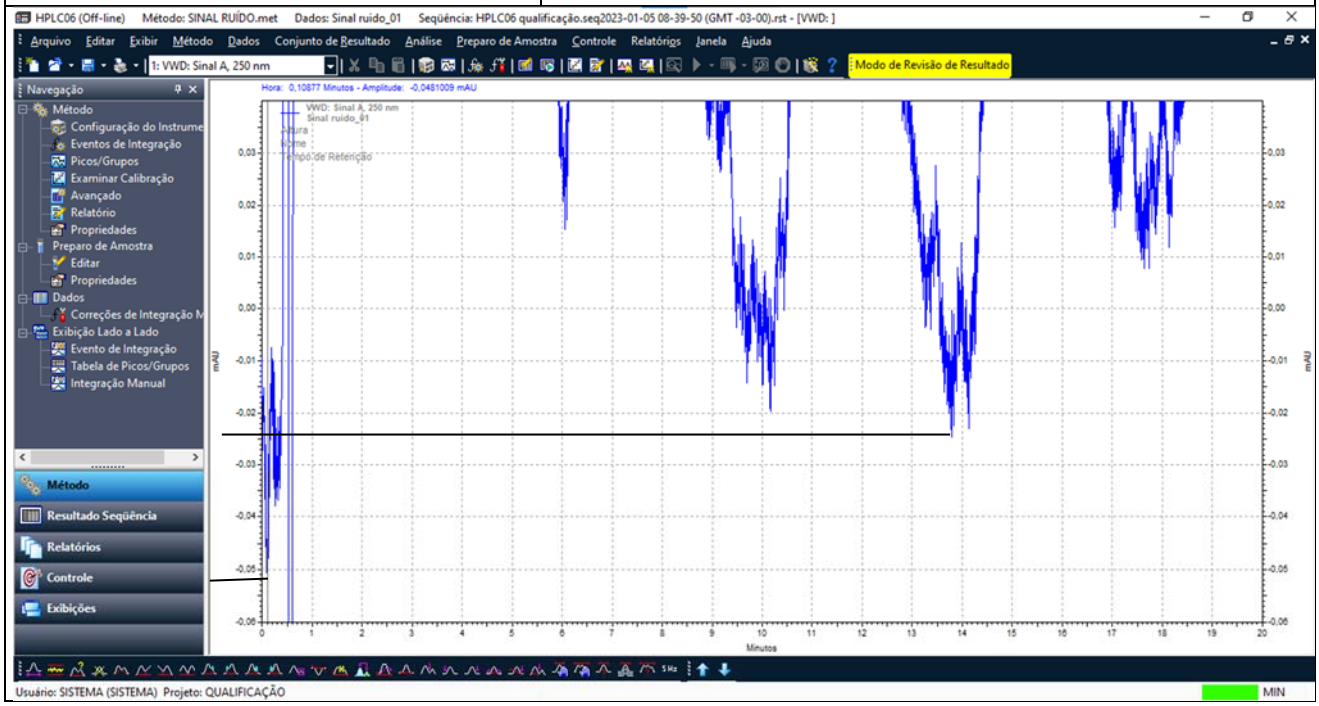

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#


#

#

#

#

Altura do Pico:
Valor: 127.948 mAU #

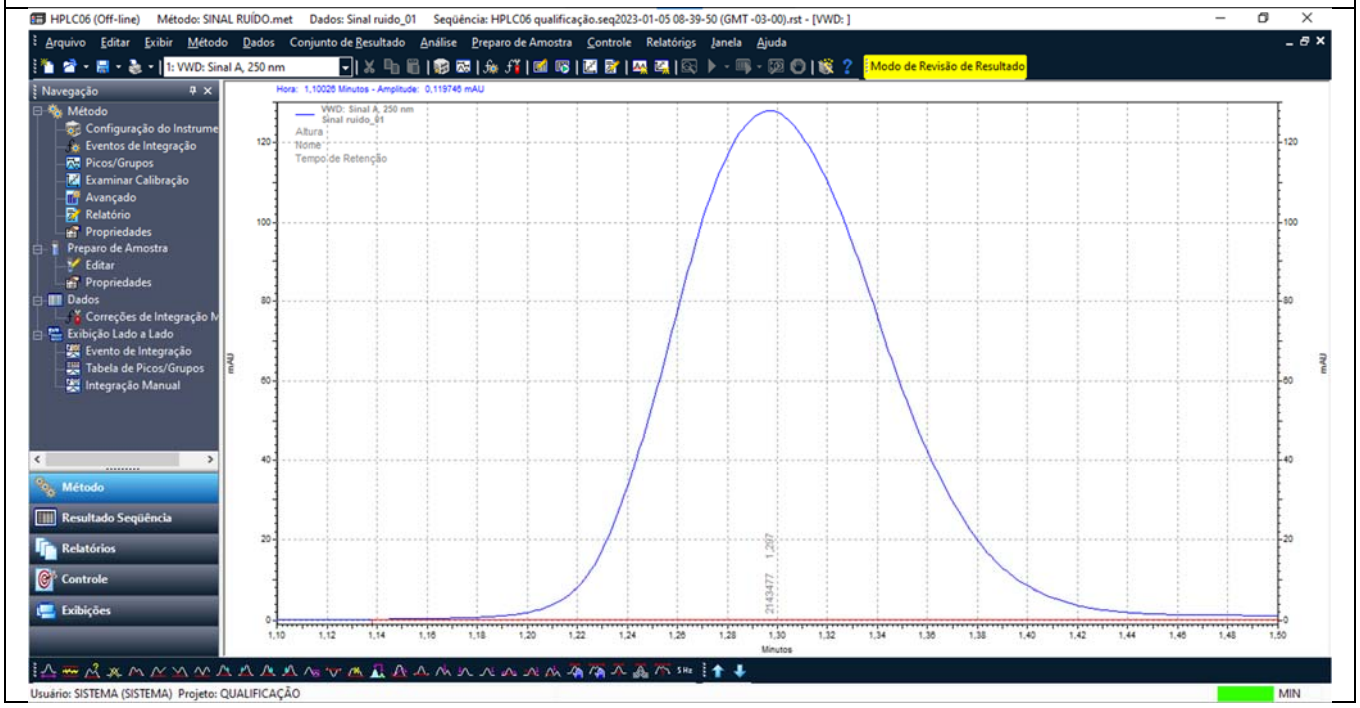

#

Tasks

Lab Advisor

System Overview

Configuration

Apps

Firmware Update

Logs & Results

ZOETIS 06

Service & Diagnostics

Instrument Control

EMFs

System Report

Help

Context Help (F1)


Help Topics

What's New?

Spectral Scan - VWD [JP92111021]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

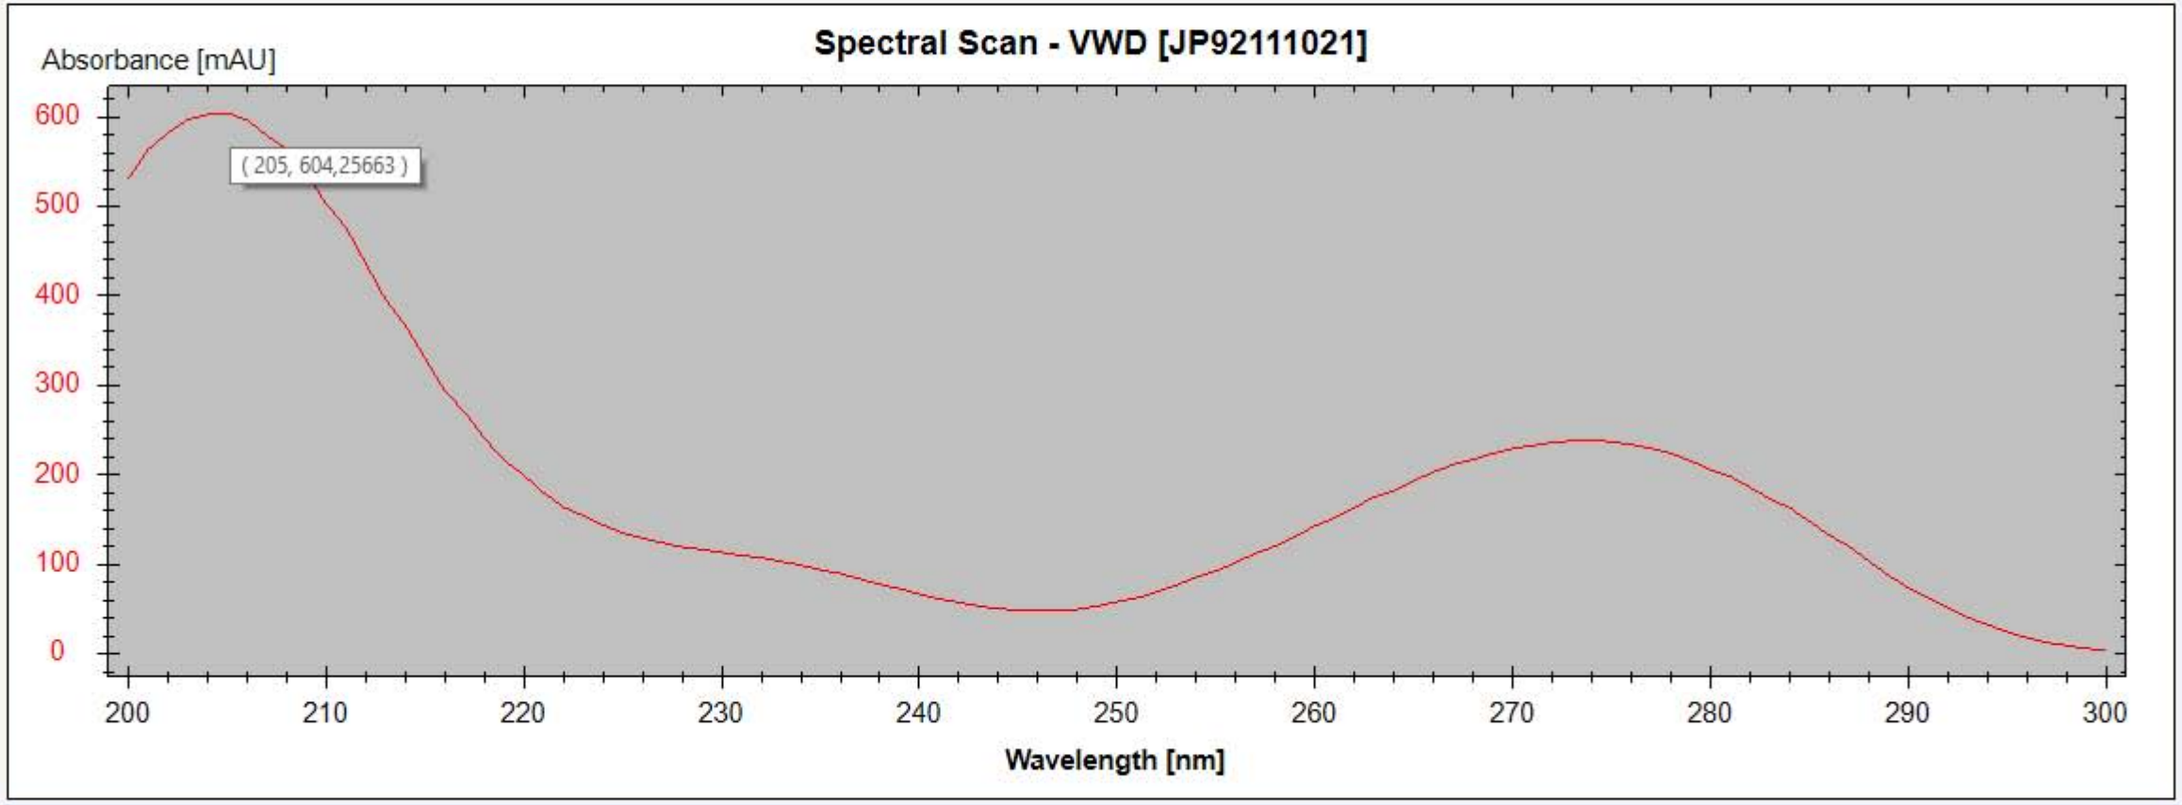


more... | Print Result | Back

Spectral Scan - VWD [JP92111021]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

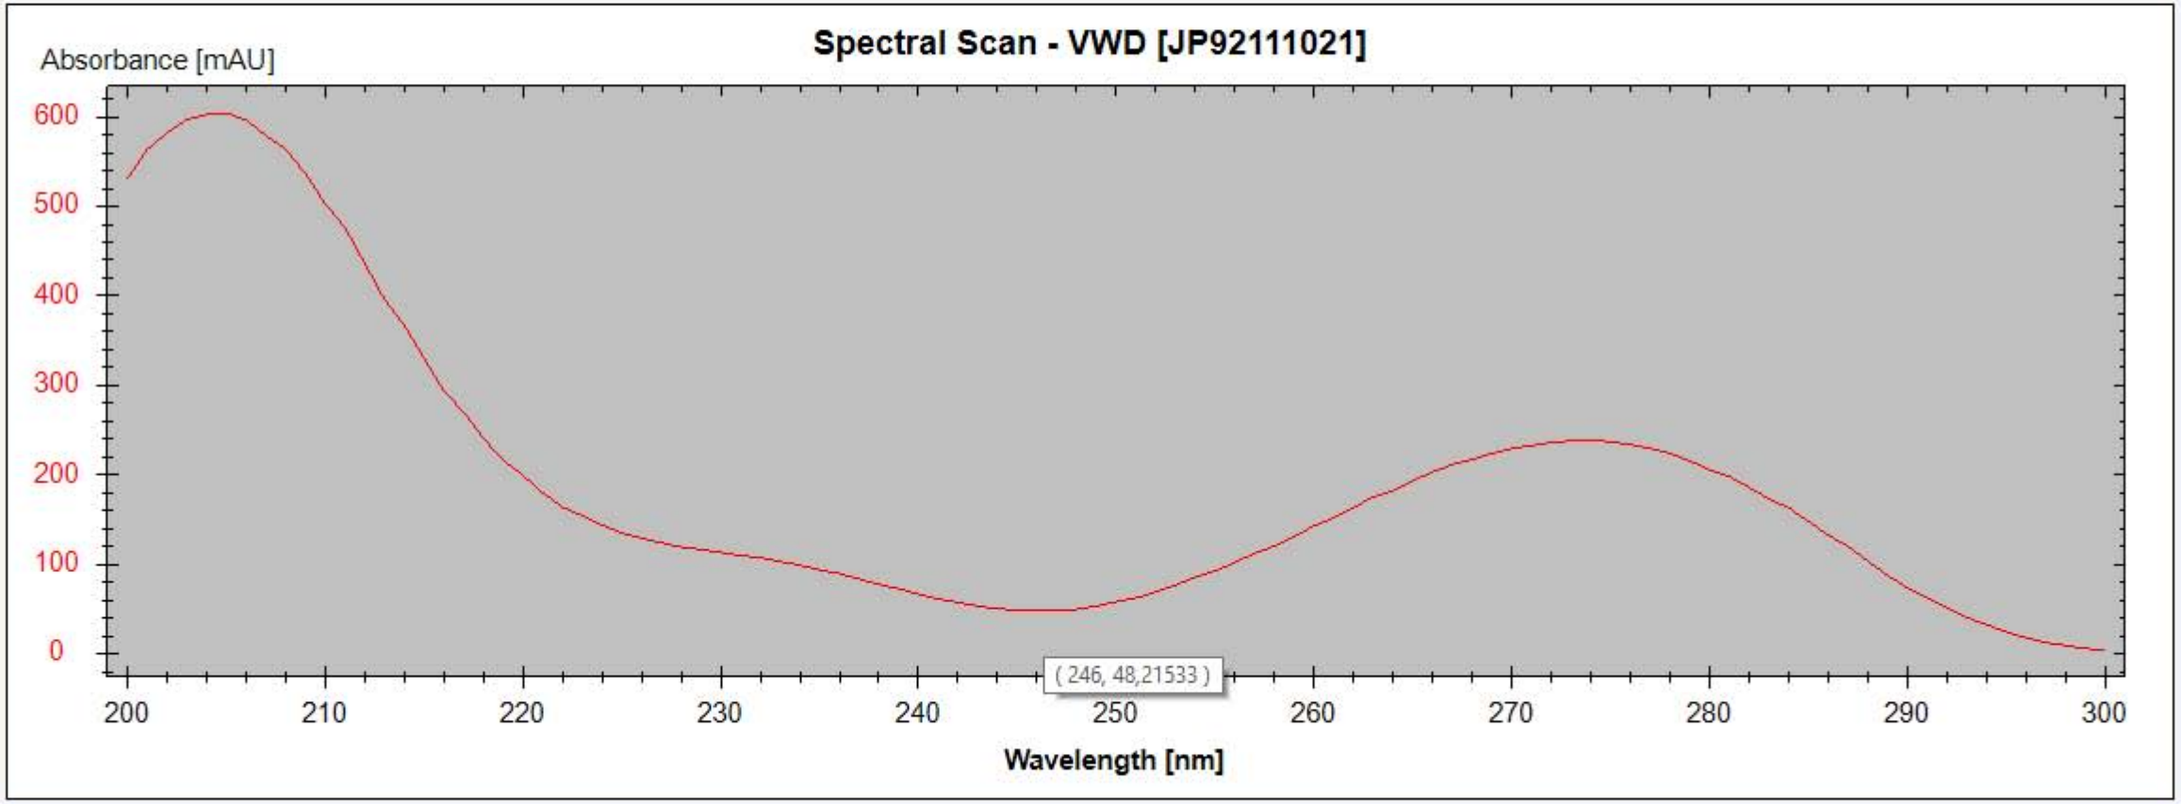


more... | Print Result | Back

Spectral Scan - VWD [JP92111021]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

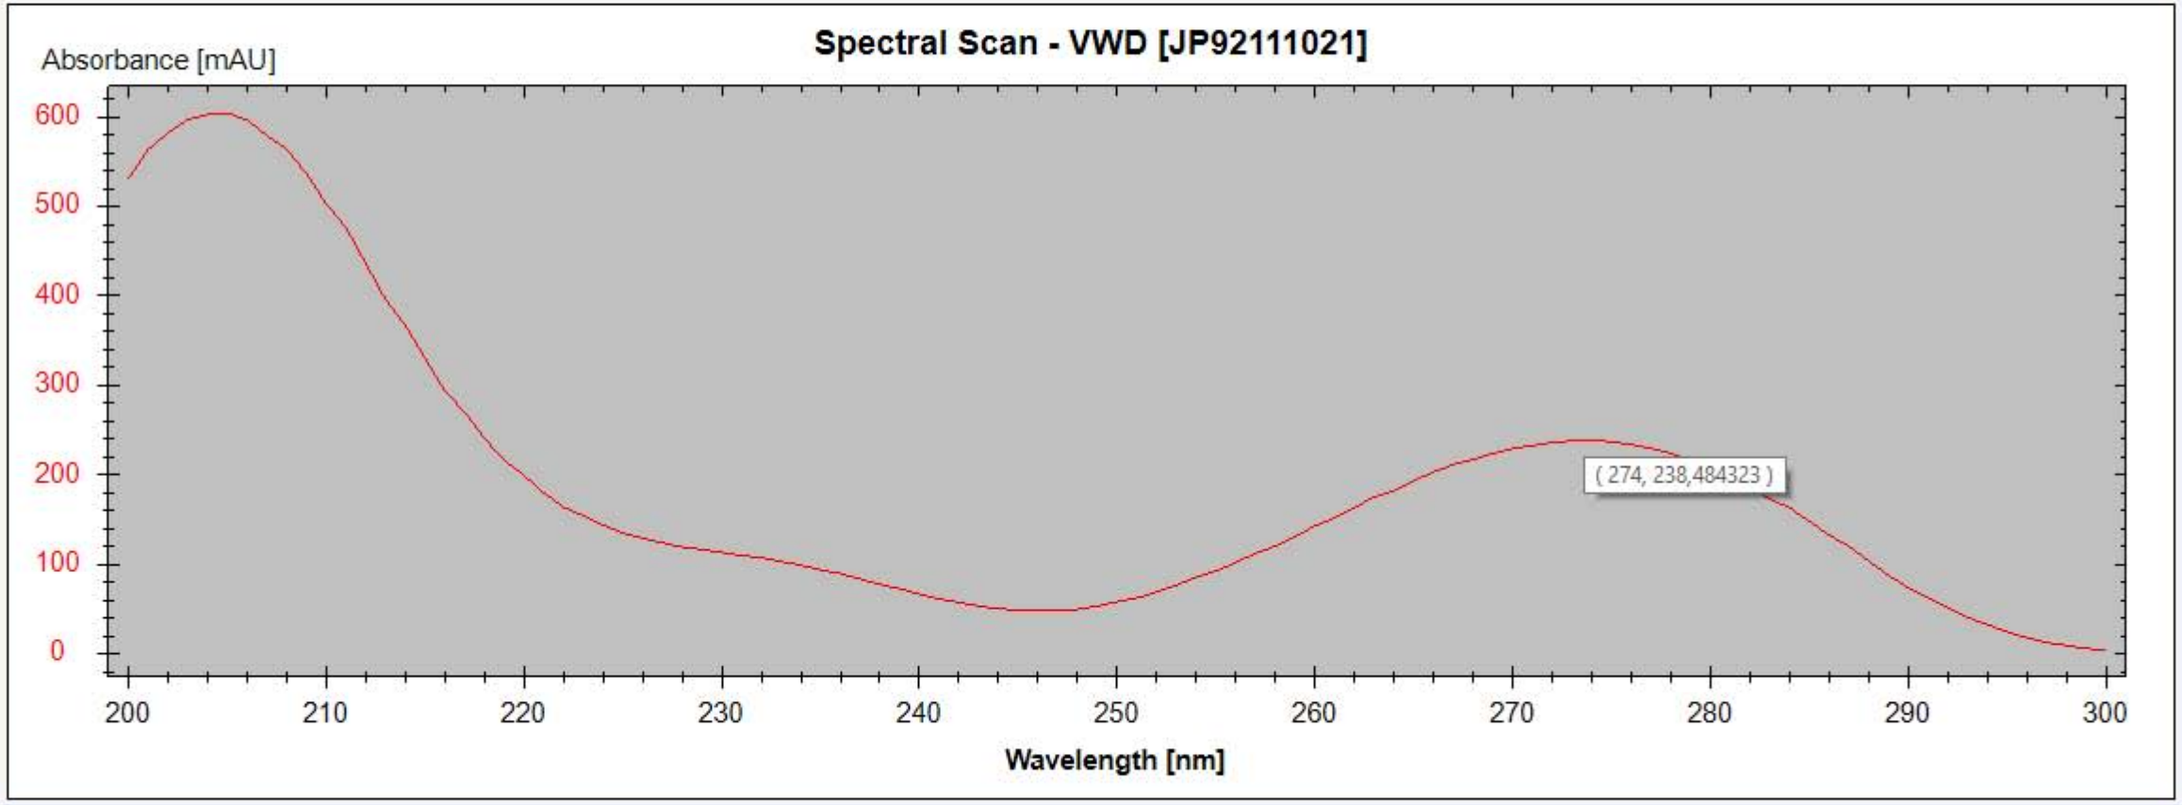

more... | Print Result | Back

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\Branco 01.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 15:24:14 (GMT -03:00)**
Impresso: **08/01/2023 19:04:44 (GMT -03:00)**

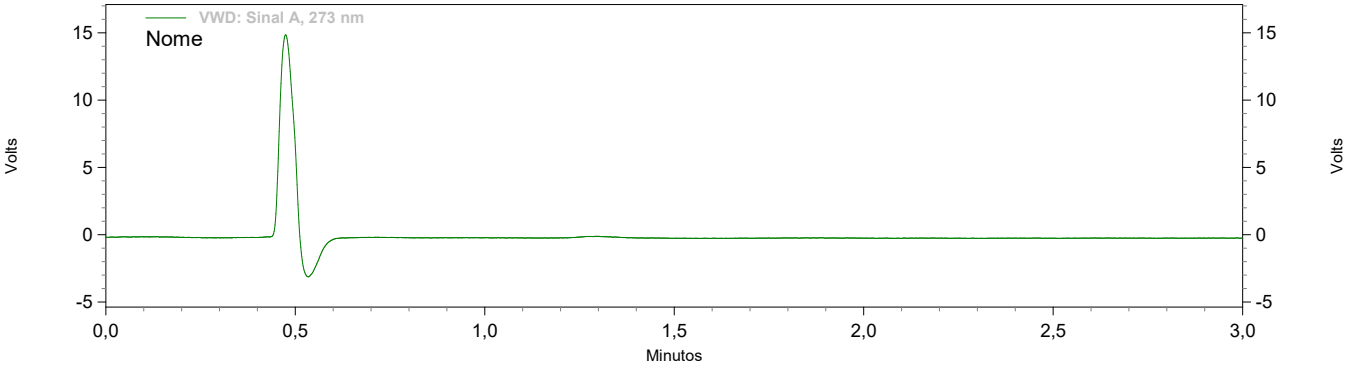


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	CAFEINA			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:28:08 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:08:09 (GMT -03:00)

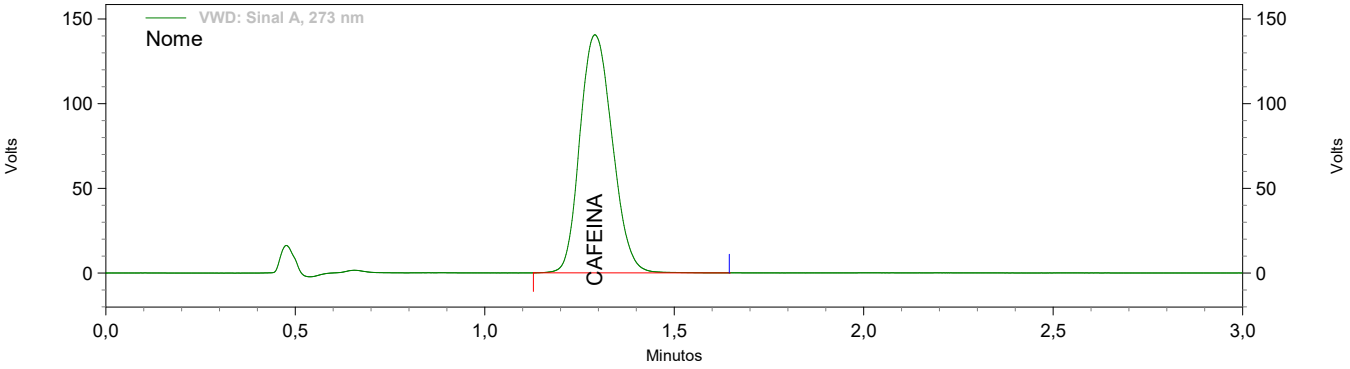


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,291	14045823	**0,000**

Totais			14045823	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:31:59 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:08:40 (GMT -03:00)

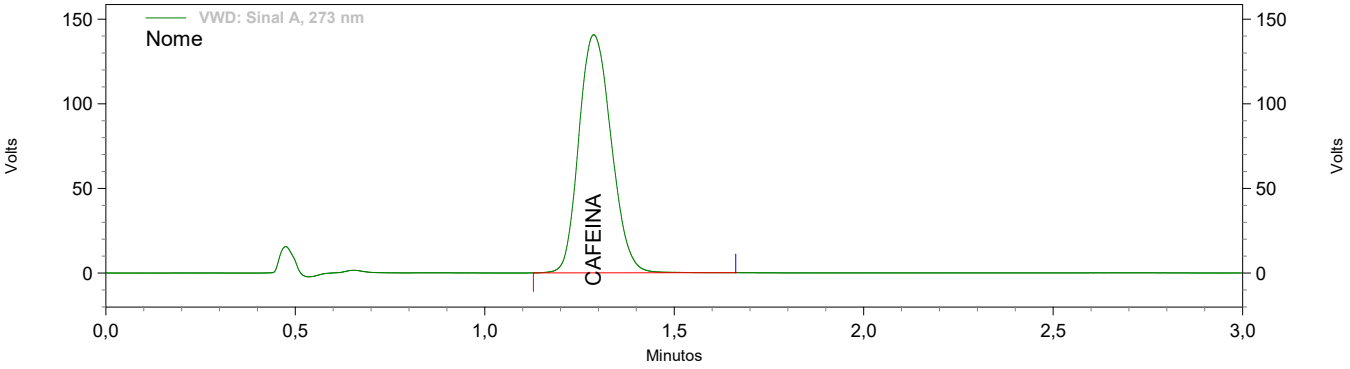


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,287	14039367	**0,000**

Totais			14039367	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:35:50 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:08:50 (GMT -03:00)

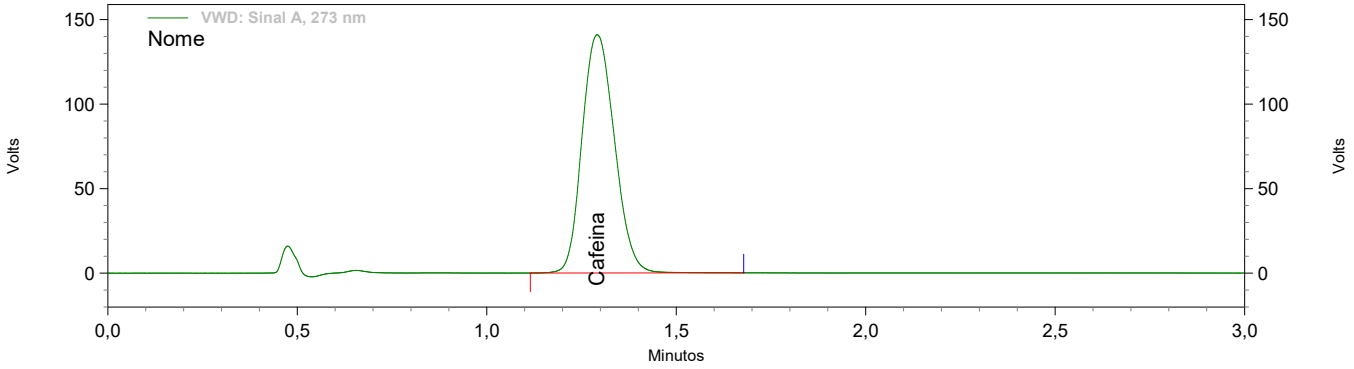


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,291	14060525	**0,000**

Totais			14060525	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\Branco 02**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 15:39:45 (GMT -03:00)**
Impresso: **08/01/2023 19:09:01 (GMT -03:00)**

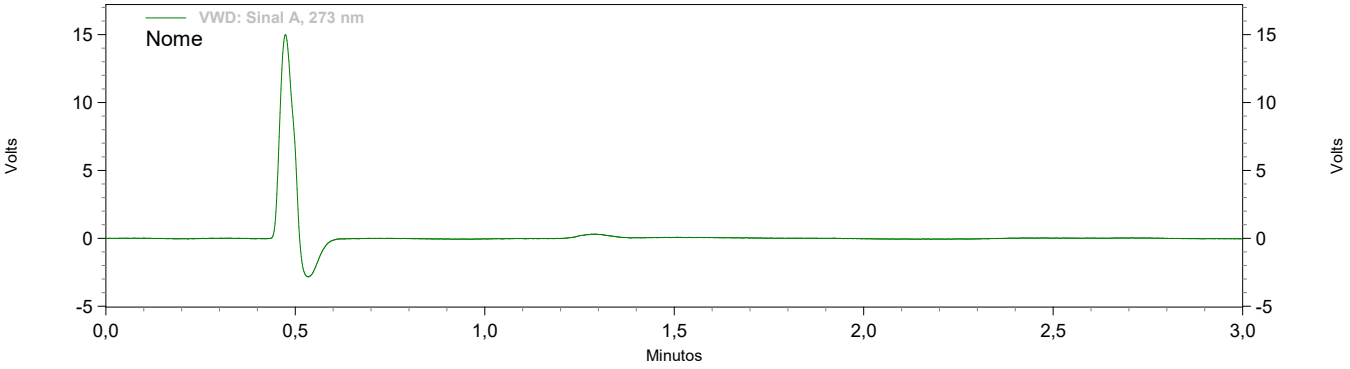


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	CAFEINA			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:43:38 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:09:14 (GMT -03:00)

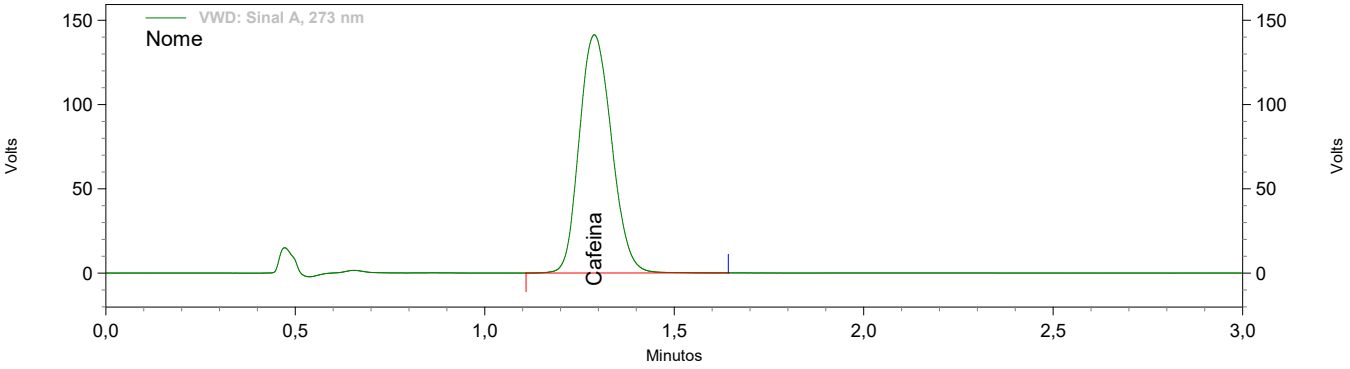


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,289	14059562	**0,000**

Totais			14059562	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:47:31 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:09:24 (GMT -03:00)

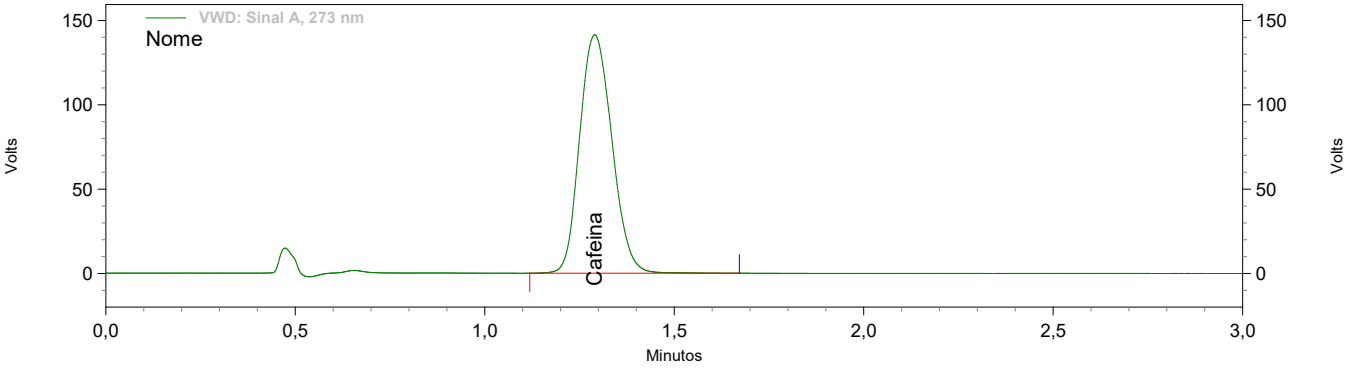


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,290	14058130	**0,000**

Totais			14058130	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 04/01/2023 15:51:23 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:09:32 (GMT -03:00)

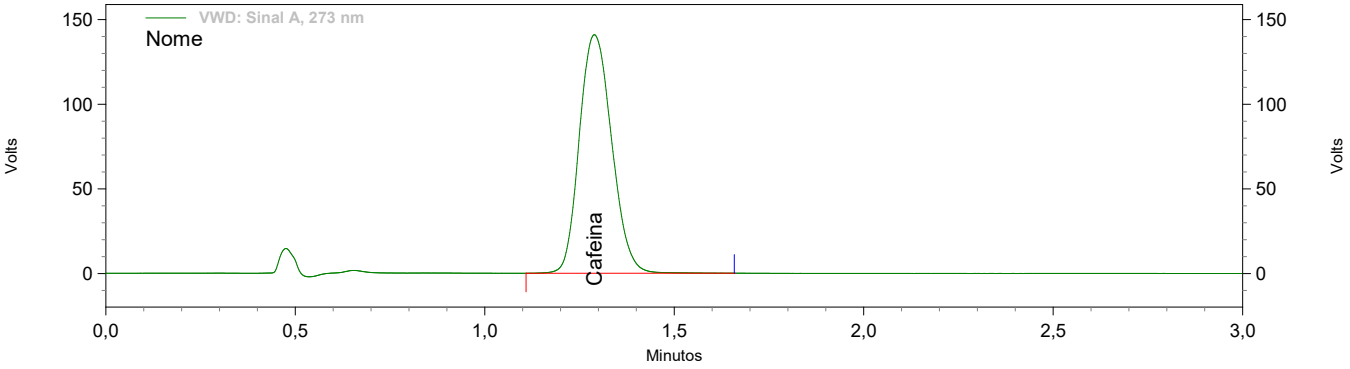


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1,290	14055838	**0,000**

Totais			14055838	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-04 15-02-13 (GMT -03-00).rslt\Branco 03**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **04/01/2023 15:55:16 (GMT -03:00)**
Impresso: **08/01/2023 19:09:44 (GMT -03:00)**

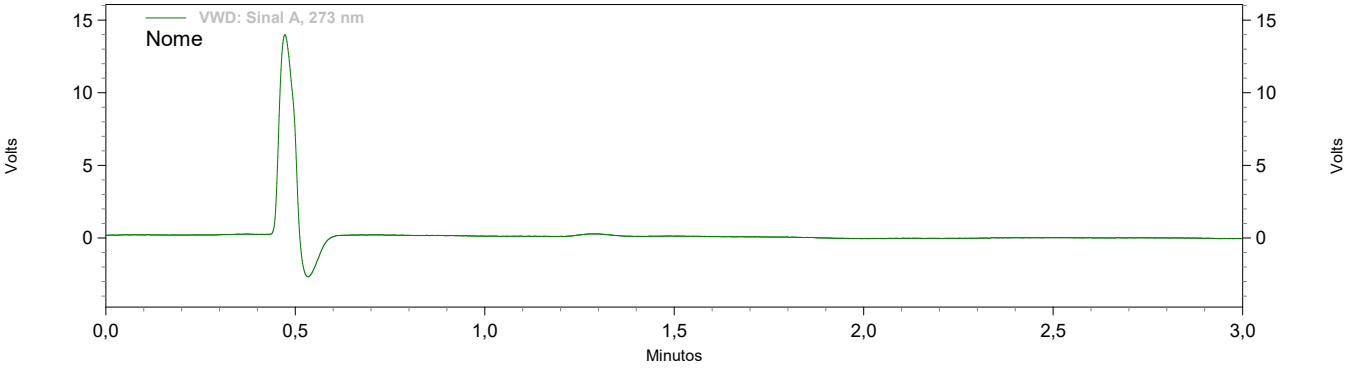


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 08:57:21 (GMT -03:00)**
Impresso: **08/01/2023 19:10:25 (GMT -03:00)**

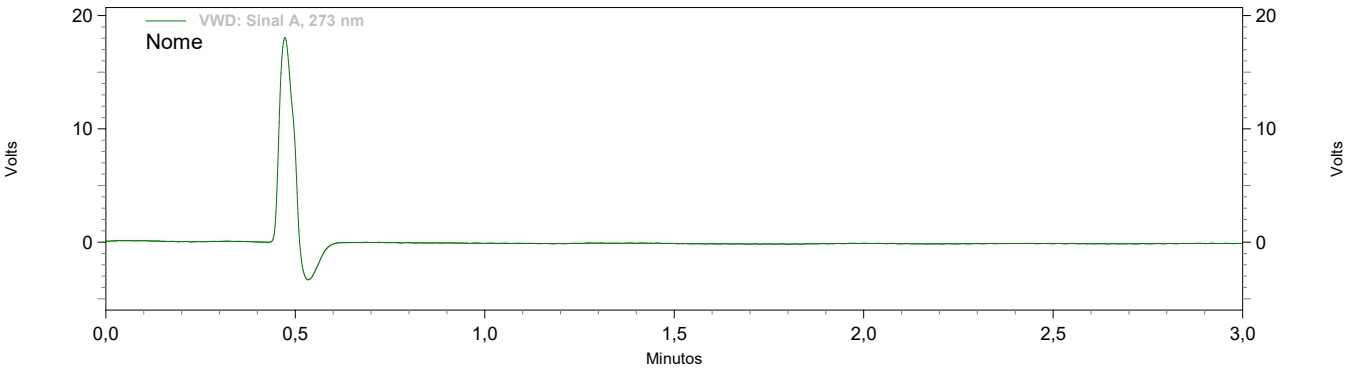


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	CAFEINA			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:01:14 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:11:52 (GMT -03:00)

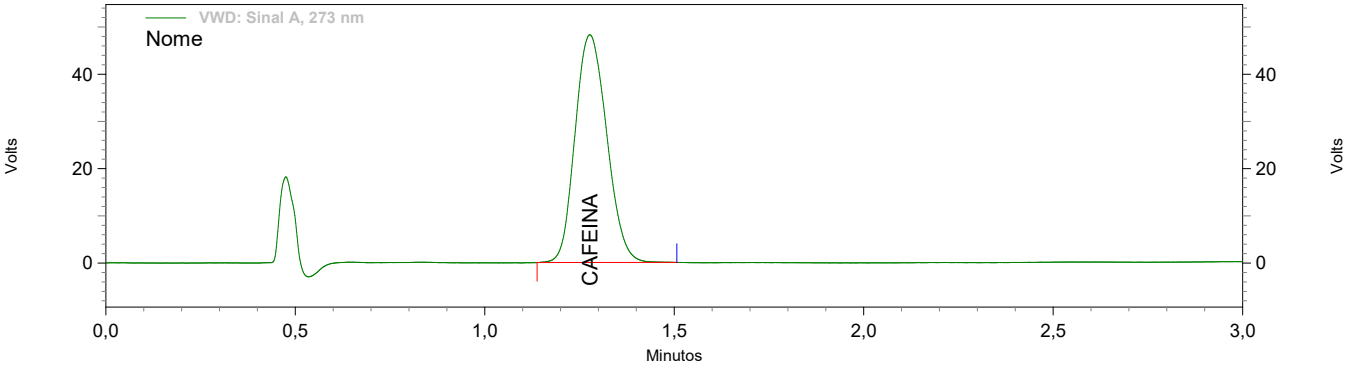


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,278	4706850	**0,000**

Totais			4706850	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:05:08 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:12:02 (GMT -03:00)

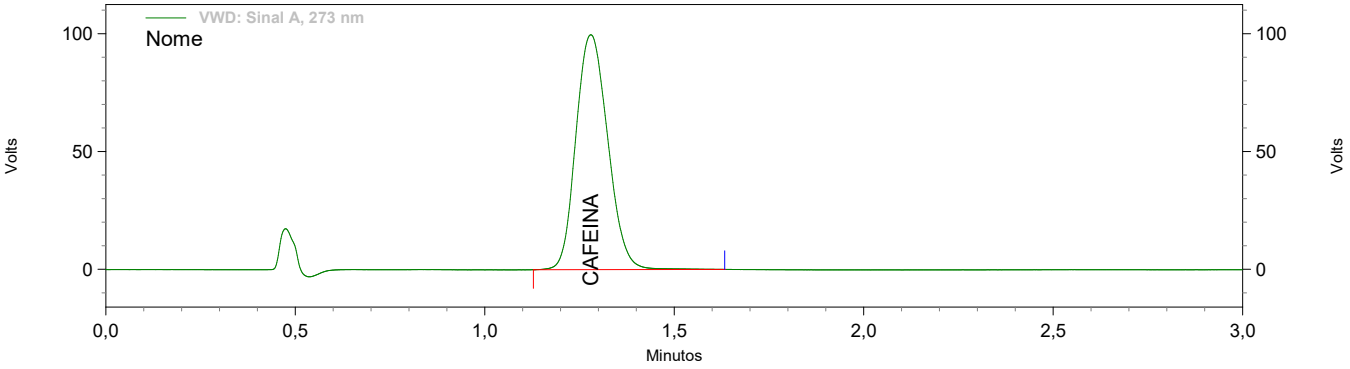


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,280	9777691	**0,000**

Totais			9777691	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 09:09:01 (GMT -03:00)**
Impresso: **08/01/2023 19:12:11 (GMT -03:00)**

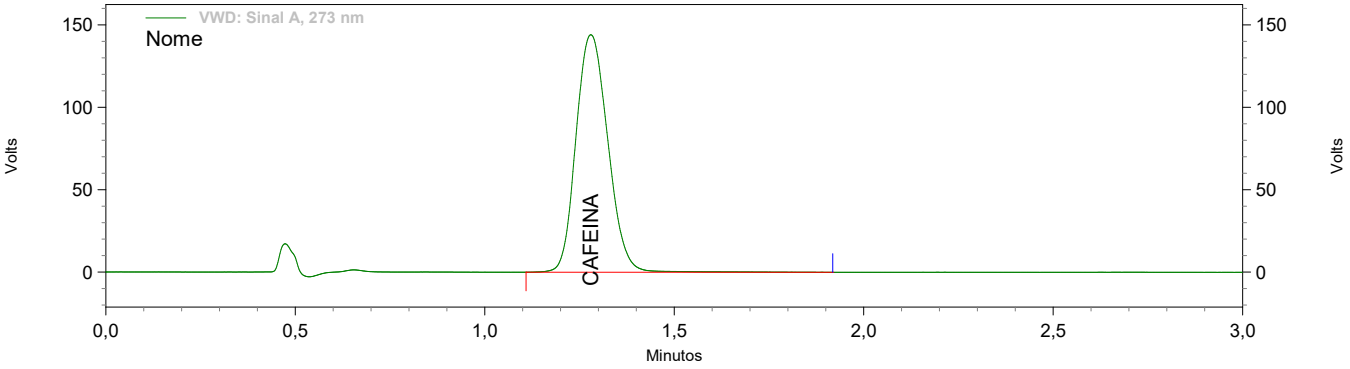


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,280	14162714	**0,000**

Totais			14162714	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:12:55 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:12:19 (GMT -03:00)

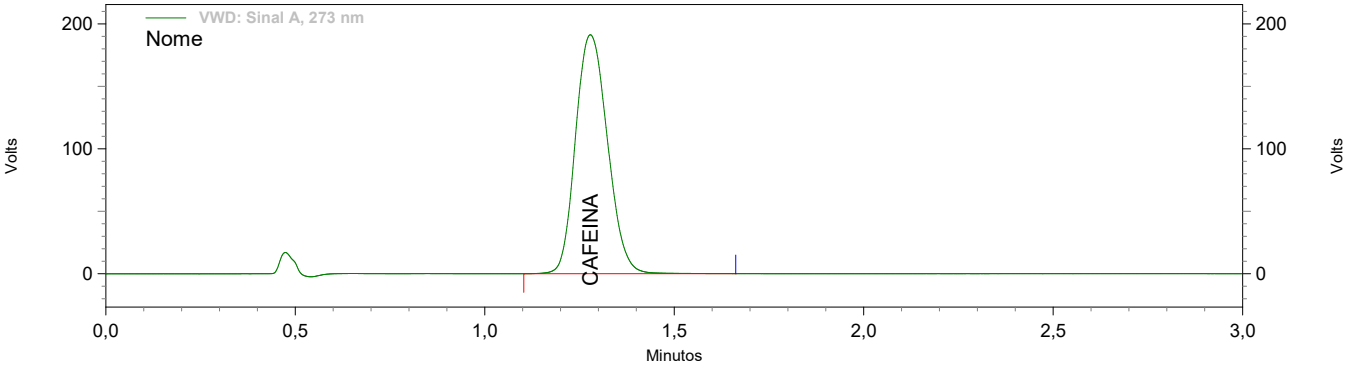


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,279	18831591	**0,000**

Totais			18831591	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:16:47 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:13:31 (GMT -03:00)

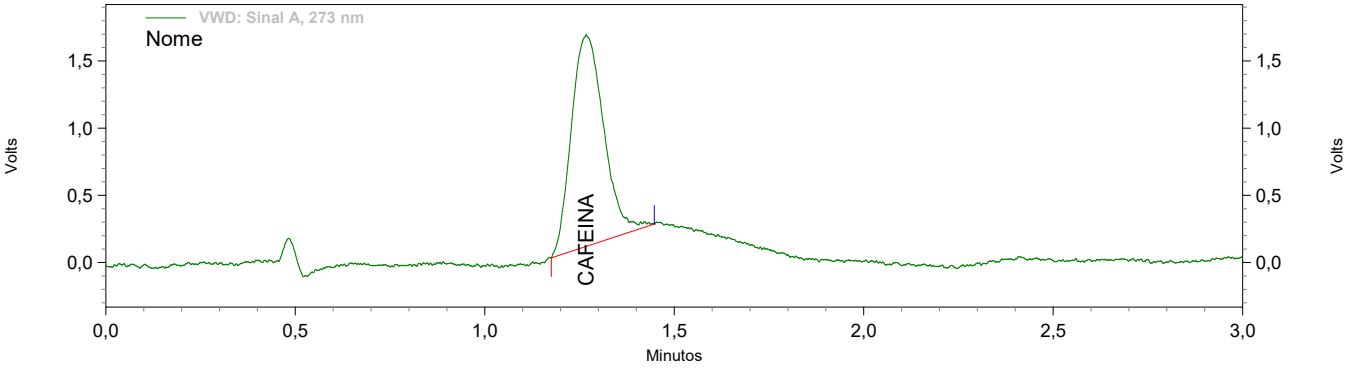


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,268	156847	**0,000**

Totais			156847	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:20:35 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:13:39 (GMT -03:00)

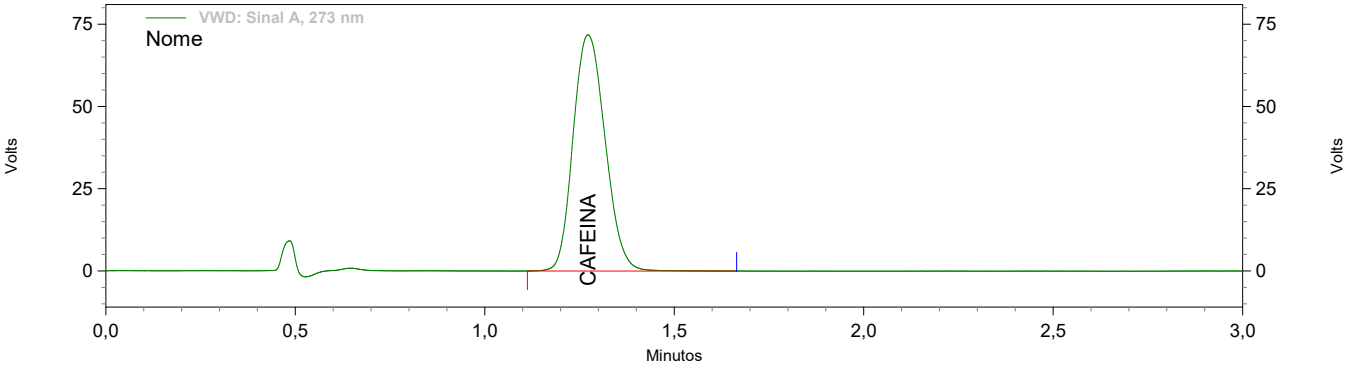


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,273	7080143	**0,000**

Totais			7080143	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:24:27 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:13:48 (GMT -03:00)

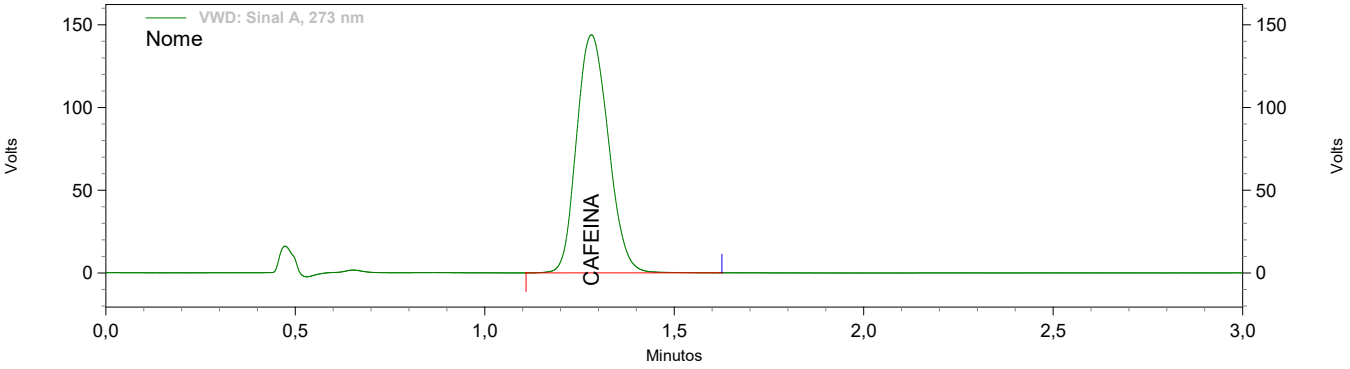


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,281	14094340	**0,000**

Totais			14094340	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:28:20 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:13:59 (GMT -03:00)

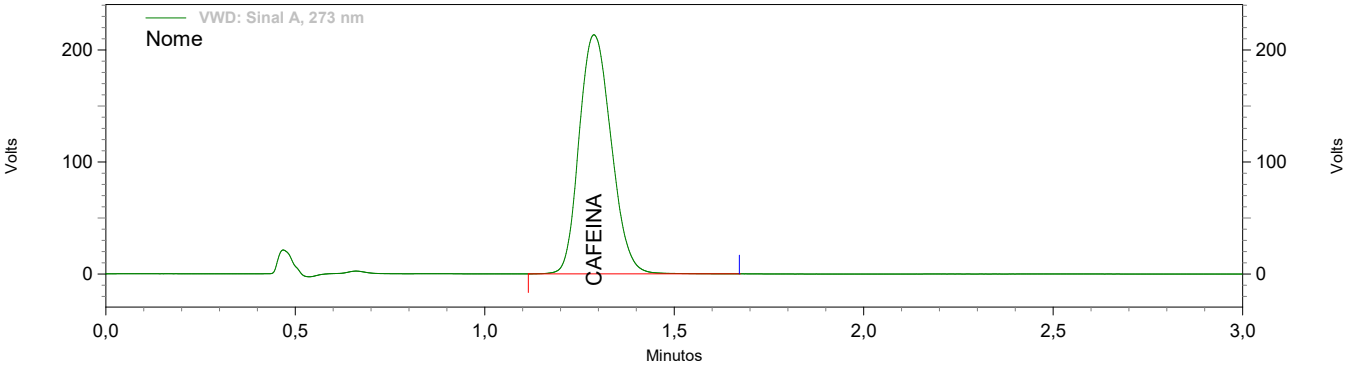


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,289	21064389	**0,000**

Totais			21064389	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 qualificação.seq2023-01-05 08-39-50 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 09:32:18 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:14:07 (GMT -03:00)

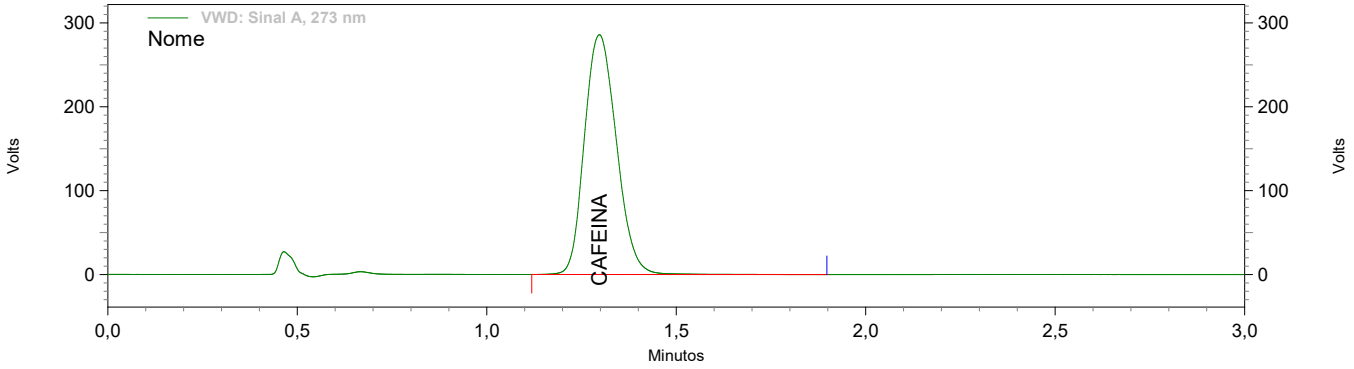


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	CAFEINA	1,297	28161232	**0,000**

Totais			28161232	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\GRADIENTE AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 GRADIENTE AB2023-01-05 12-10-31 (GMT -03-00).rslt\HPLC06.43 2023-01-05 12-12-37 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 12:12:54 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:24:08 (GMT -03:00)

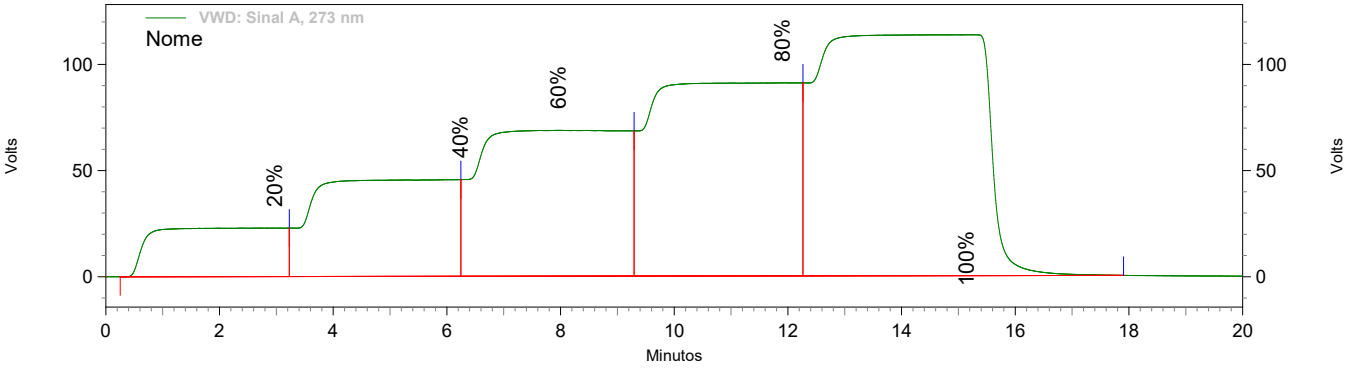


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
2	20%	2,970	382759	**0,000**
3	40%	6,241	763607	**0,000**
4	60%	7,959	1152115	**0,000**
5	80%	11,905	1524748	**0,000**
6	100%	15,142	1902823	**0,000**

Totais			5726052	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\GRADIENTE CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPLC06 GRADIENTE CD2023-01-05 12-15-53 (GMT -03-00).rslt\HPLC06.43 2023-01-05 12-33-08 (GMT -03-00).dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 12:33:26 (GMT -03:00)
Impresso: 08/01/2023 19:26:11 (GMT -03:00)

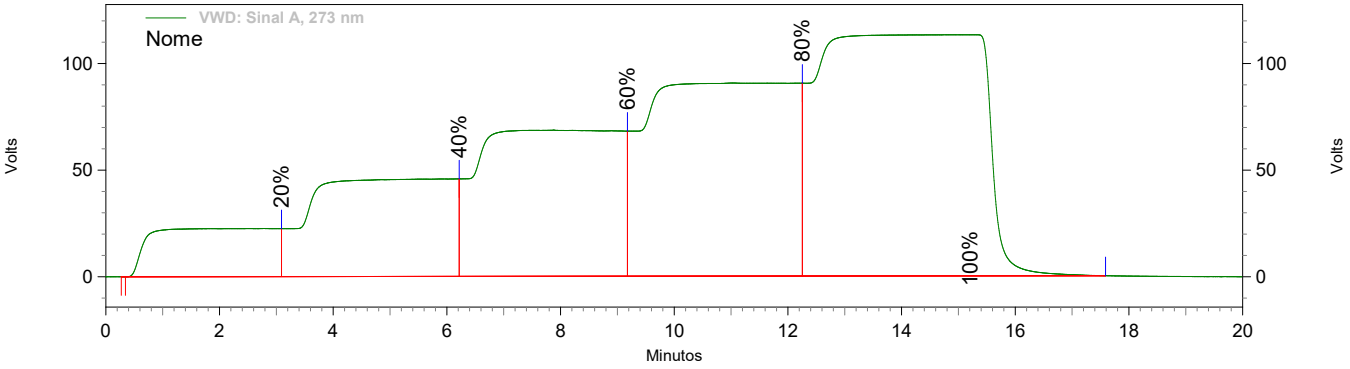

Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	3,092	376828	**0,000**
2	40%	6,217	767262	**0,000**
3	60%	9,178	1141459	**0,000**
4	80%	12,255	1517354	**0,000**
5	100%	15,205	1896934	**0,000**

Totais			5699837	**0,000**