

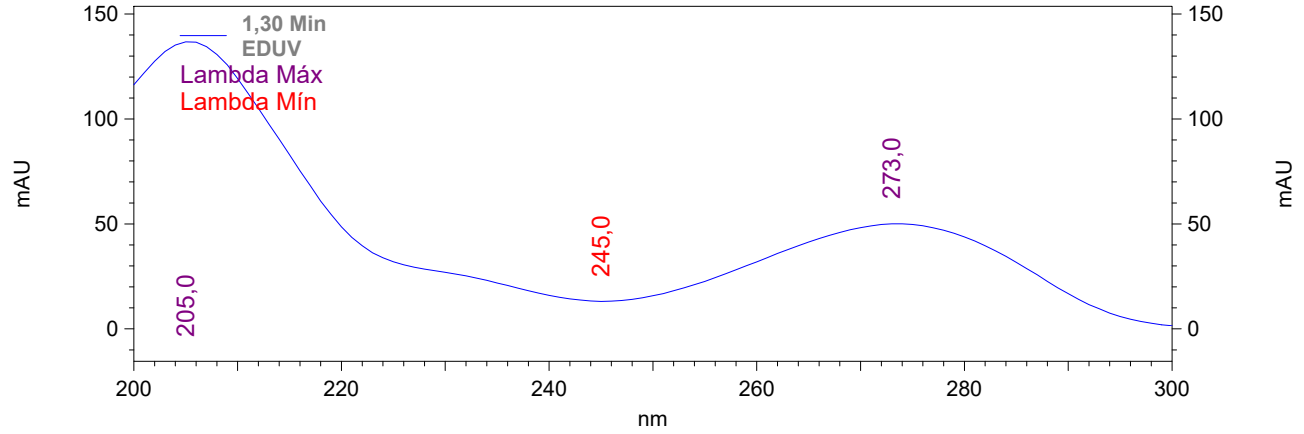
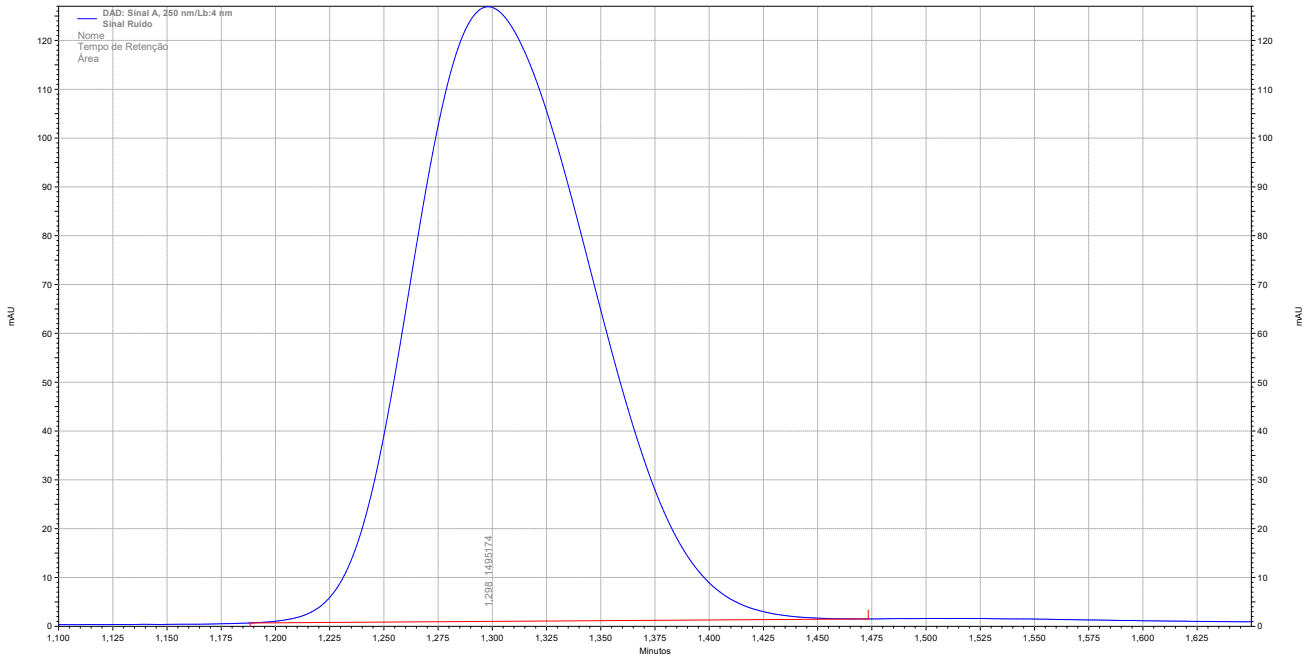


C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (G


DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm
Sinal Ruído
Nome
Tempo de Retenção
Área
mAU
mAU
1,298 1495174
Minutos
C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03

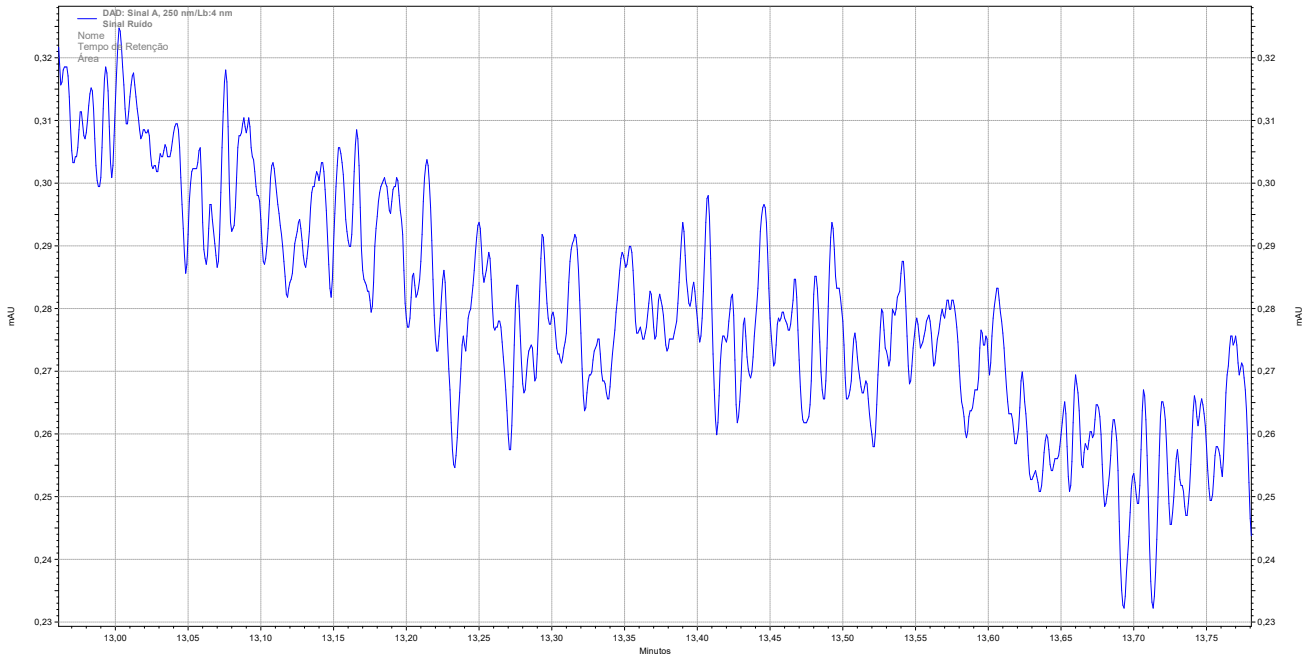


C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03

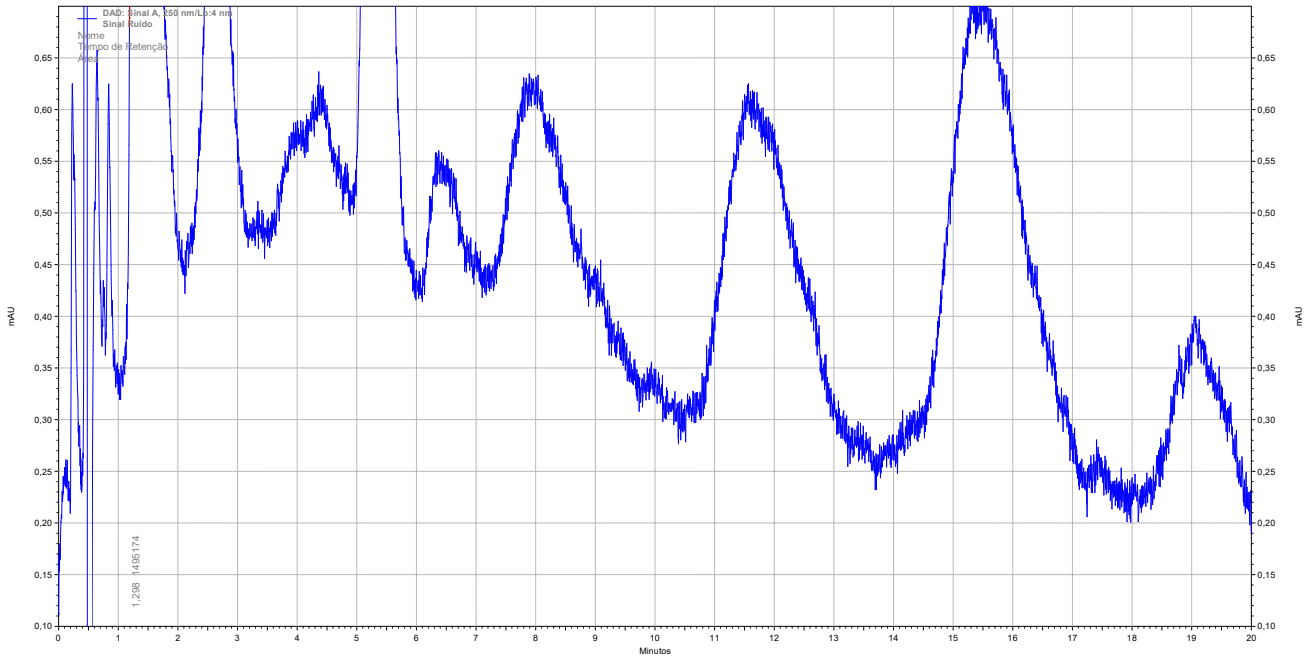

C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\Branco 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 12:58:25 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:09:42 (GMT -03:00)

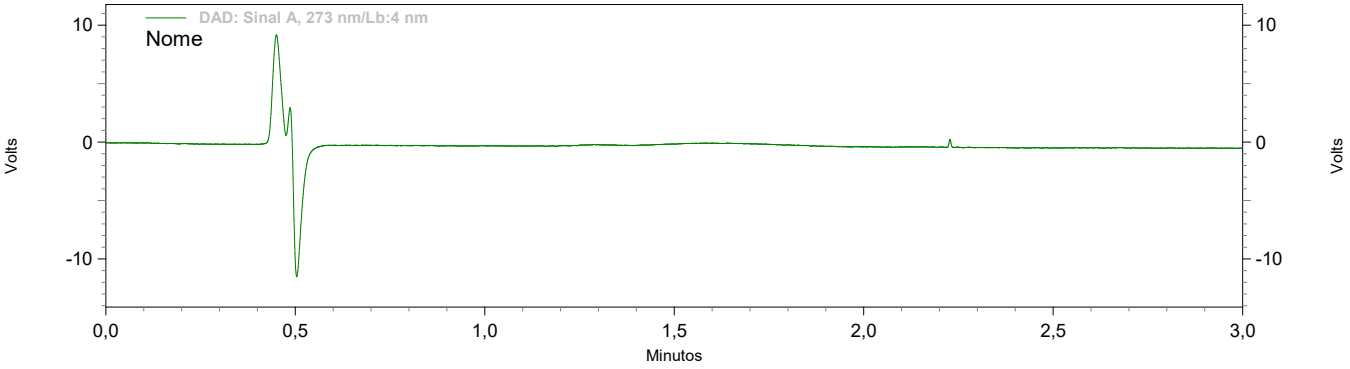


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:02:08 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:10:49 (GMT -03:00)

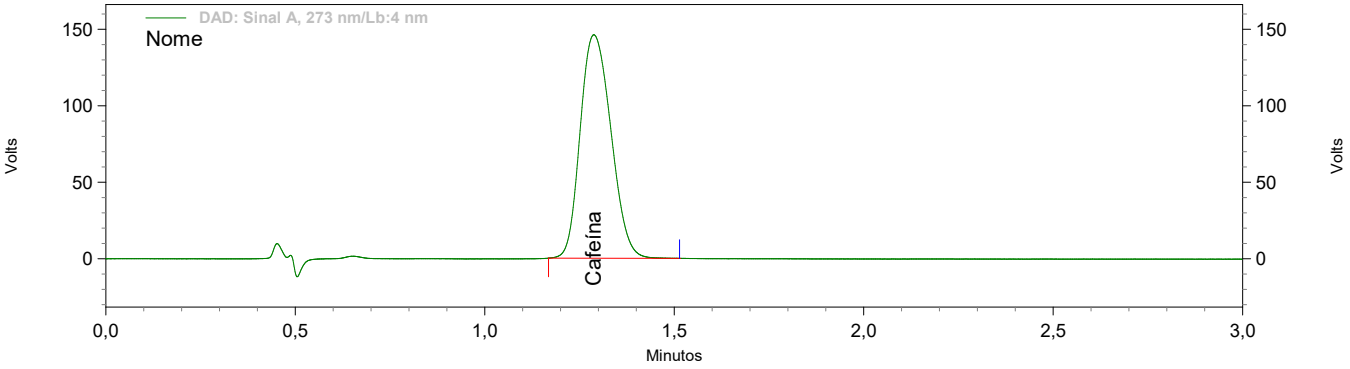


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	1728934	**0,000**
Totais			1728934	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:05:50 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:11:03 (GMT -03:00)

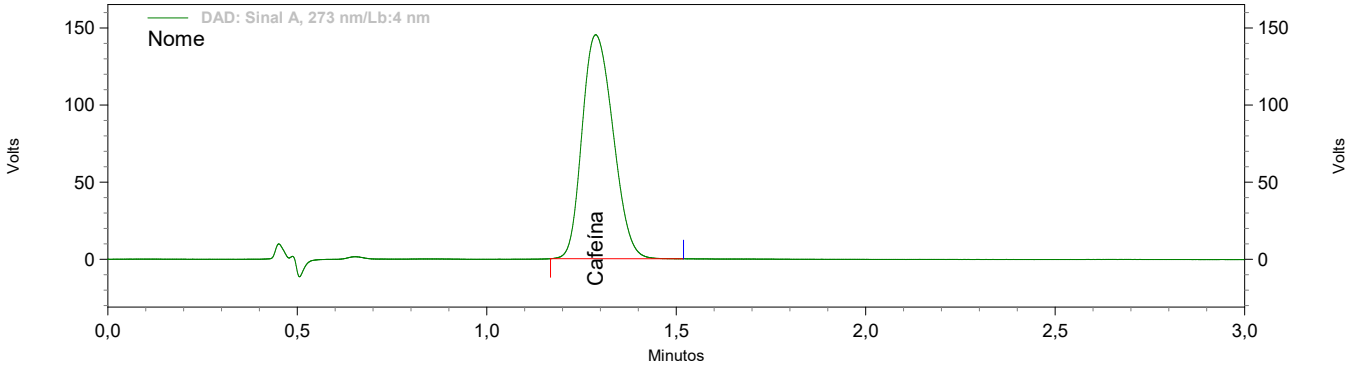


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	1729729	**0,000**
Totais			1729729	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:09:31 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:11:19 (GMT -03:00)

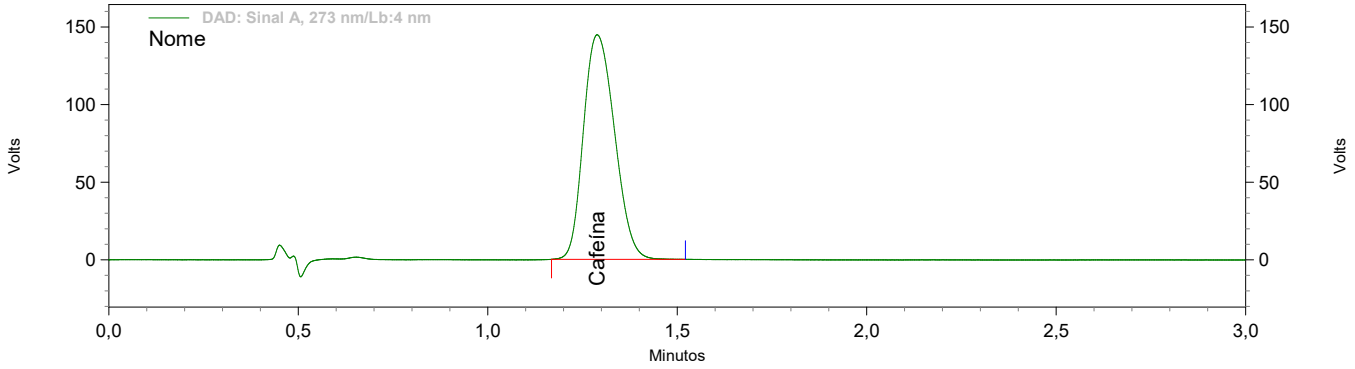


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,289	1734503	**0,000**

Totais			1734503	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\Branco 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:13:11 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:11:34 (GMT -03:00)

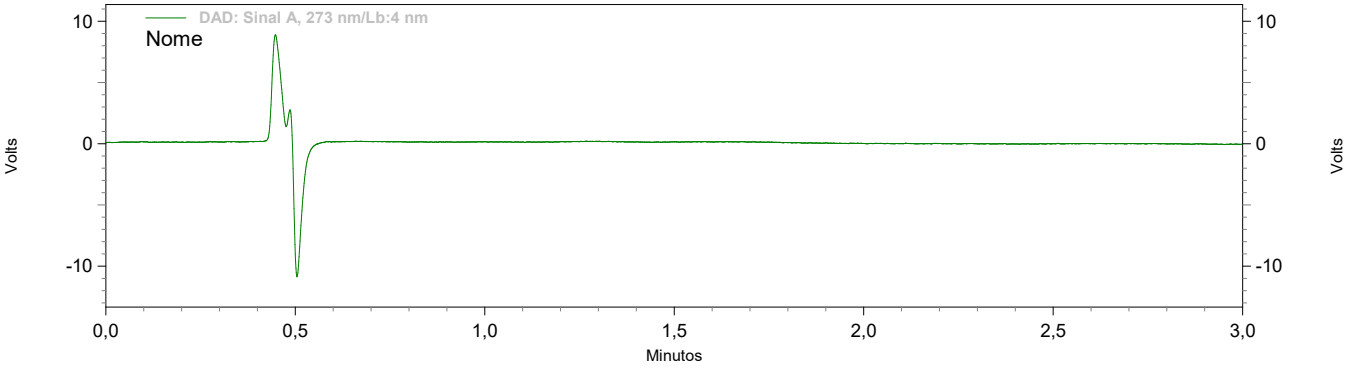


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:16:53 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:12:32 (GMT -03:00)

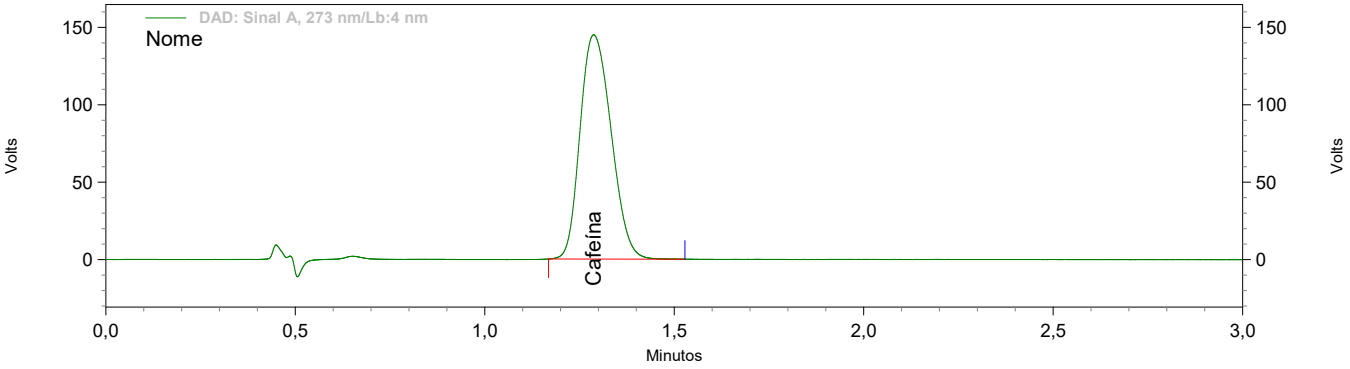


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	1734800	**0,000**
Totais			1734800	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:20:35 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:13:29 (GMT -03:00)

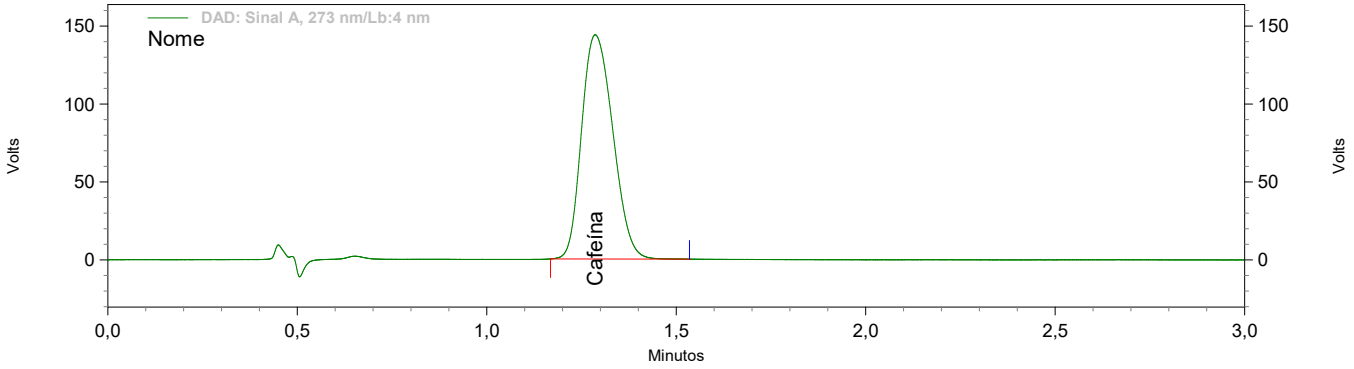


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,287	1730732	**0,000**
Totais			1730732	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:24:17 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:16:03 (GMT -03:00)

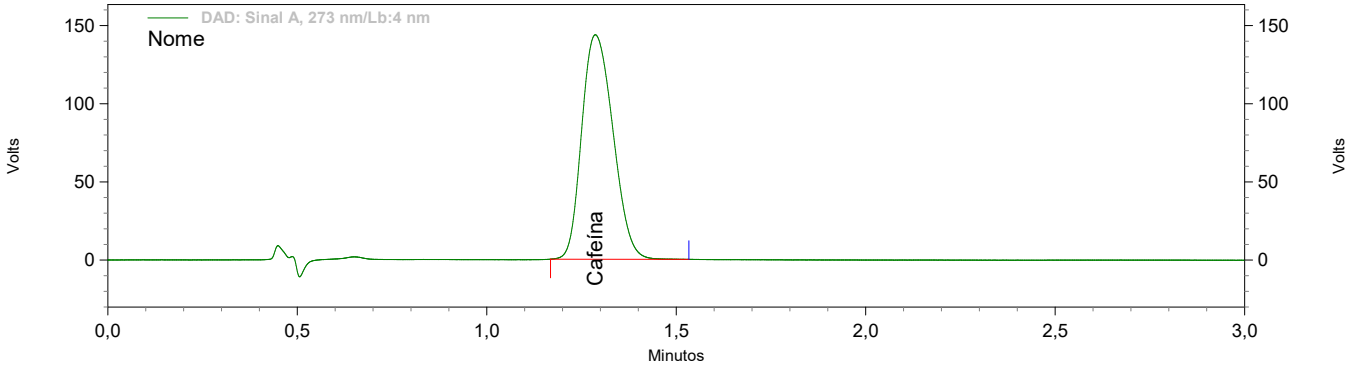


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,287	1730562	**0,000**
Totais			1730562	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\Branco 03.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:27:59 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:16:18 (GMT -03:00)

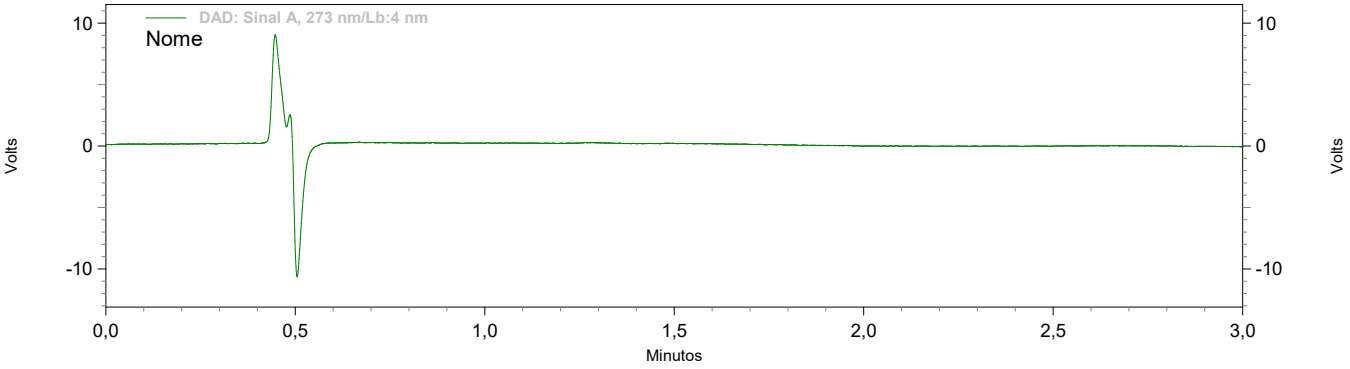


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:31:42 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:16:45 (GMT -03:00)

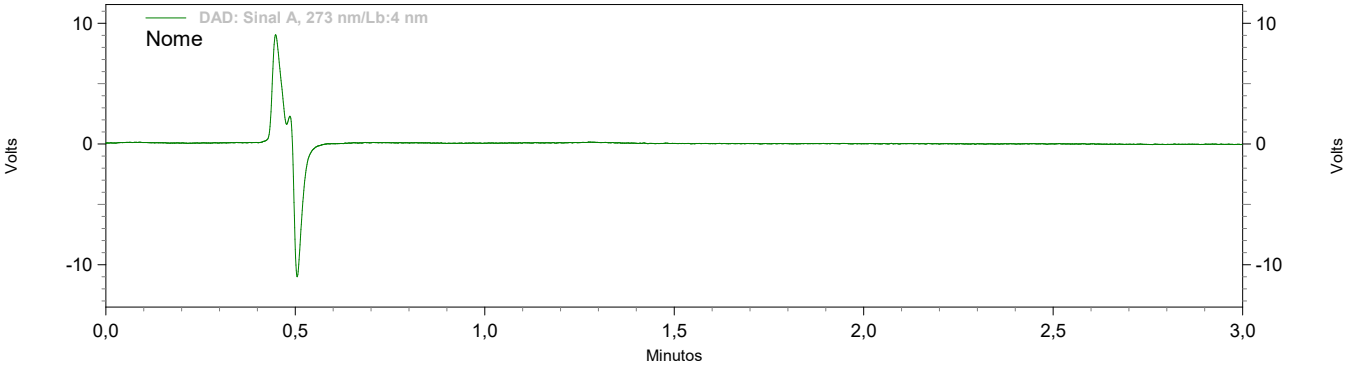


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:35:24 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:18:01 (GMT -03:00)

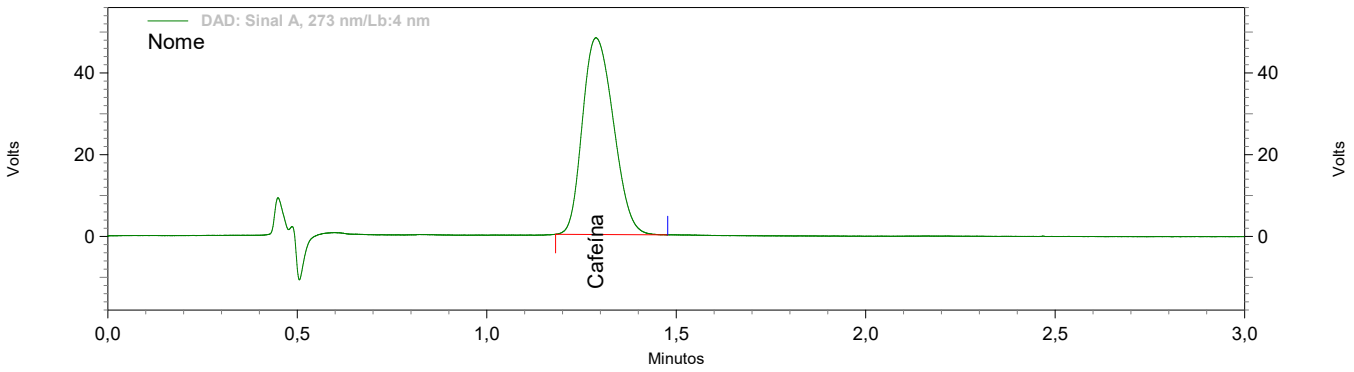


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	574719	**0,000**
Totais			574719	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:39:06 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:18:53 (GMT -03:00)

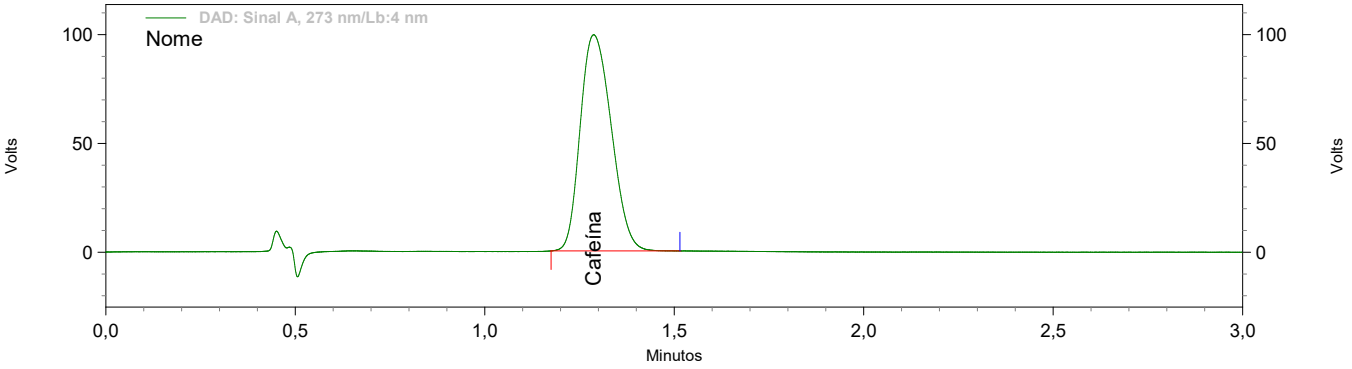


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	1190455	**0,000**
Totais			1190455	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:42:50 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:29:33 (GMT -03:00)

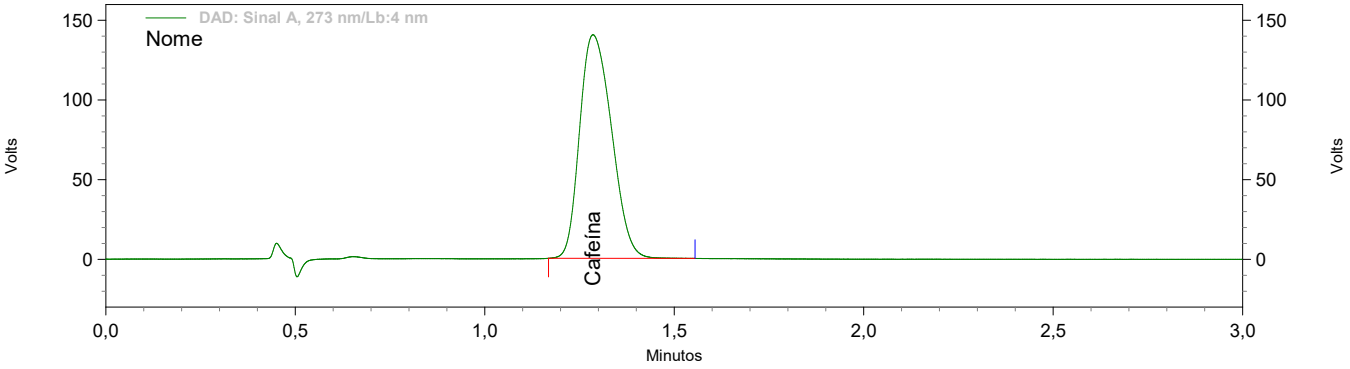


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,286	1724122	**0,000**
Totais			1724122	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:46:31 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:33:28 (GMT -03:00)

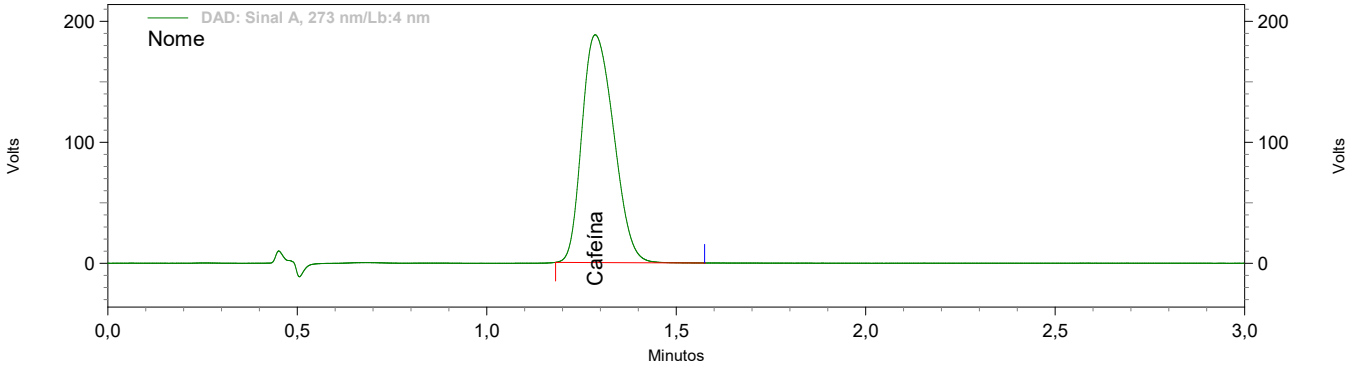


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,287	2305647	**0,000**
Totais			2305647	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:50:11 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:35:08 (GMT -03:00)

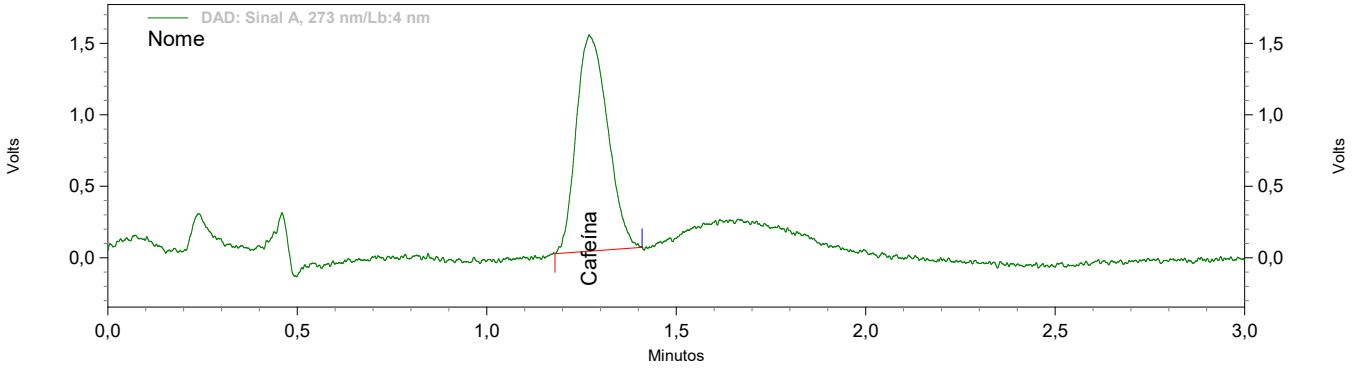


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,270	18258	**0,000**
Totais			18258	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:53:47 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:35:24 (GMT -03:00)

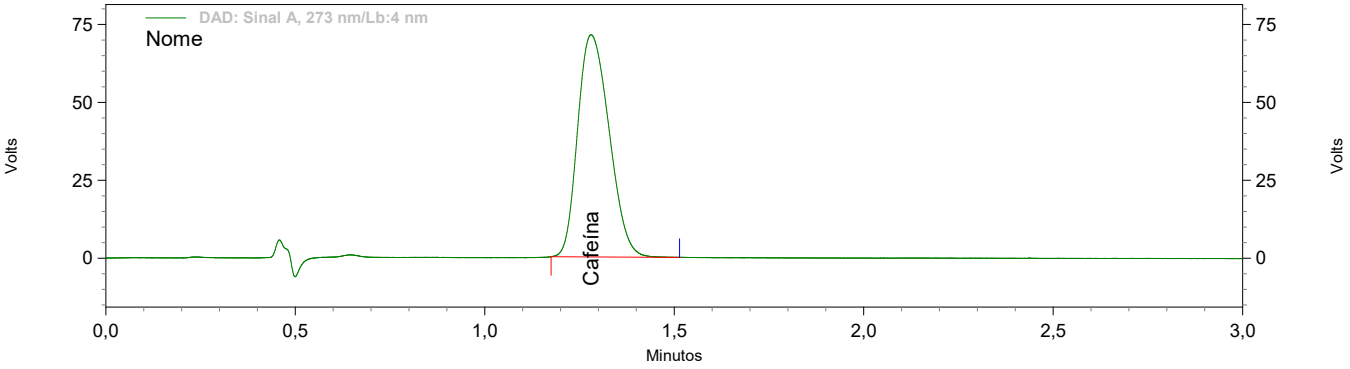


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,281	863872	**0,000**
Totais			863872	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 13:57:26 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:35:41 (GMT -03:00)

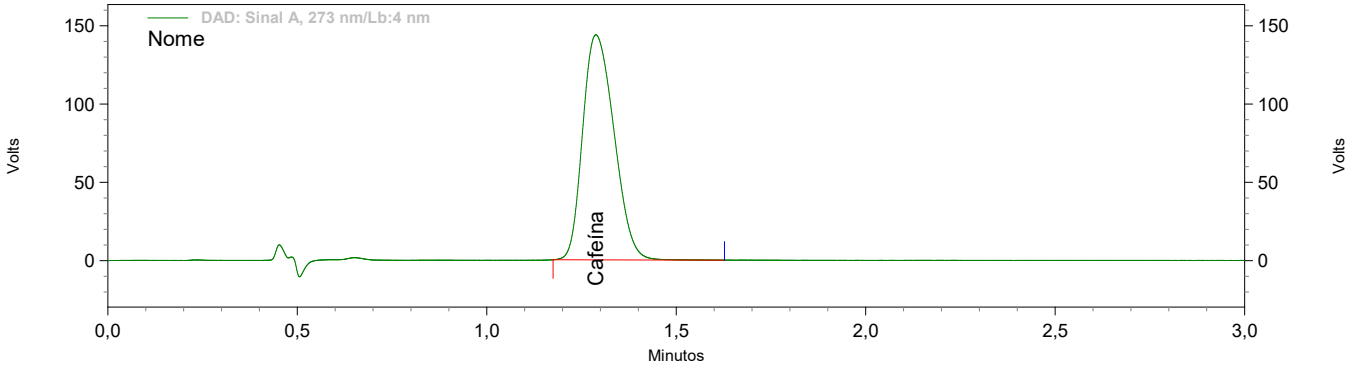


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,288	1735101	**0,000**
Totais			1735101	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:01:10 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:35:56 (GMT -03:00)

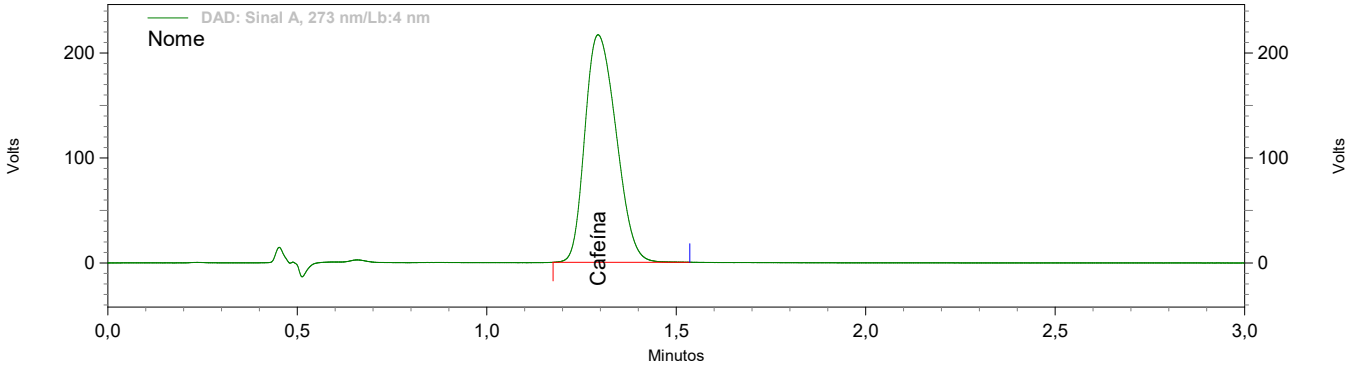


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,294	2603992	**0,000**
Totais			2603992	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\HPLC 18 Qualificação.seq2023-01-05 12-53-55 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:04:54 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:36:14 (GMT -03:00)

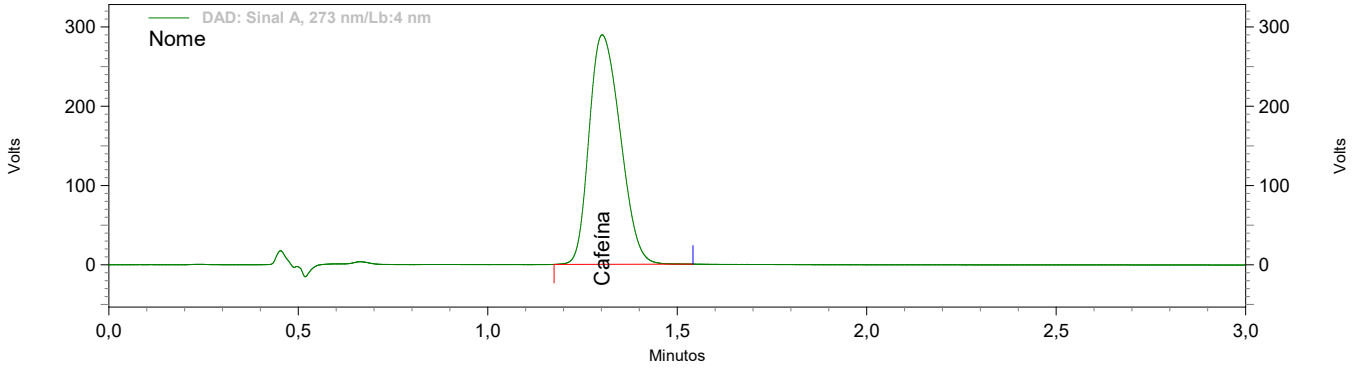


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,302	3470959	**0,000**
Totais			3470959	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Gradiente.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Gradiente HPLC 182023-01-05 15-42-59 (GMT -03-00).rslt\Gradiente HPLC 18-Rep1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:47:50 (GMT -03:00)
Impresso: 16/01/2023 20:55:02 (GMT -03:00)

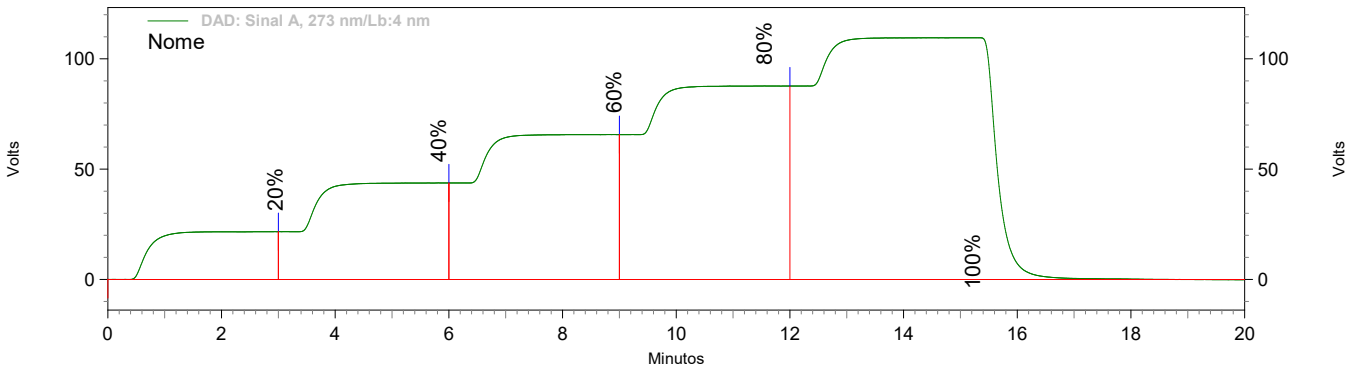

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20%	2,947	45396	**0,000**
2	40%	5,820	91765	**0,000**
3	60%	8,907	137743	**0,000**
4	80%	11,553	183924	**0,000**
5	100%	15,213	229765	**0,000**

Totais			688593	**0,000**