


Spectral Scan - VWD [DE82800819]
Absorbance [mAU]
600
500
400
300
200
100
0
(204, 616.029249)
(273, 234.430436)
(245, 51.808209)
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\Sinal-Ruido_002
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 16:14:21 (GMT -03:00)
Impresso: 14/01/2023 18:20:39 (GMT -03:00)

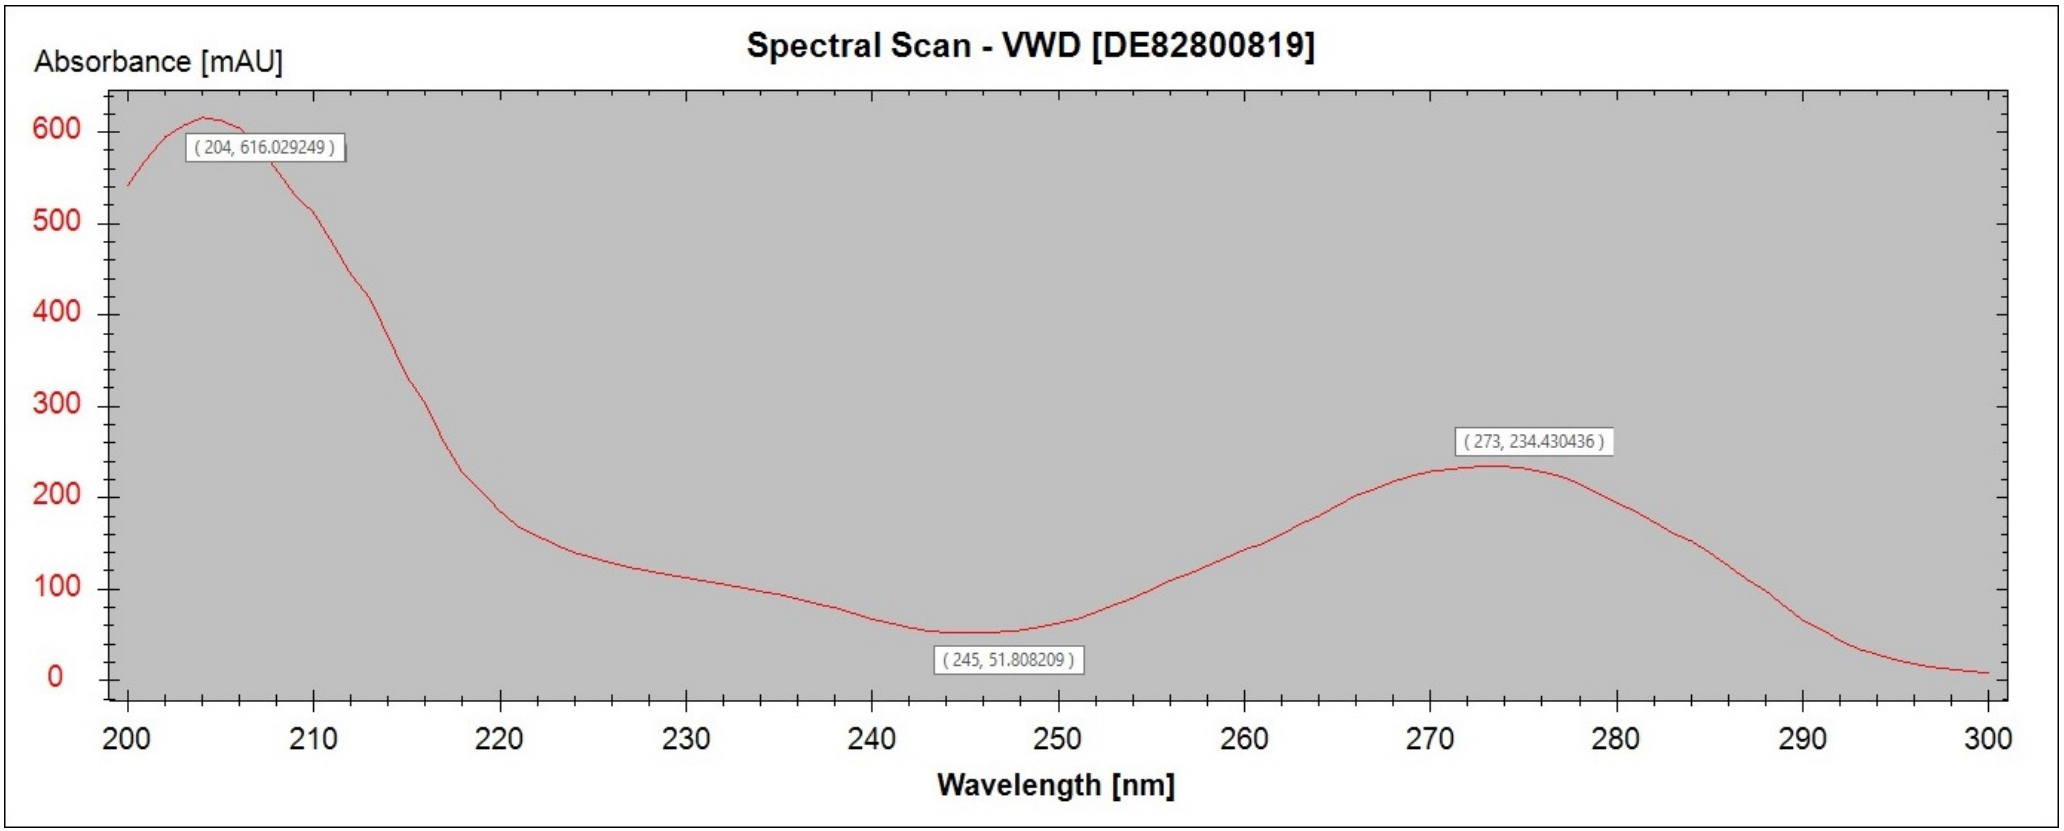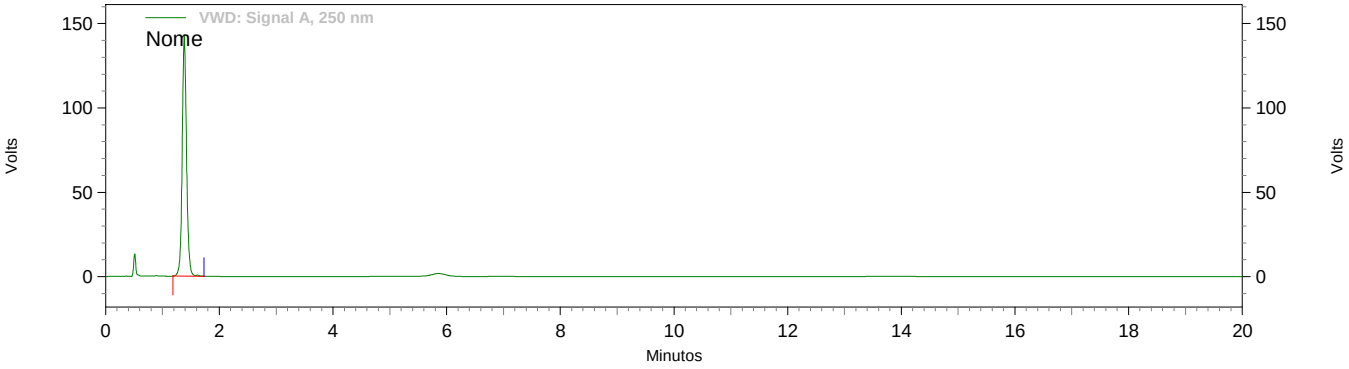

Resultados VWD:
Signal A, 250 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*

Relatório SRELB

Detector VWD – G1314D – N/S DE82800819	Data: 05/01/2023
Ruído:	
Valor máximo: 0.0536 mAU	**Diferença: 0.0086 mAU**
Valor mínimo: 0.0450 mAU	




Estabilidade da Linha de Base:	
Valor máximo: 0.104 mAU	**Diferença (em 20 minutos): 0.029 mAU**
Valor mínimo: 0.075 mAU	**Diferença (em 60 minutos): 0.029 x 3 = 0.087 mAU**

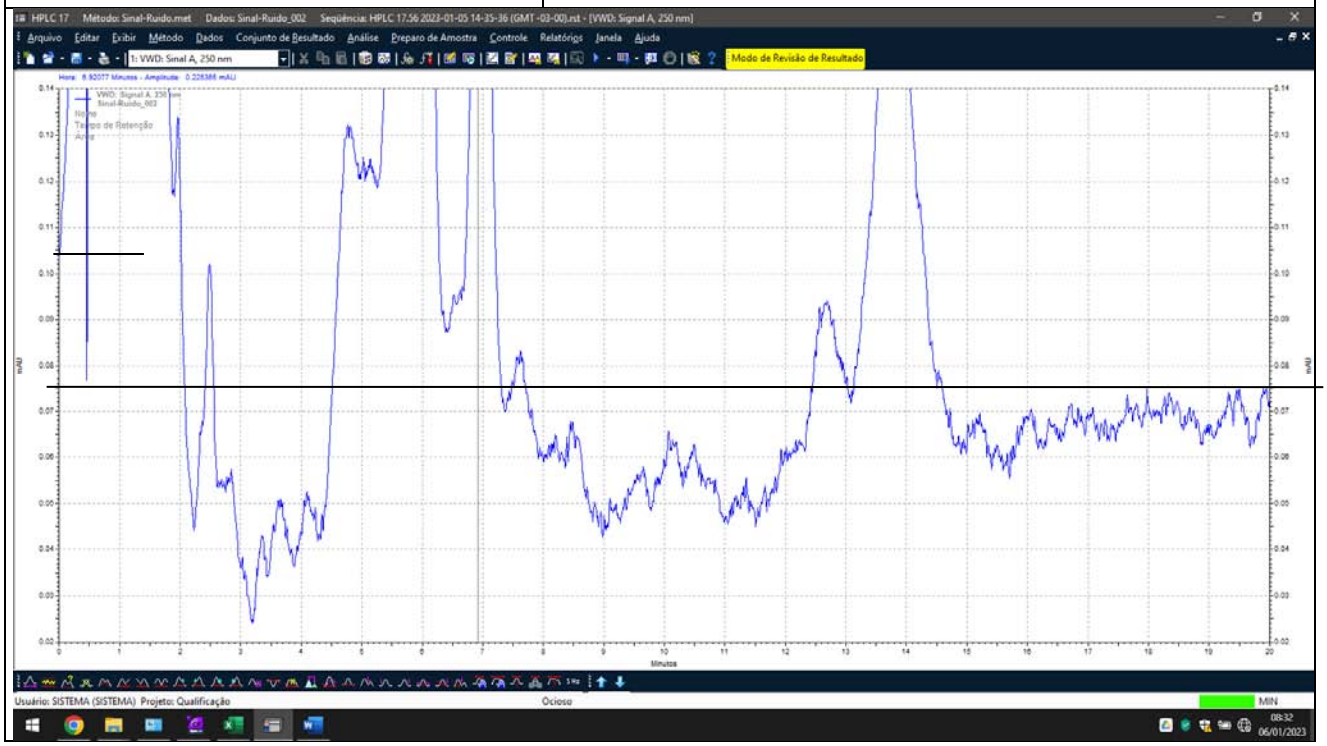


Altura do Pico:

Valor: 143.429 mAU

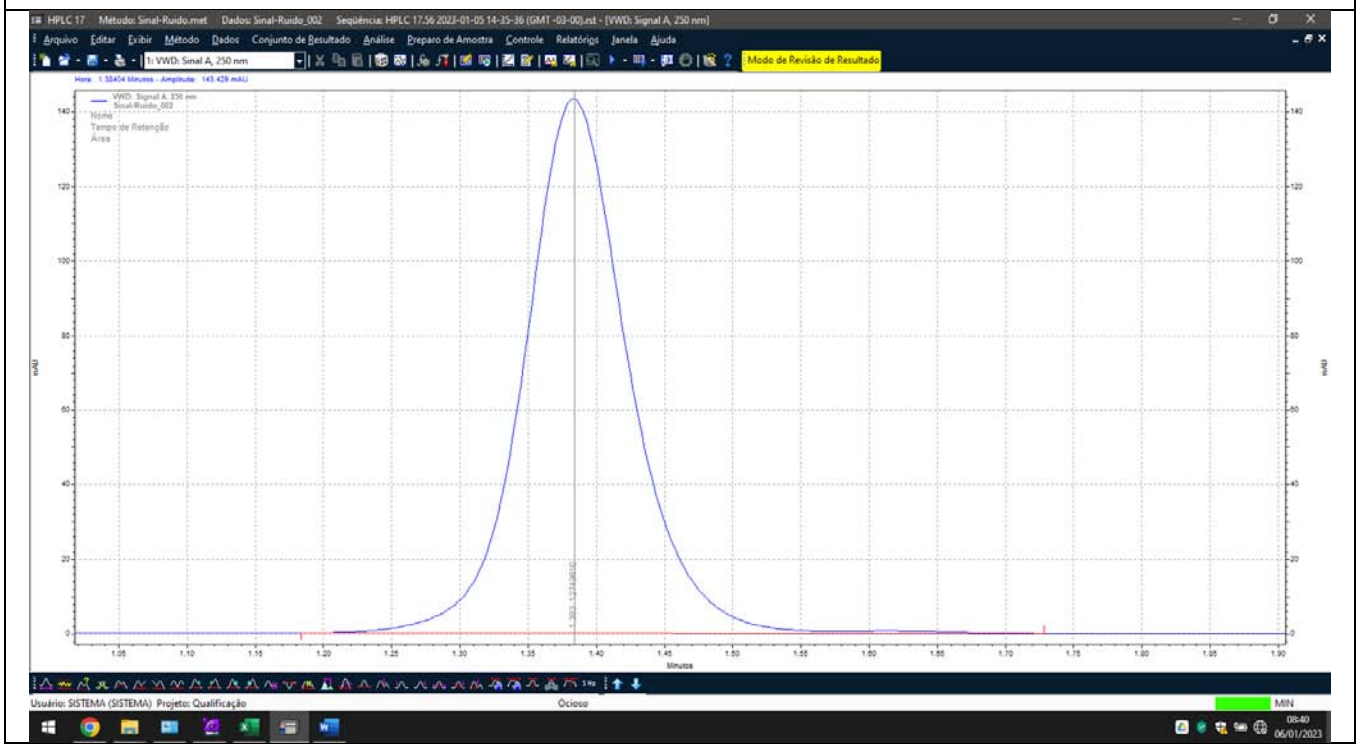

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 14:36:59 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 14:56:26 (GMT -03:00)**

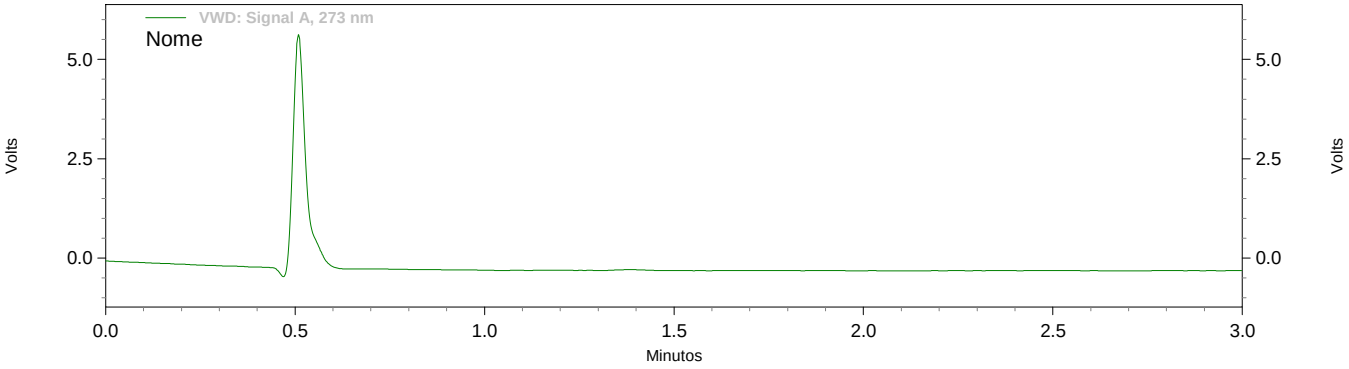


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 1
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:41:00 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 14:57:53 (GMT -03:00)

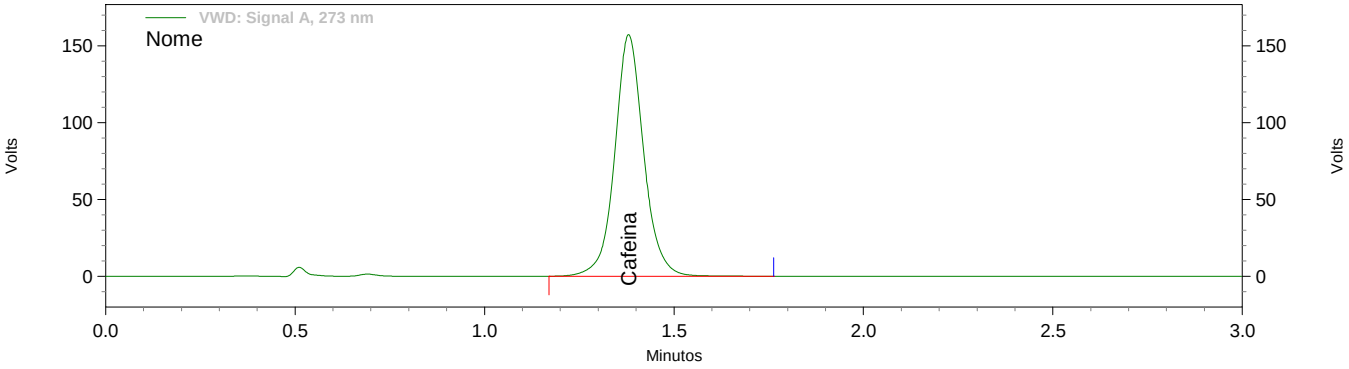


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.380	14015666	**0.000**

Totais			14015666	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:44:59 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 14:58:33 (GMT -03:00)

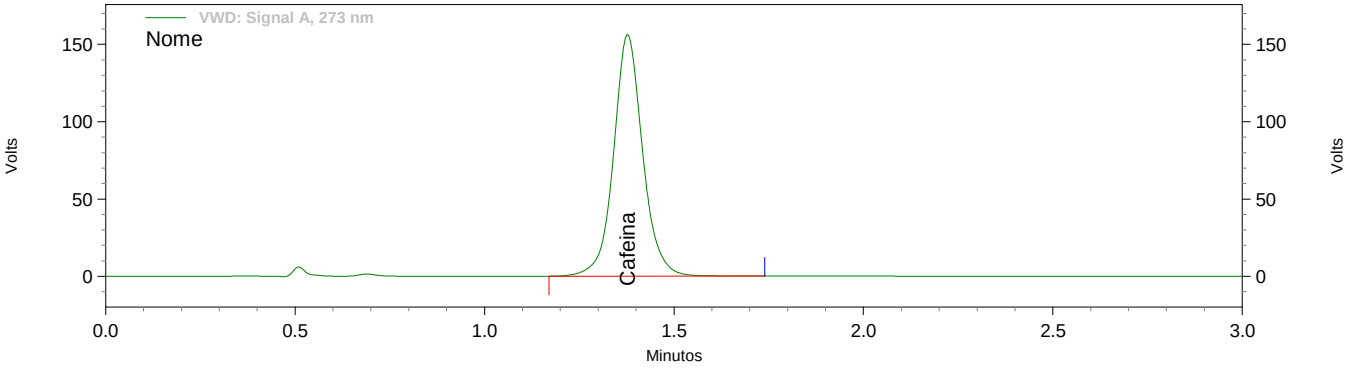


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.377	13998840	**0.000**

Totais			13998840	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:48:58 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 14:58:58 (GMT -03:00)

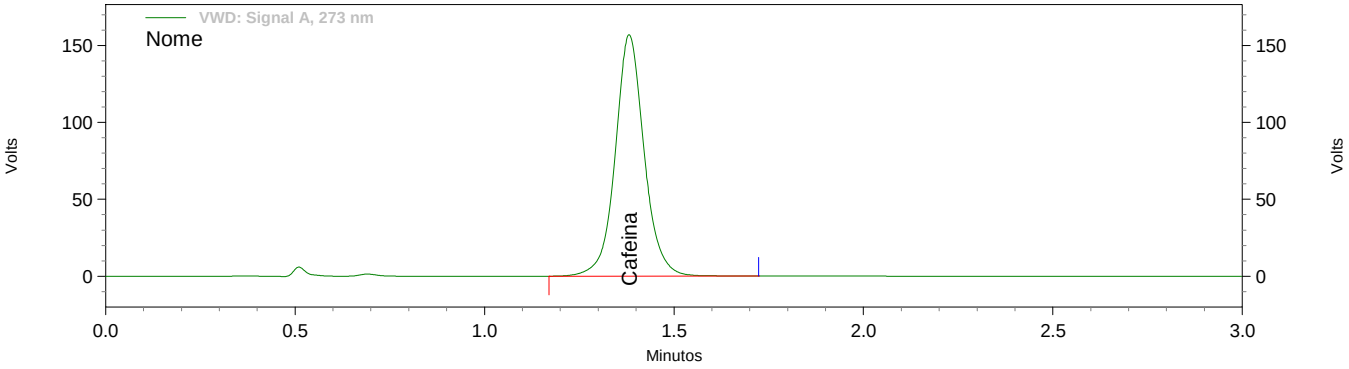


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.382	13981360	**0.000**

Totais			13981360	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\Branco 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 14:53:02 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:01:18 (GMT -03:00)**

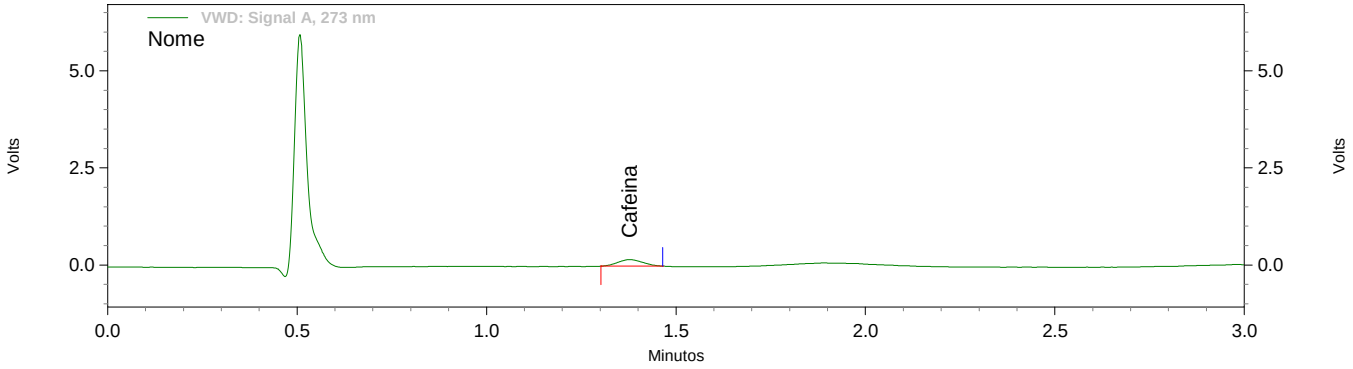


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.377	12762	**0.000**

Totais			12762	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 14:57:01 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:01:55 (GMT -03:00)

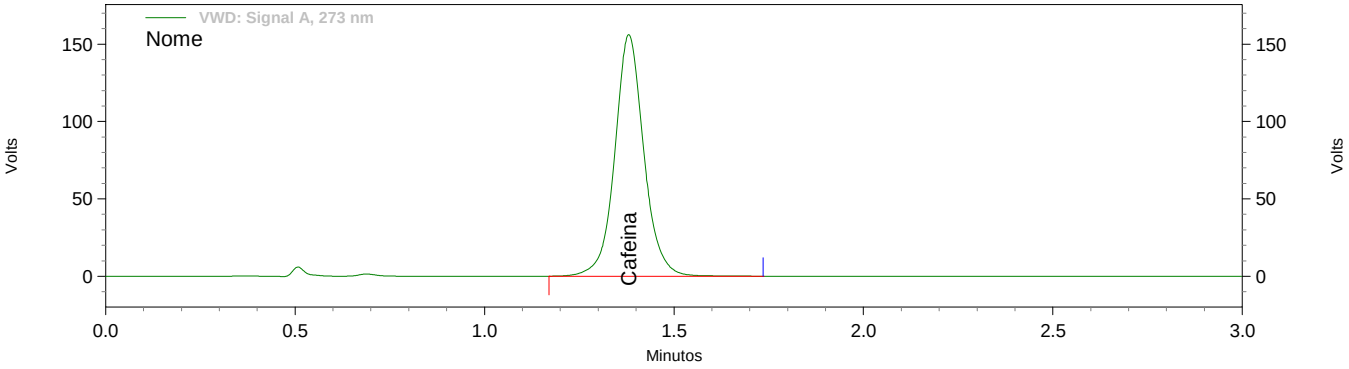


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.380	13971245	**0.000**

Totais			13971245	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:01:02 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:04:40 (GMT -03:00)

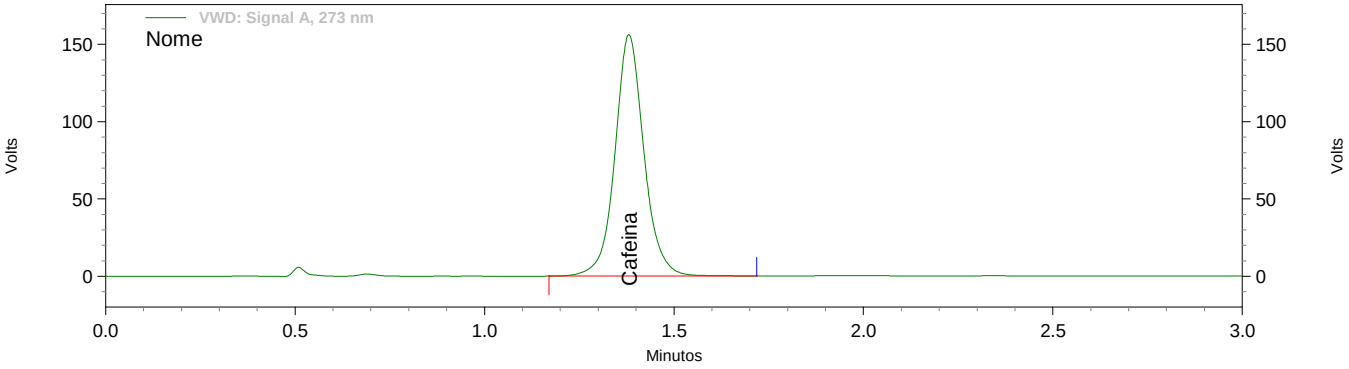


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.382	13929642	**0.000**

Totais			13929642	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\PCIN 6
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:05:01 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:16:33 (GMT -03:00)

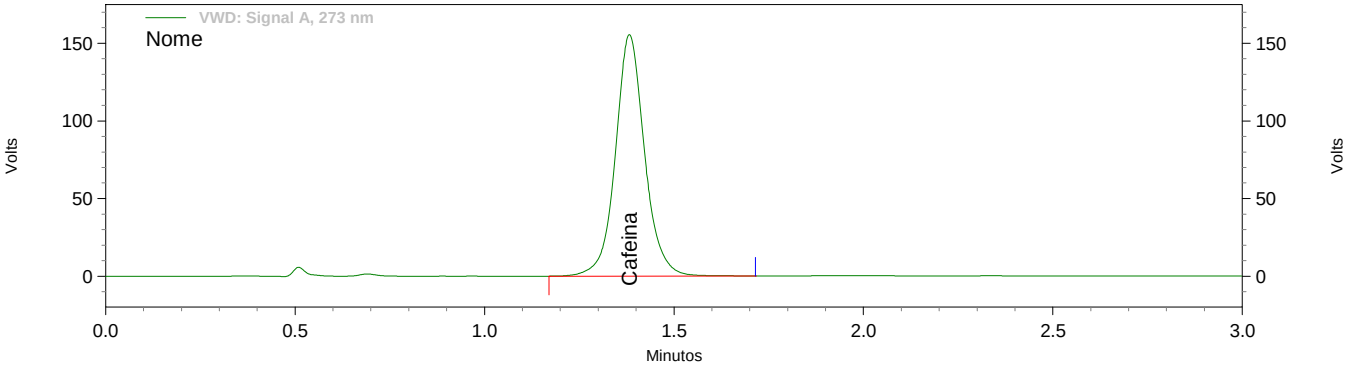


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.382	13952180	**0.000**

Totais			13952180	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:09:04 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:17:10 (GMT -03:00)**

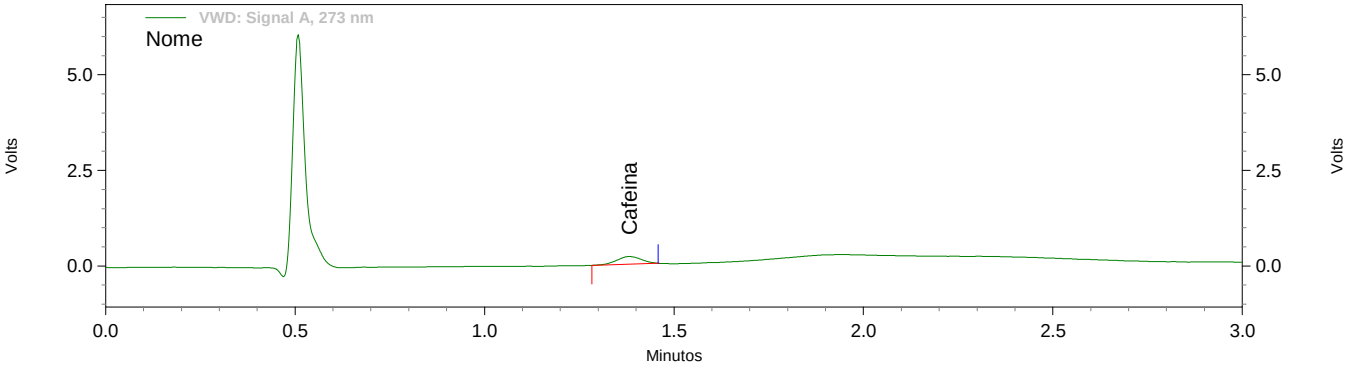


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.382	15087	**0.000**

Totais			15087	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LDUV 1**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:13:05 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:20:57 (GMT -03:00)**

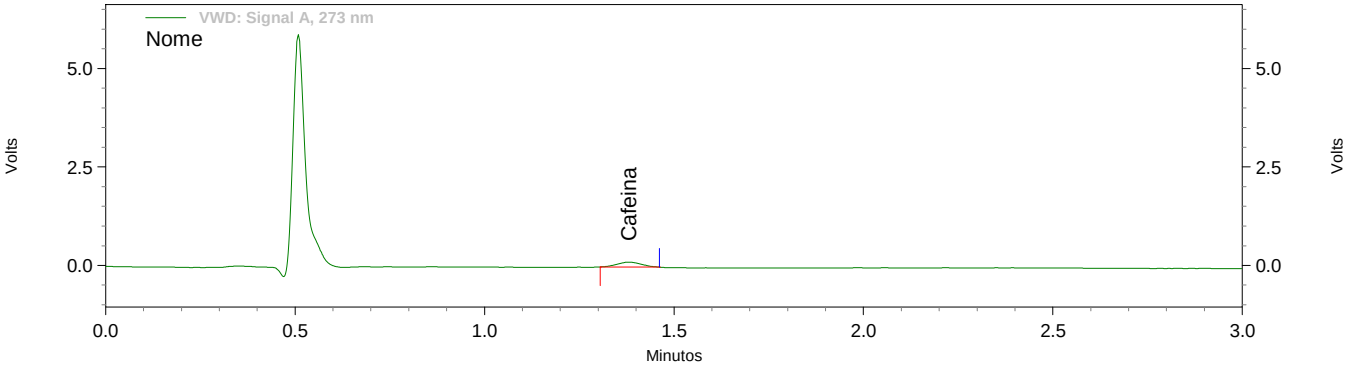


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.380	9126	**0.000**

Totais			9126	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LDUV 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:17:03 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:21:45 (GMT -03:00)

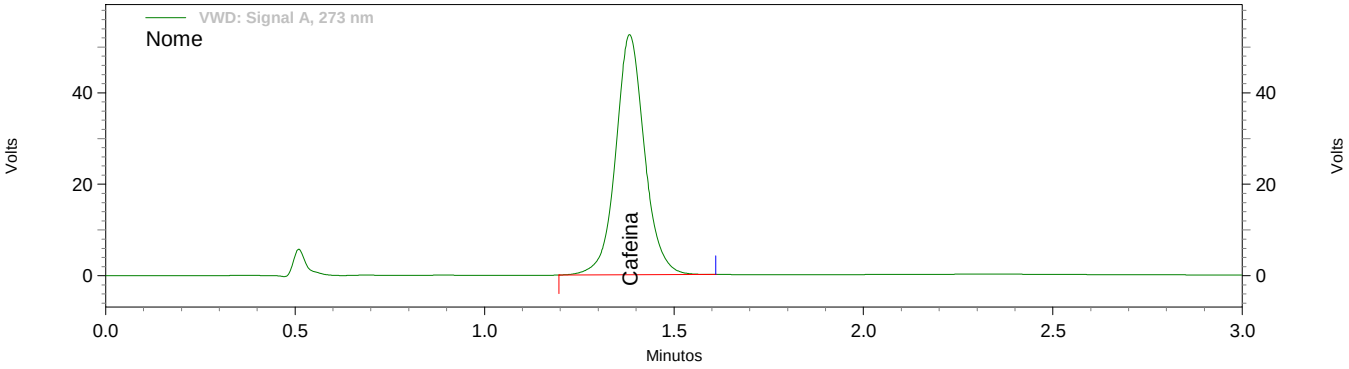


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.383	4636400	**0.000**

Totais			4636400	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LDUV 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:21:04 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:24:56 (GMT -03:00)**

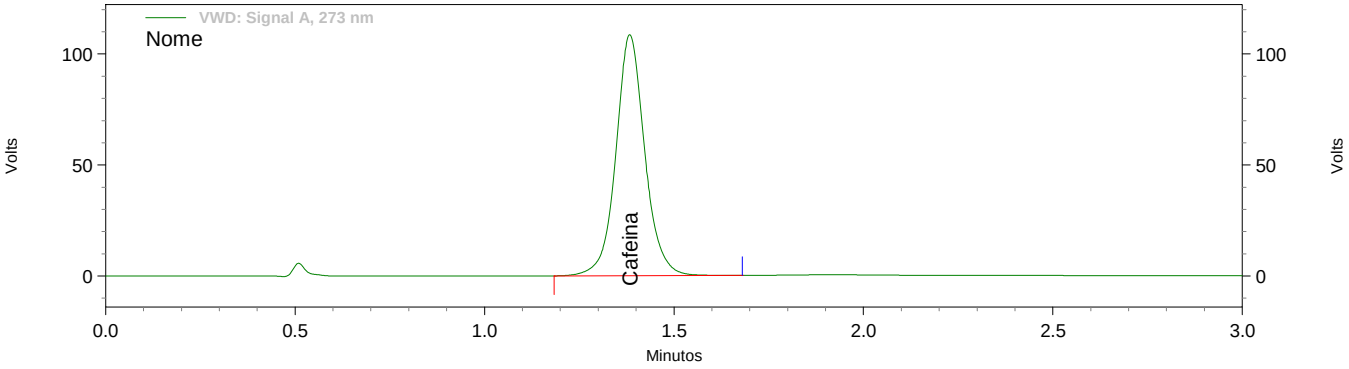


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.383	9649810	**0.000**

Totais			9649810	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LDUV 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:25:06 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:28:52 (GMT -03:00)

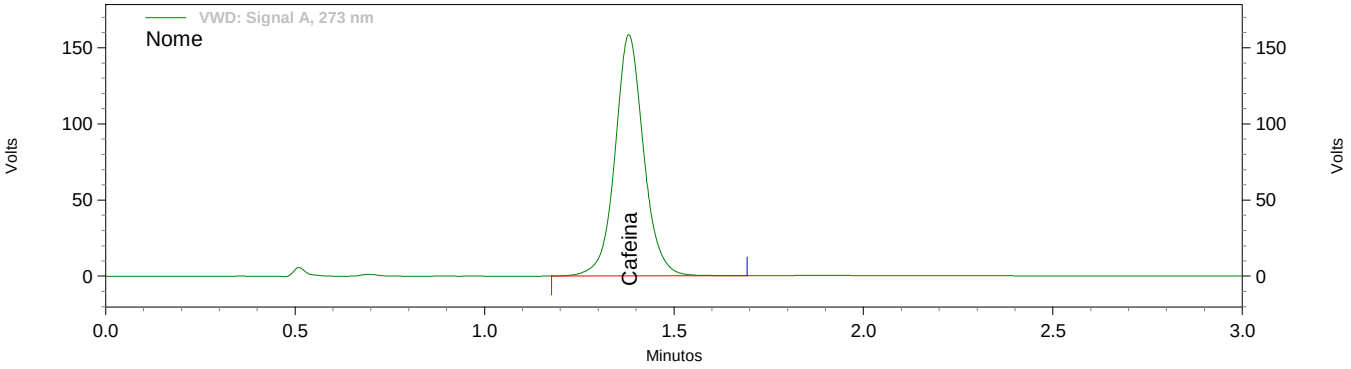


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.382	13956811	**0.000**

Totais			13956811	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LDUV 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 05/01/2023 15:29:08 (GMT -03:00)
Impresso: 05/01/2023 15:33:20 (GMT -03:00)

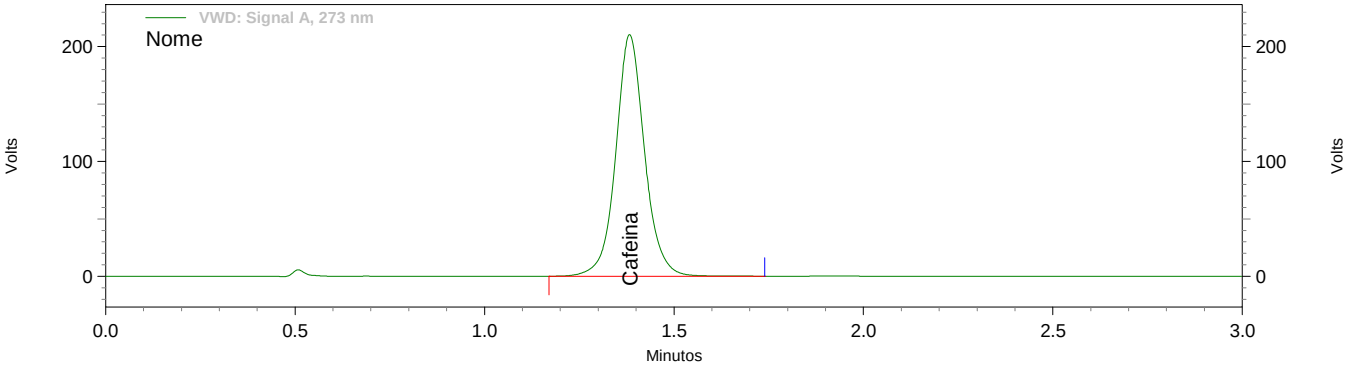


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.383	18665163	**0.000**

Totais			18665163	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LIIN 1**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:33:03 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:42:11 (GMT -03:00)**

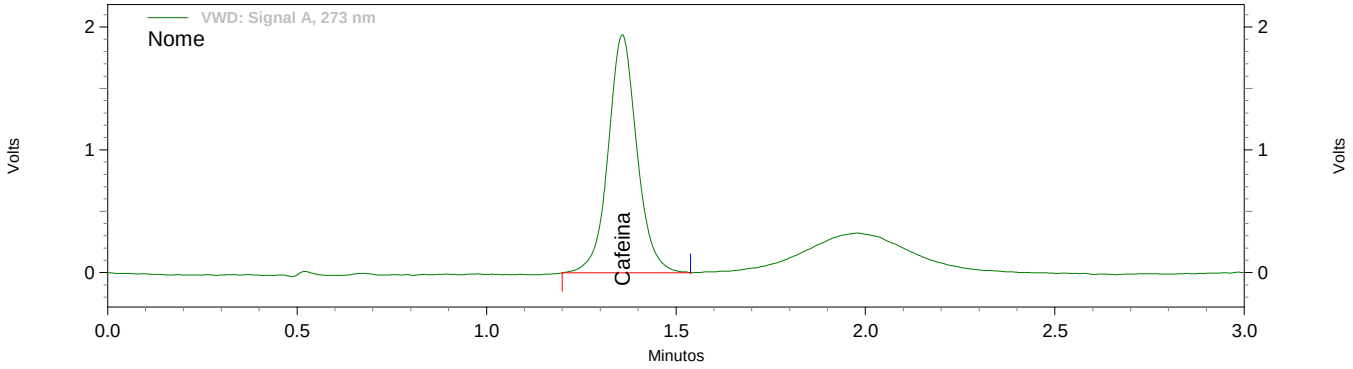


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.358	171422	**0.000**

Totais			171422	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LIIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:37:01 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:42:34 (GMT -03:00)**

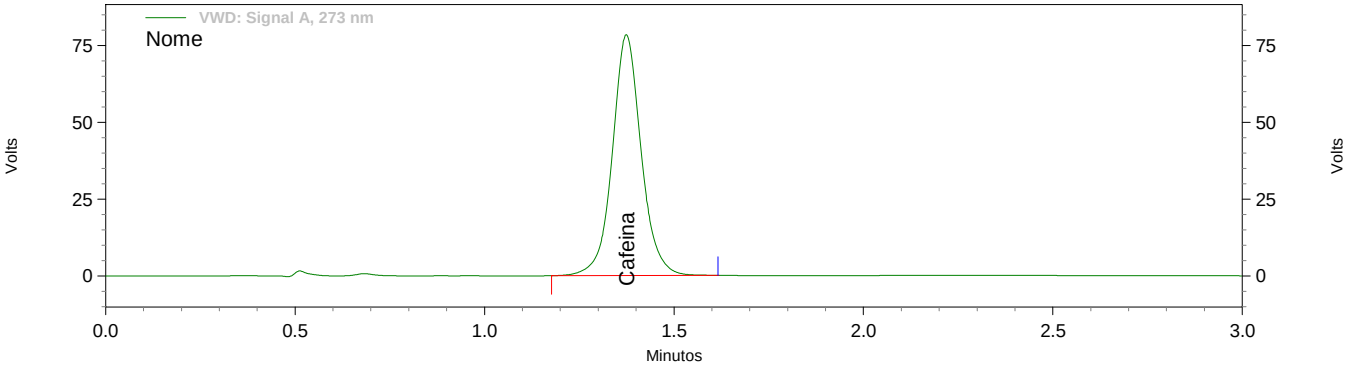


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.375	6952418	**0.000**
Totais			6952418	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LIIN 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:40:56 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:47:53 (GMT -03:00)**

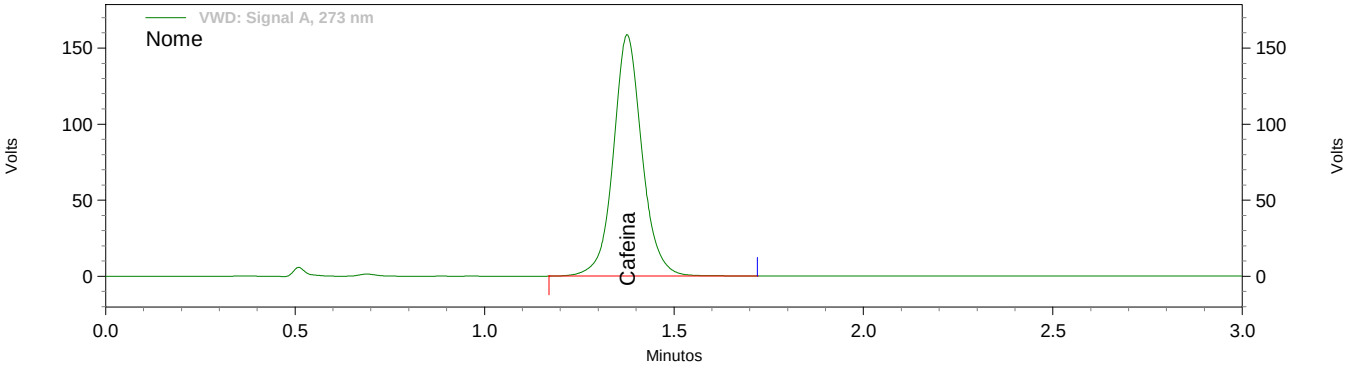


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.377	14008690	**0.000**

Totais			14008690	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LIIN 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:45:00 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:48:28 (GMT -03:00)**

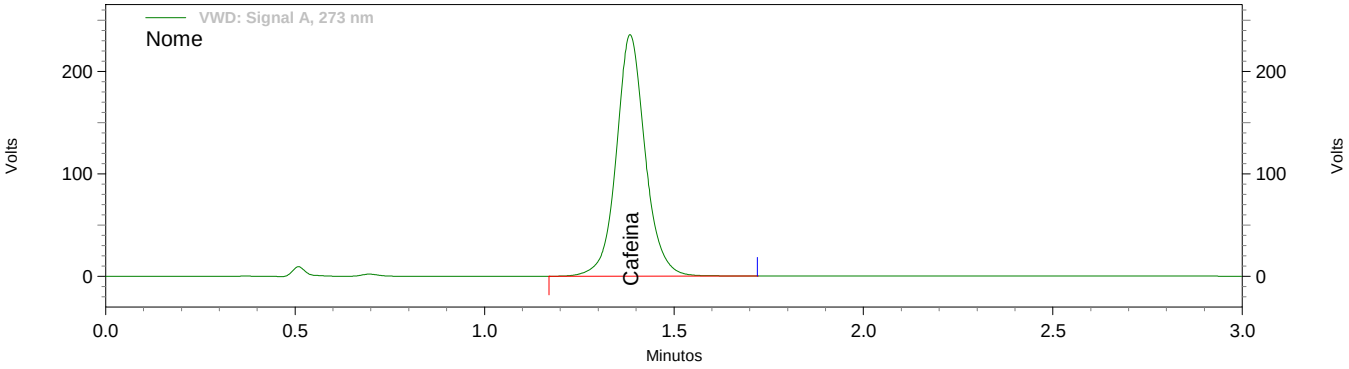


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.385	20948359	**0.000**

Totais			20948359	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Qualificação\HPLC 17.56 2023-01-05 14-35-36 (GMT -03-00).rslt\LIIN 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **05/01/2023 15:49:06 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/01/2023 15:53:29 (GMT -03:00)**

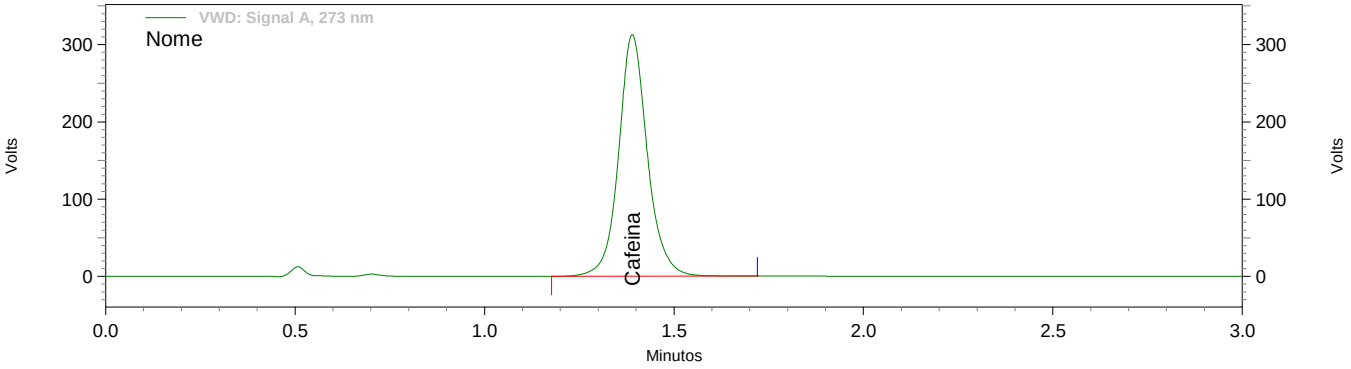


Resultados VWD: Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.390	27714229	**0.000**
Totais			27714229	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Grad AB\Grad AB001.rslt\Grad AB001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2023 09:20:37 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 09:48:25 (GMT -03:00)

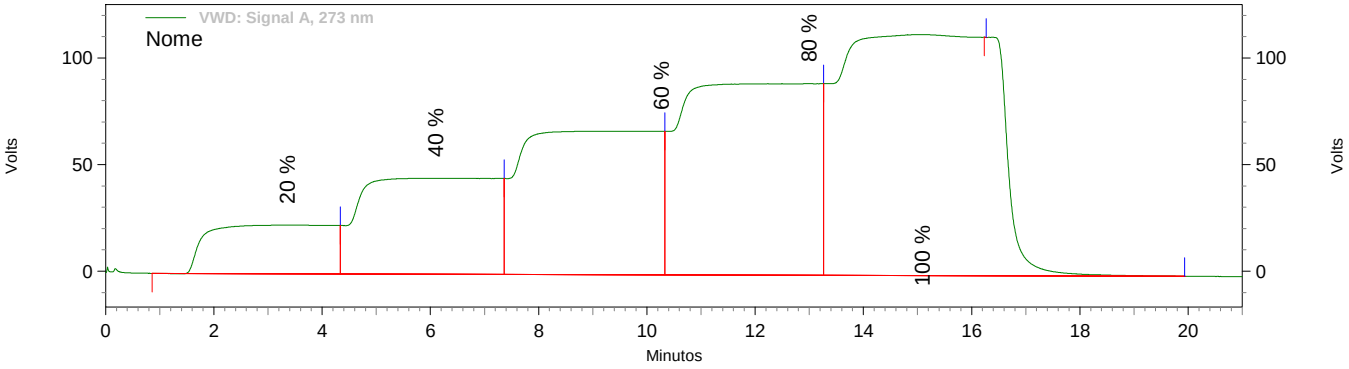


Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.357	382703	**0.000**
2	40 %	6.093	754523	**0.000**
3	60 %	10.262	1129946	**0.000**
4	80 %	12.997	1507221	**0.000**
5	100 %	15.088	1895505	**0.000**

Totais			5669898	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\HPLC 17\Grad CD\Grad CD002.rslt\Grad CD002.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 06/01/2023 10:22:54 (GMT -03:00)
Impresso: 06/01/2023 10:48:32 (GMT -03:00)

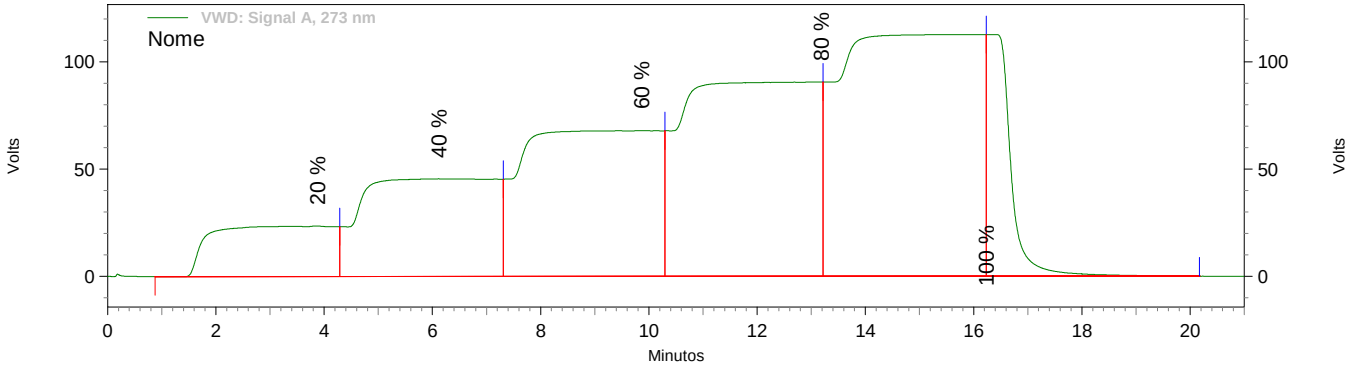

Resultados VWD:
Signal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.877	395040	**0.000**
2	40 %	6.117	762962	**0.000**
3	60 %	9.870	1139191	**0.000**
4	80 %	13.187	1519540	**0.000**
5	100 %	16.232	1889184	**0.000**

Totais			5705917	**0.000**