Spectrum Scan

SPD-20A(Detector A)

Pump Off

Background

Scan


Help

Scan Parameters

Start Wavelength: 200 nm

Stop Wavelength: 300 nm

Scan Step: 1 nm

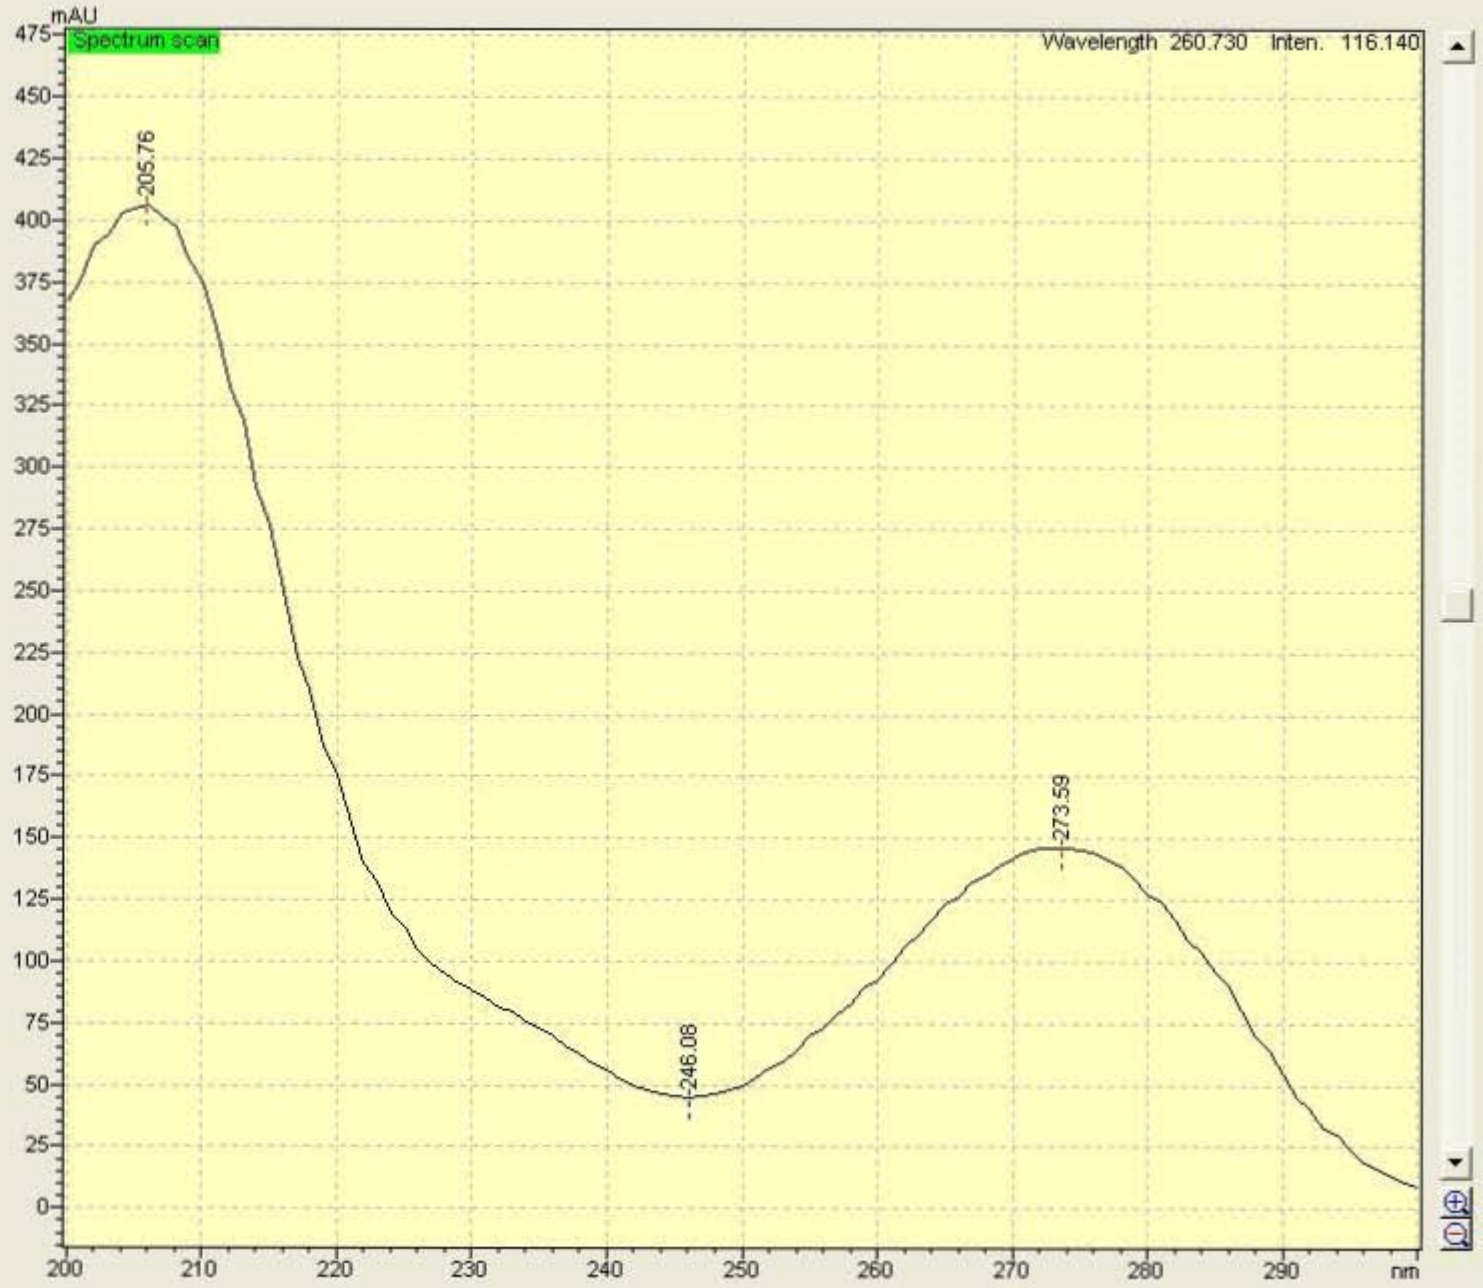


Iniciar LCsolution LC Real Time Analysis... LC Postrun Analysis (... 08:45

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\Branco 1.lcd

Sample Name : Branco 1
Sample ID : Branco 1
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 08:52:44

Resultados

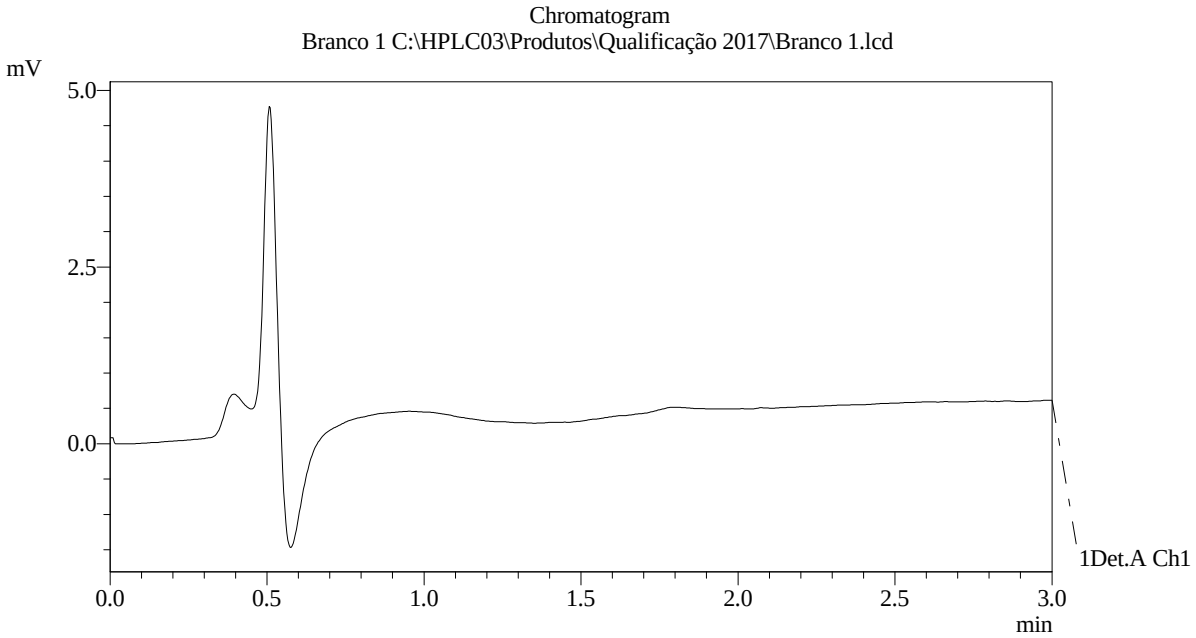

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 1.lcd

Sample Name : PCIN 1
Sample ID : PCIN 1
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 08:56:12

Resultados

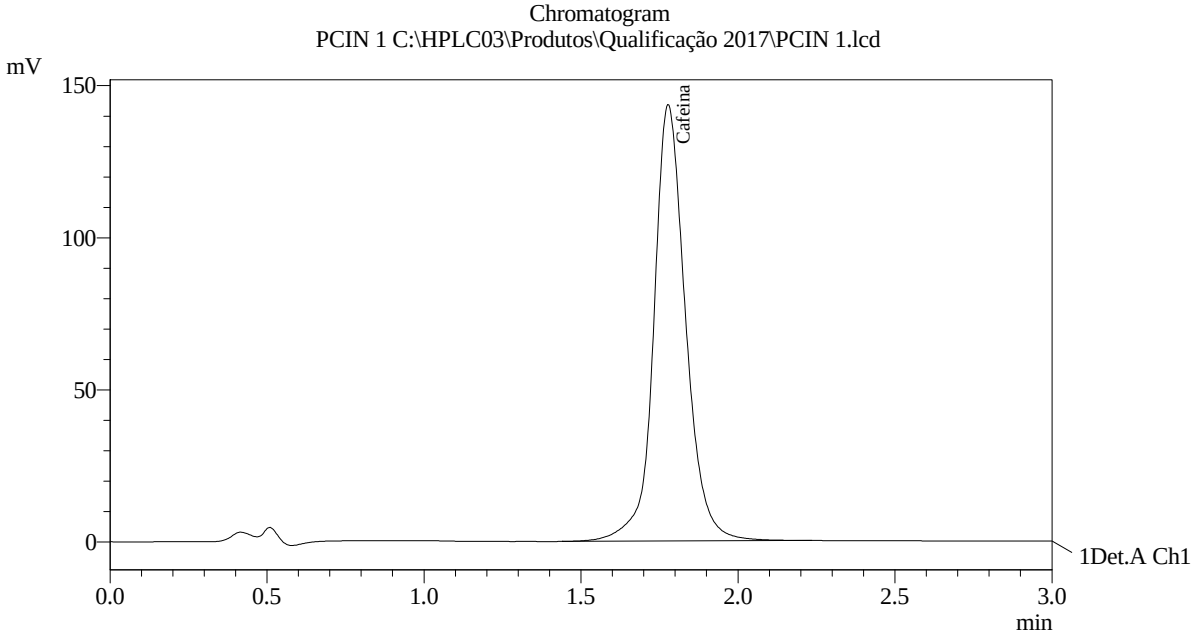

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.776	1012835	0.0	mg/L
		1012835		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 2.lcd

Sample Name : PCIN 2
Sample ID : PCIN 2
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 08:59:41

Resultados

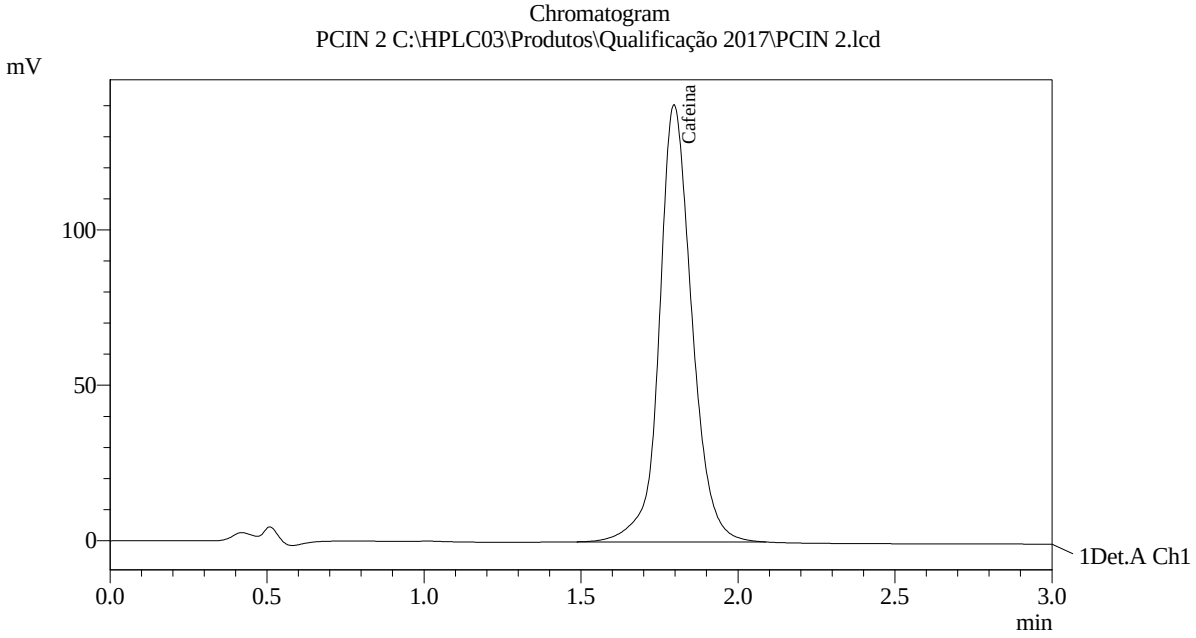

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.795	1015439	0.0	mg/L
		1015439		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 3.lcd

Sample Name : PCIN 3
Sample ID : PCIN 3
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:03:08

Resultados

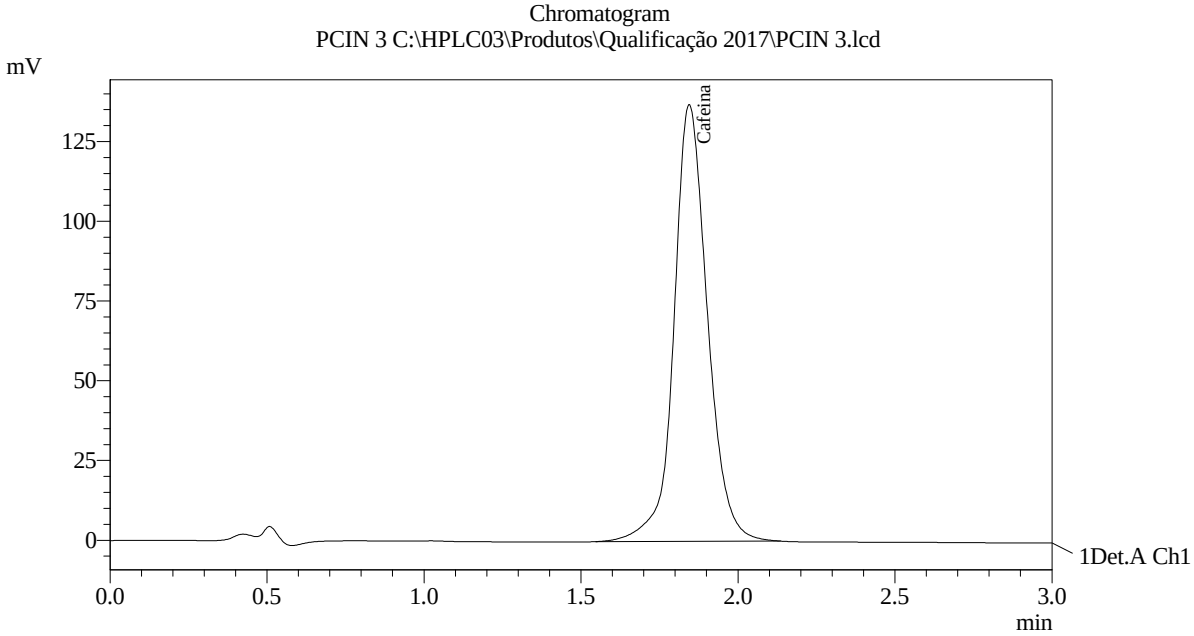

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.843	1015924	0.0	mg/L
		1015924		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\Branco 2.lcd

Sample Name : Branco 2
Sample ID : Branco 2
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:06:36

Resultados

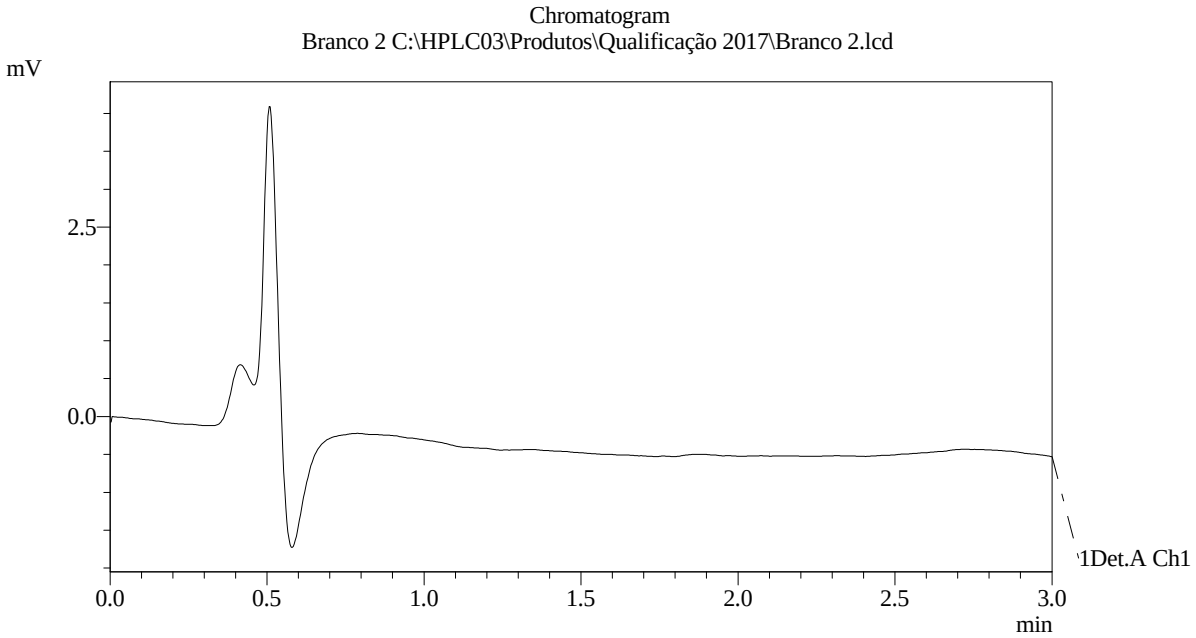

Detector A Ch1 273nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 4.lcd

Sample Name : PCIN 4
Sample ID : PCIN 4
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:10:01

Resultados

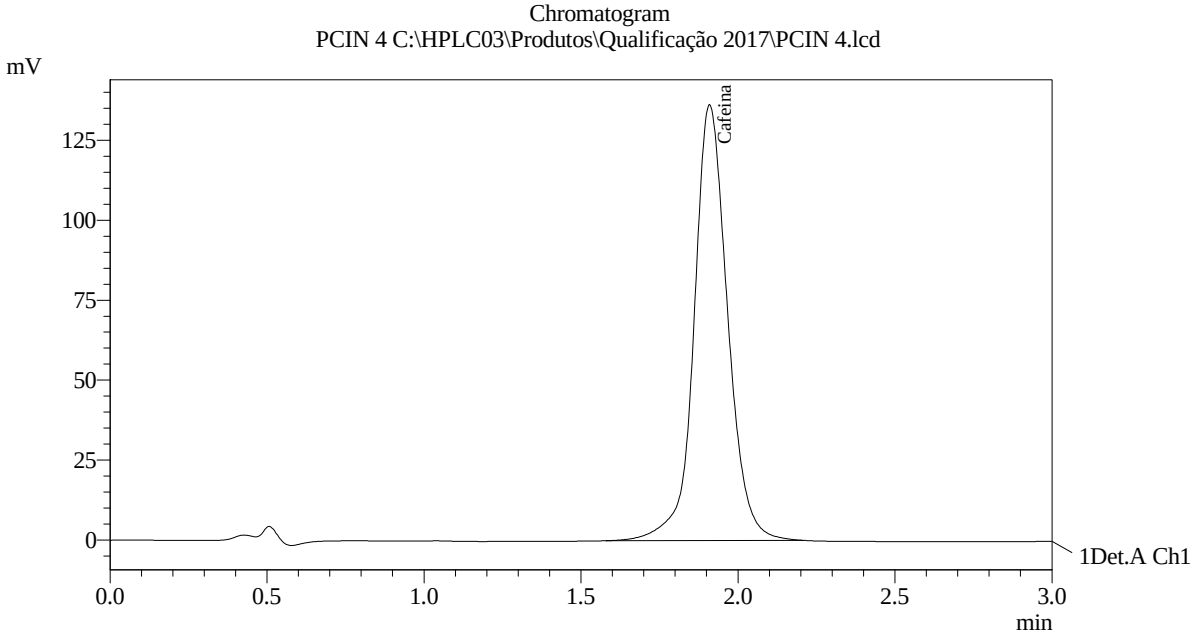

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.908	1014668	0.0	mg/L
		1014668		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 5.lcd

Sample Name : PCIN 5
Sample ID : PCIN 5
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:13:29

Resultados

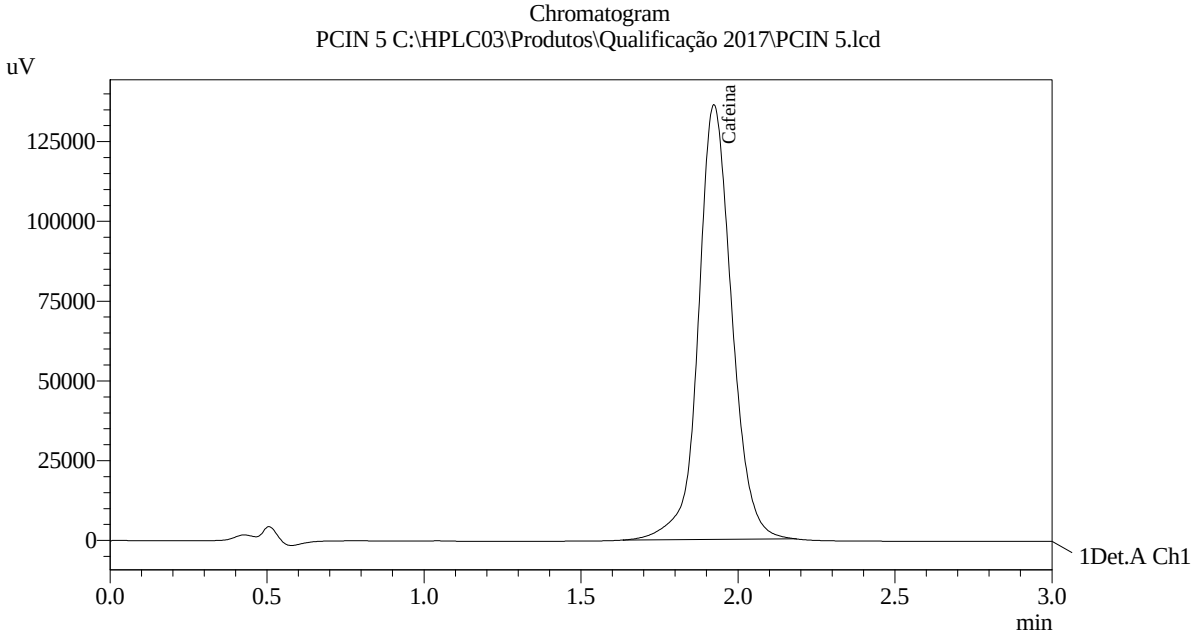

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.922	1010958	0.0	mg/L
		1010958		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\PCIN 6.lcd

Sample Name : PCIN 6
Sample ID : PCIN 6
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:16:57

Resultados

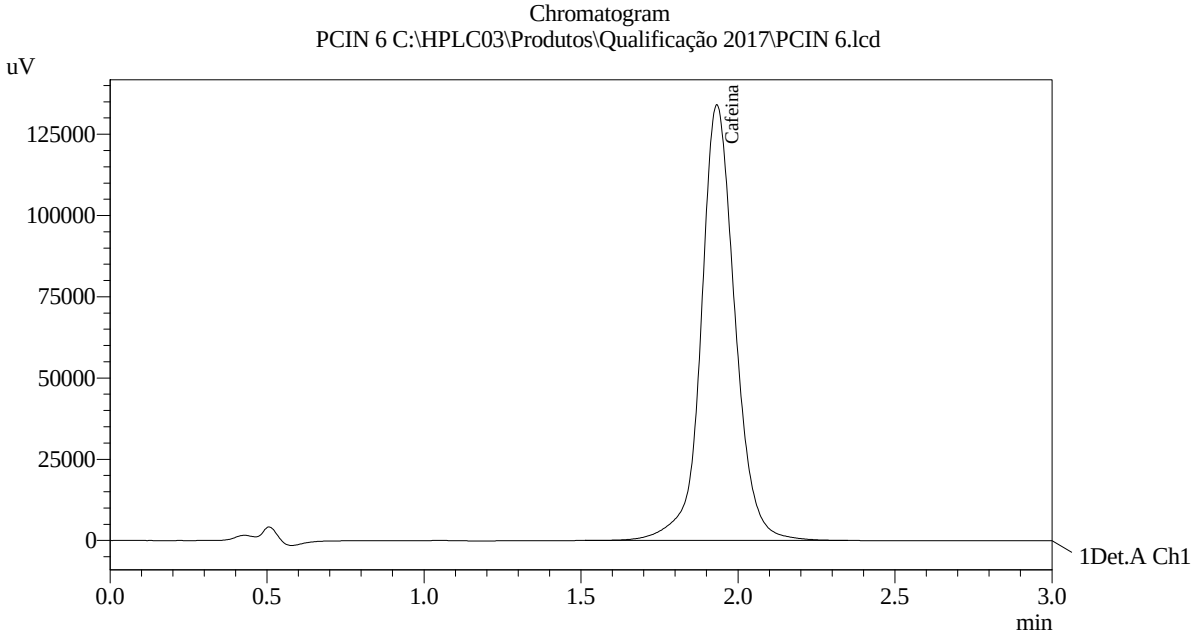

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.931	1007075	0.0	mg/L
		1007075		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\Branco 3.lcd

Sample Name : Branco 3
Sample ID : Branco 3
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:20:24

Resultados

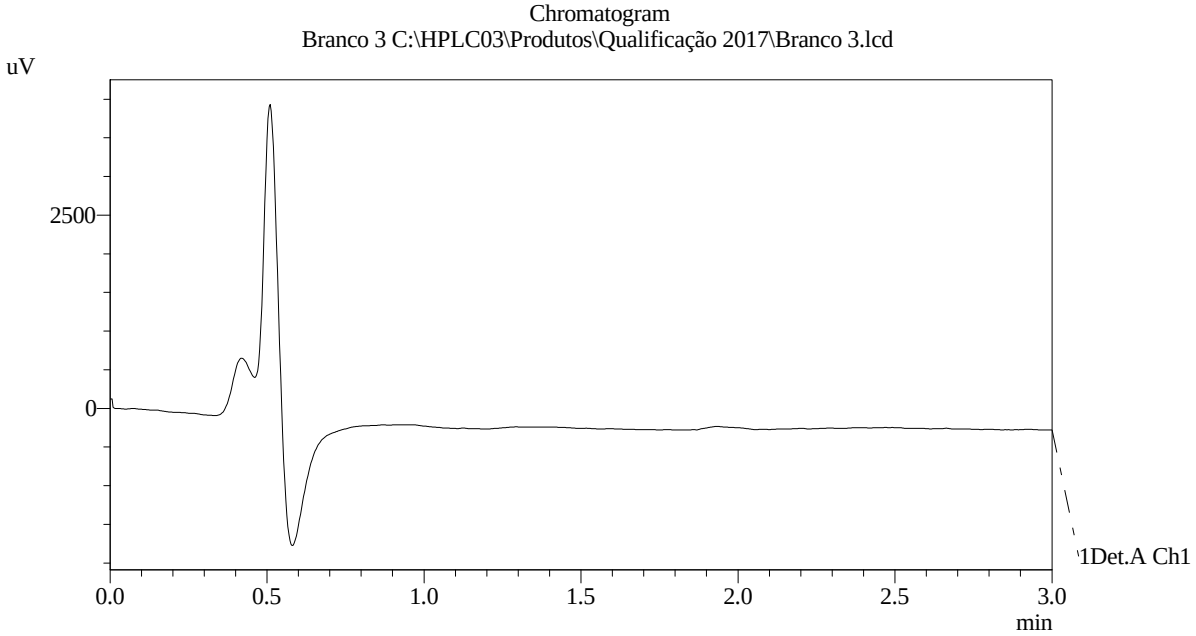

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LDUV 1.lcd

Sample Name : LDUV 1
Sample ID : LDUV 1
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:29:41

Resultados

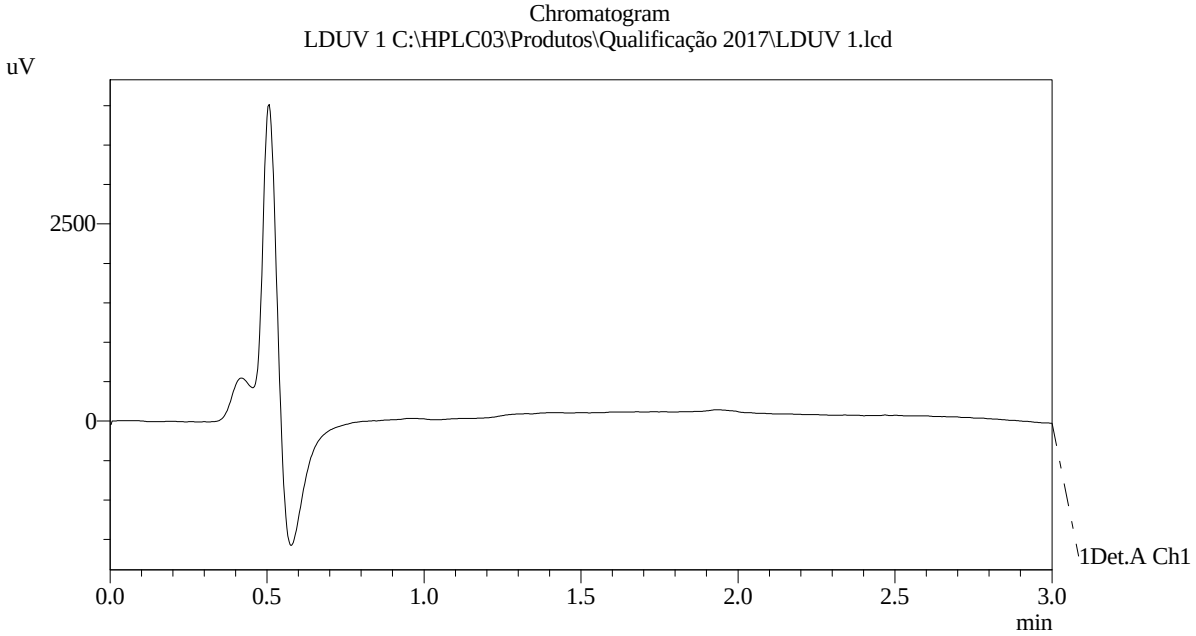

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LDUV 2.lcd

Sample Name : LDUV 2
Sample ID : LDUV 2
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:33:10

Resultados

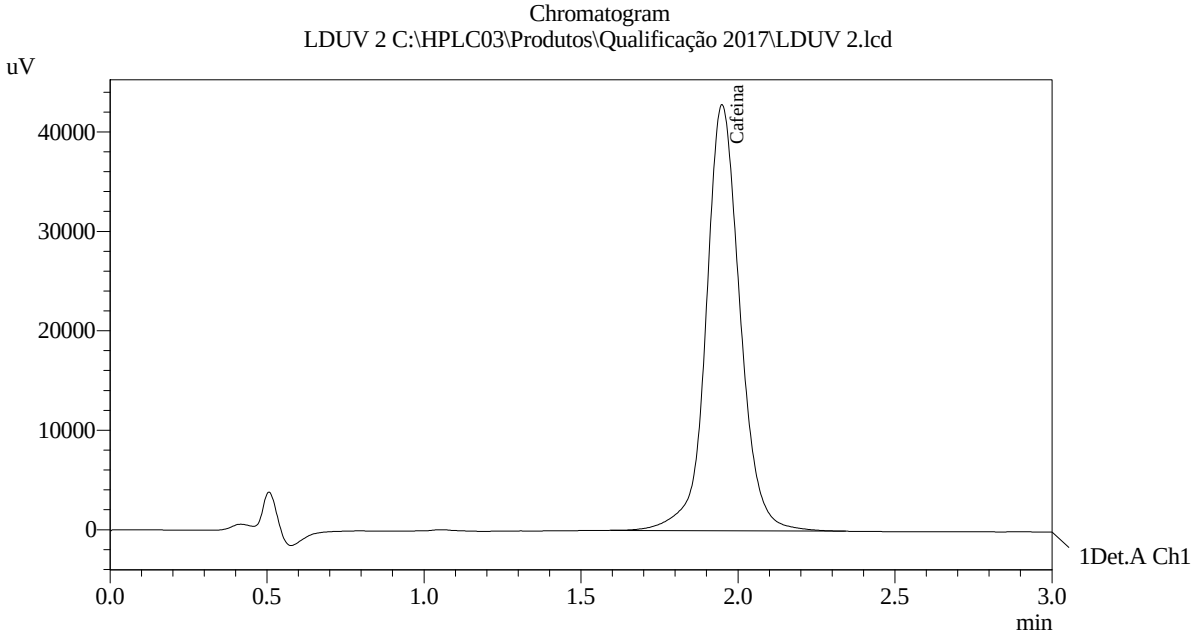

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.947	322602	0.0	mg/L
		322602		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LDUV 3.lcd

Sample Name : LDUV 3
Sample ID : LDUV 3
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:36:37

Resultados

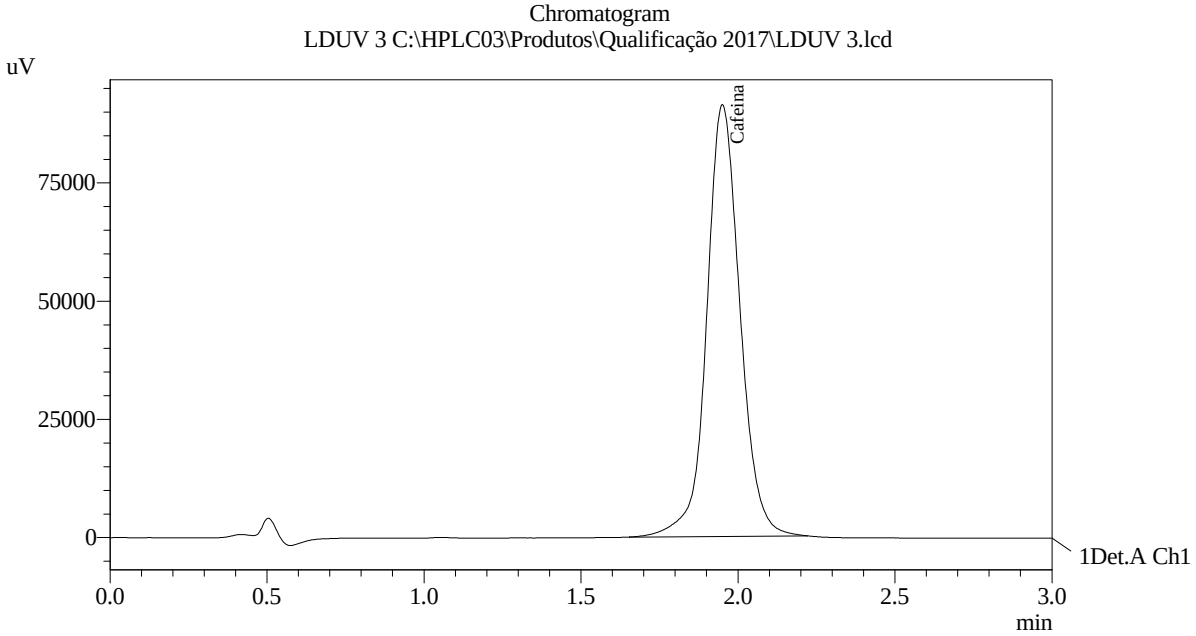

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.949	673054	0.0	mg/L
		673054		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LDUV 4.lcd

Sample Name : LDUV 4
Sample ID : LDUV 4
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:40:04

Resultados

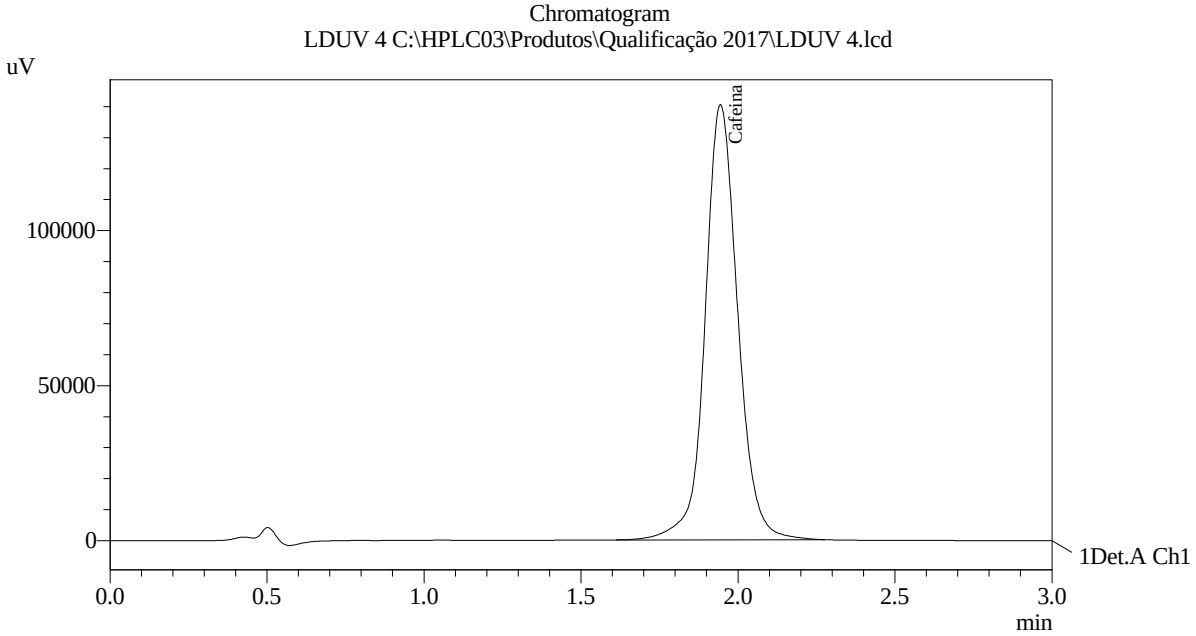

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.942	1014728	0.0	mg/L
		1014728		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LDUV 5.lcd

Sample Name : LDUV 5
Sample ID : LDUV 5
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:43:31

Resultados

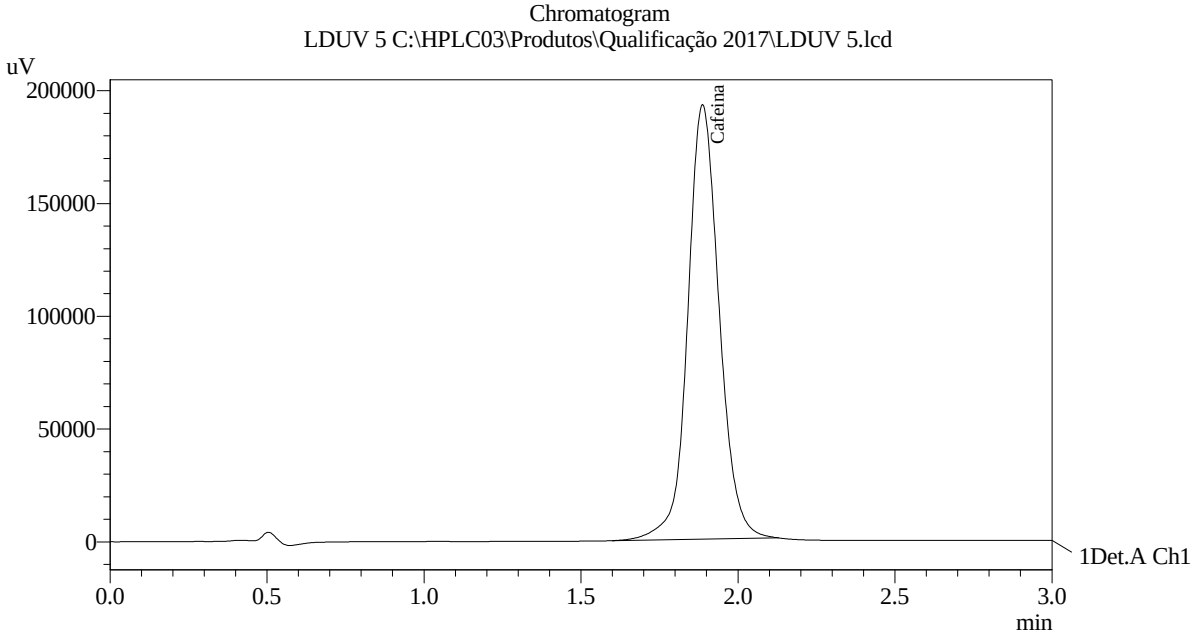

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.885	1340163	0.0	mg/L
		1340163		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LIIN 1.lcd

Sample Name : LIIN 1
Sample ID : LIIN 1
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:53:19

Resultados

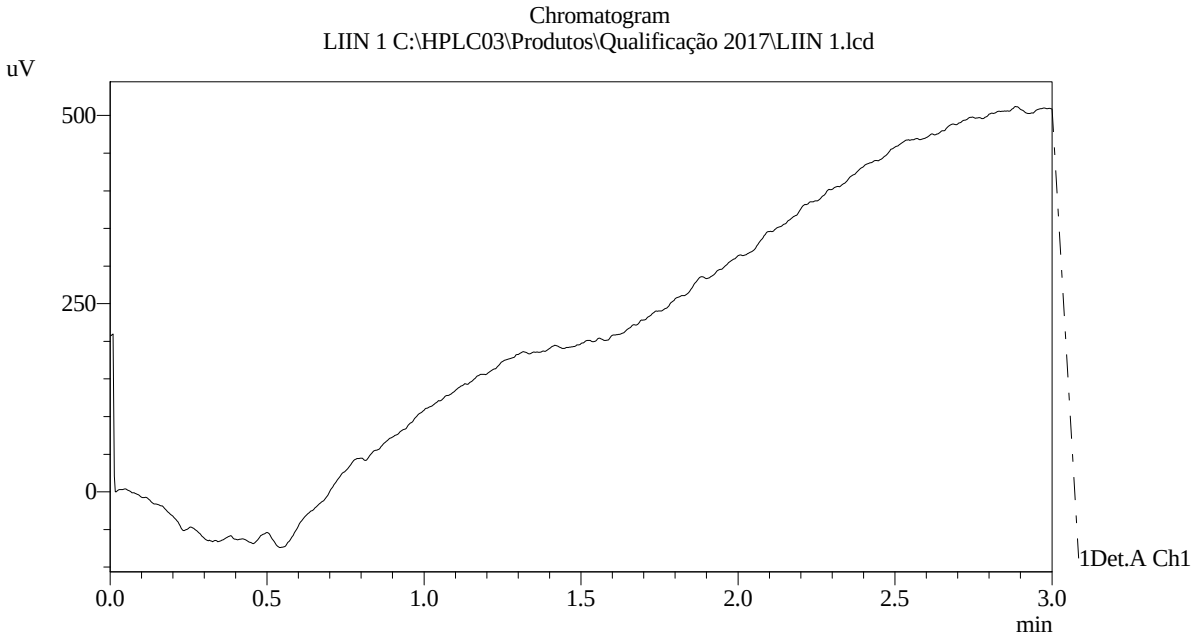

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LIIN 2.lcd

Sample Name : LIIN 2
Sample ID : LIIN 2
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 09:56:47

Resultados

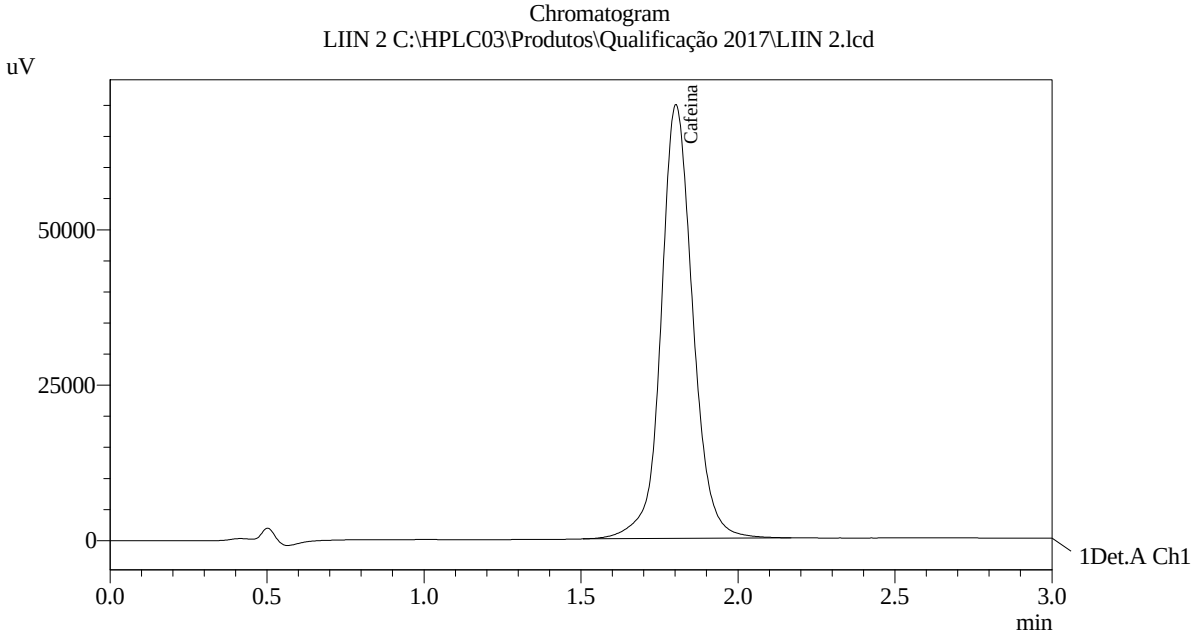

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.801	491071	0.0	mg/L
		491071		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LIIN 3.lcd

Sample Name : LIIN 3
Sample ID : LIIN 3
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 10:00:14

Resultados

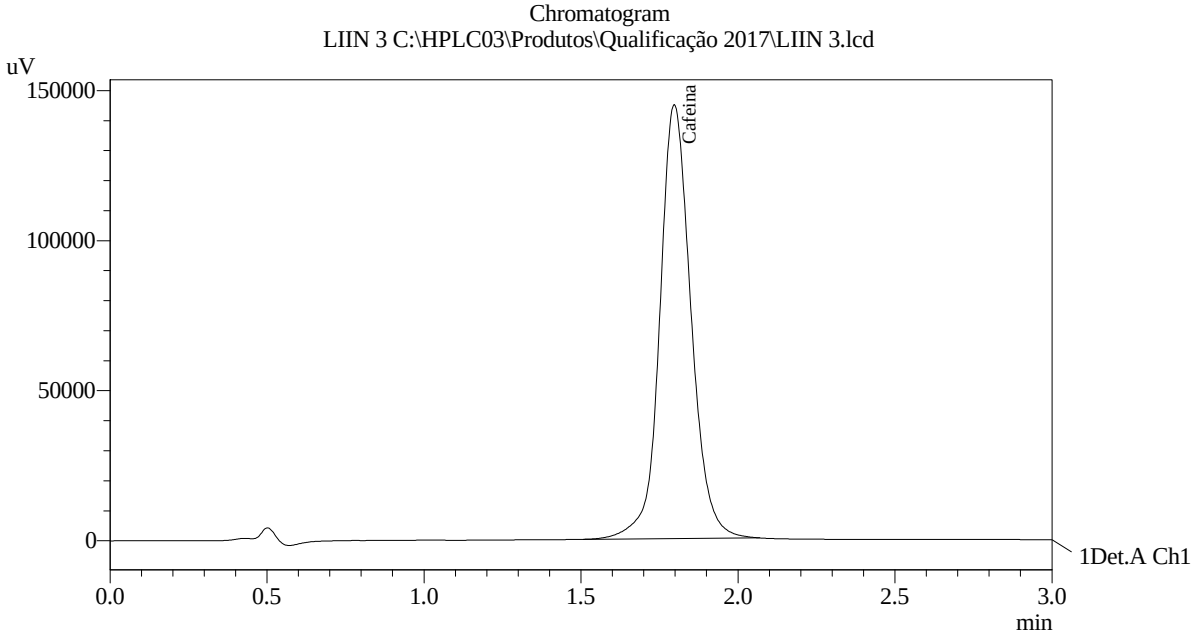

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.795	1000740	0.0	mg/L
		1000740		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LIIN 4.lcd

Sample Name : LIIN 4
Sample ID : LIIN 4
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 10:03:43

Resultados

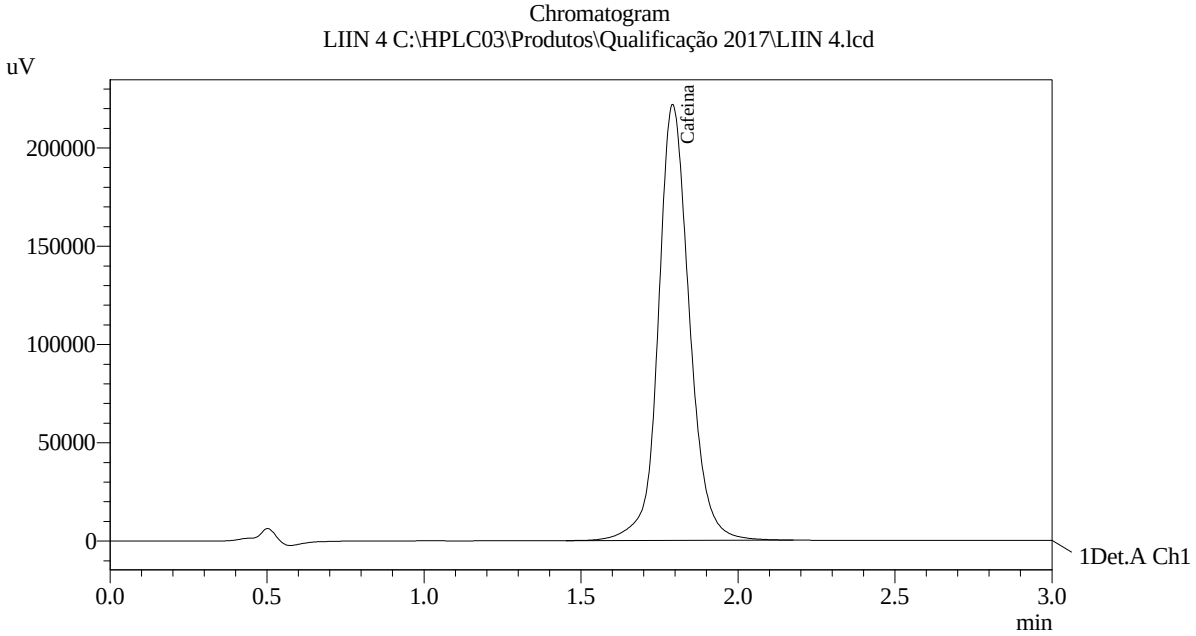

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.790	1527738	0.0	mg/L
		1527738		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\LIIN 5.lcd

Sample Name : LIIN 5
Sample ID : LIIN 5
Method File Name : Qualificação.lcm
Date :3/5/2017
Time : 10:07:13

Resultados

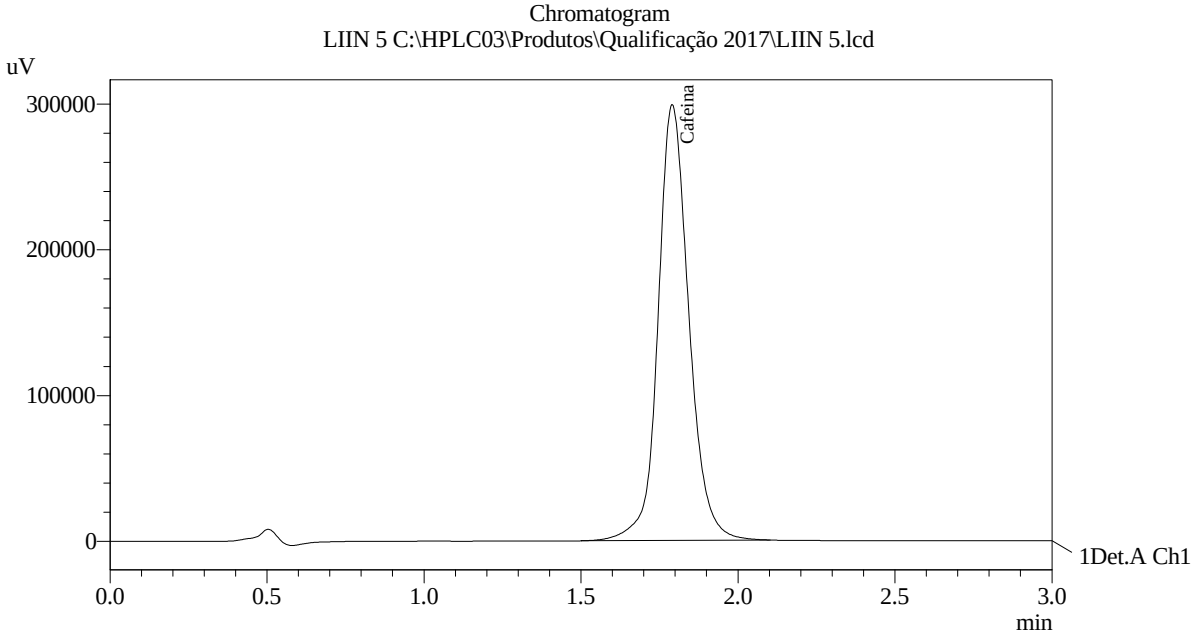

1 Det.A Ch1 / 273nm

Detector A Ch1 273nm

Nome	Ret. Time	Area	Conc.	Units
Cafeina	1.789	2037437	0.0	mg/L
		2037437		

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\Grad AB.lcd

Sample Name : GRAD AB
Sample ID : GRAD AB
Method File Name : Grad AB.lcm
Date :3/5/2017
Time : 11:24:30

Resultados

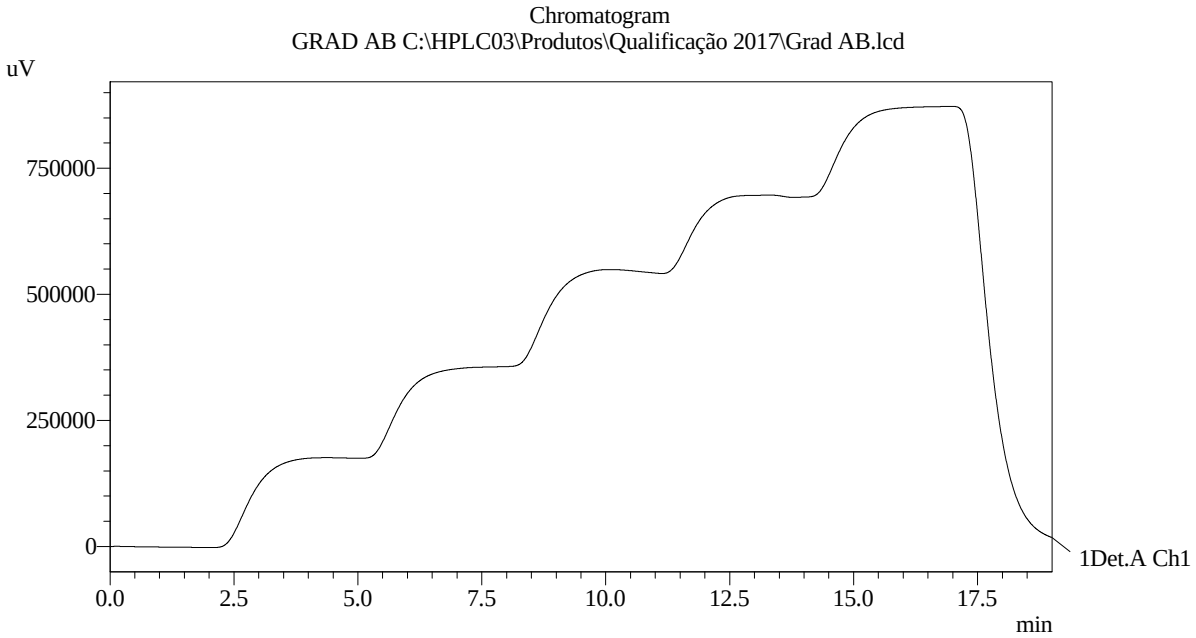

1 Det.A Ch1 / 265nm

Detector A Ch1 265nm

Analista: _____ Data: ___/___/___


Conferido por: _____ Data: ___/___/___

==== Laboratório Farmacêutico Elofar ====

C:\HPLC03\Produtos\Qualificação 2017\Grad CD.lcd

Sample Name : GRAD CD
Sample ID : GRAD CD
Method File Name : Grad CD.lcm
Date :3/5/2017
Time : 12:17:24

Resultados

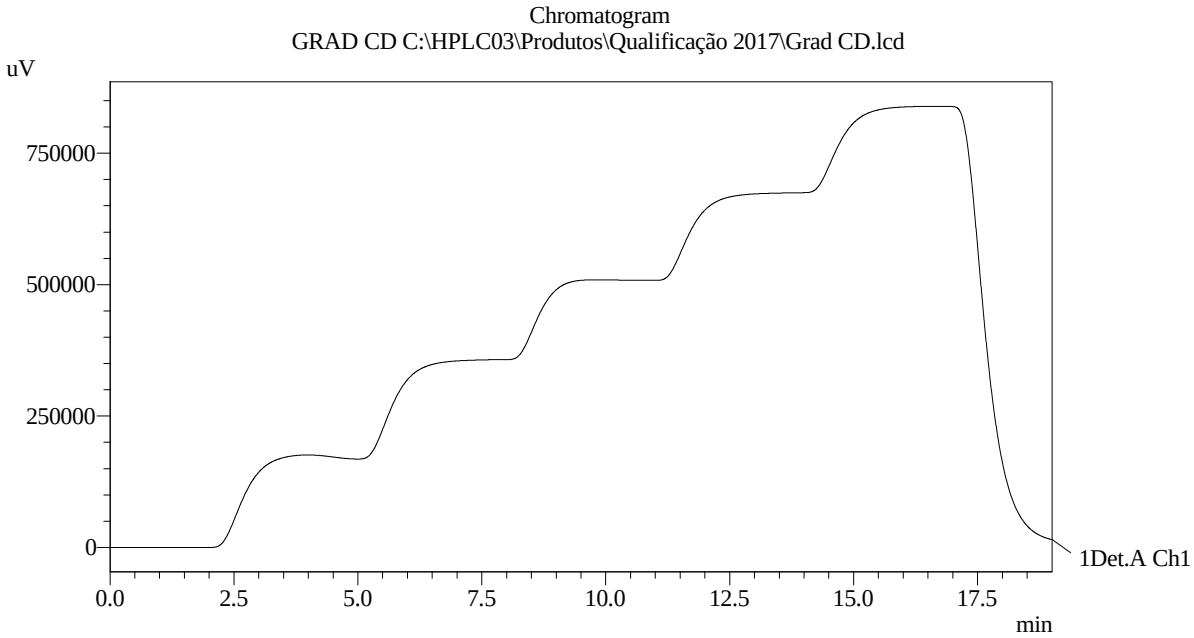

1 Det.A Ch1 / 265nm

Detector A Ch1 265nm

Analista: _____ Data: ___/___/___

Conferido por: _____ Data: ___/___/___