

Relatório de Qualificação - Teste de Exatidão do Comprimento de Onda - EDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001 (Off-line).24 2024-02-07 09-23-32 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:18:13 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 09:27:43 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 (Off-line) Amostra: EDUV
Vial: P1-A2 Volume: 10

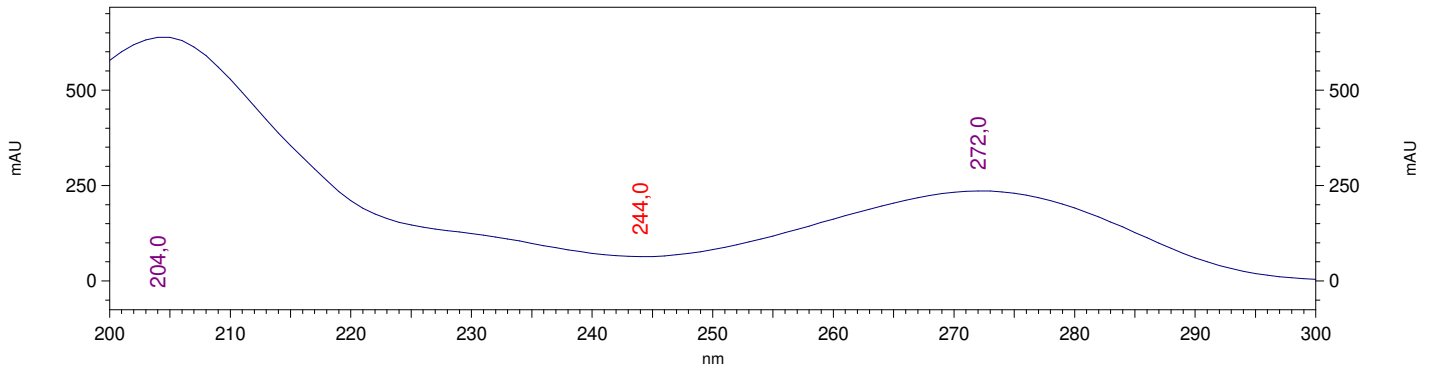

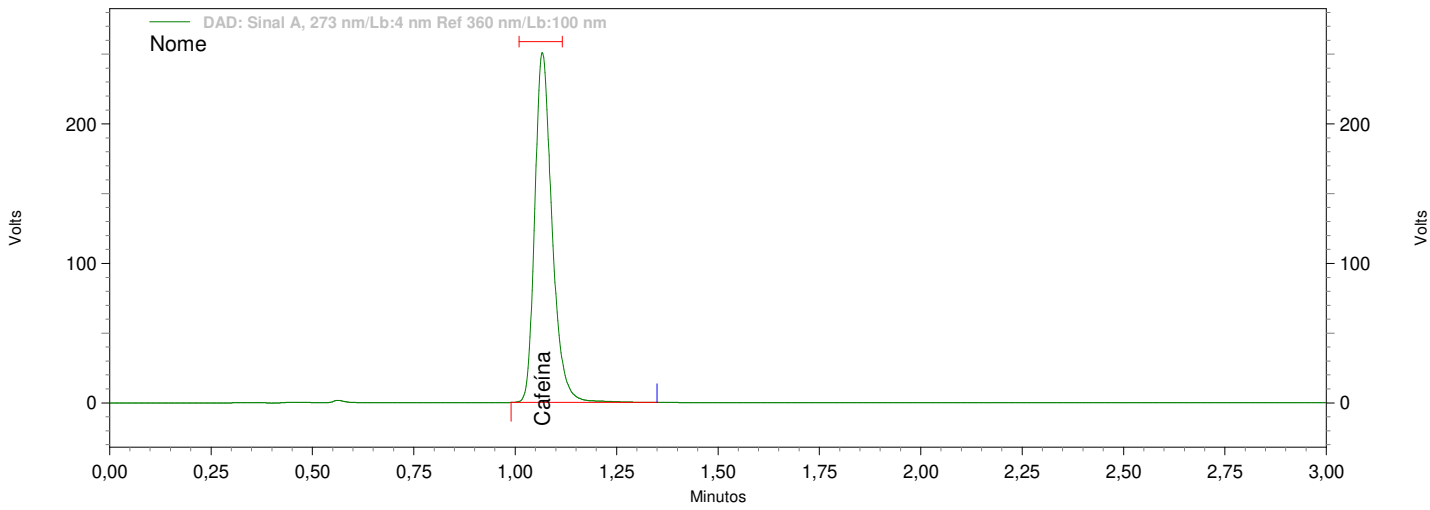

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,067	100132936	33696329
Totais		100132936	33696329

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - Branco_01

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\Branco_01_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:29:17 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:42:59 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: Branco_01
Vial: P1-A1 Volume: 10

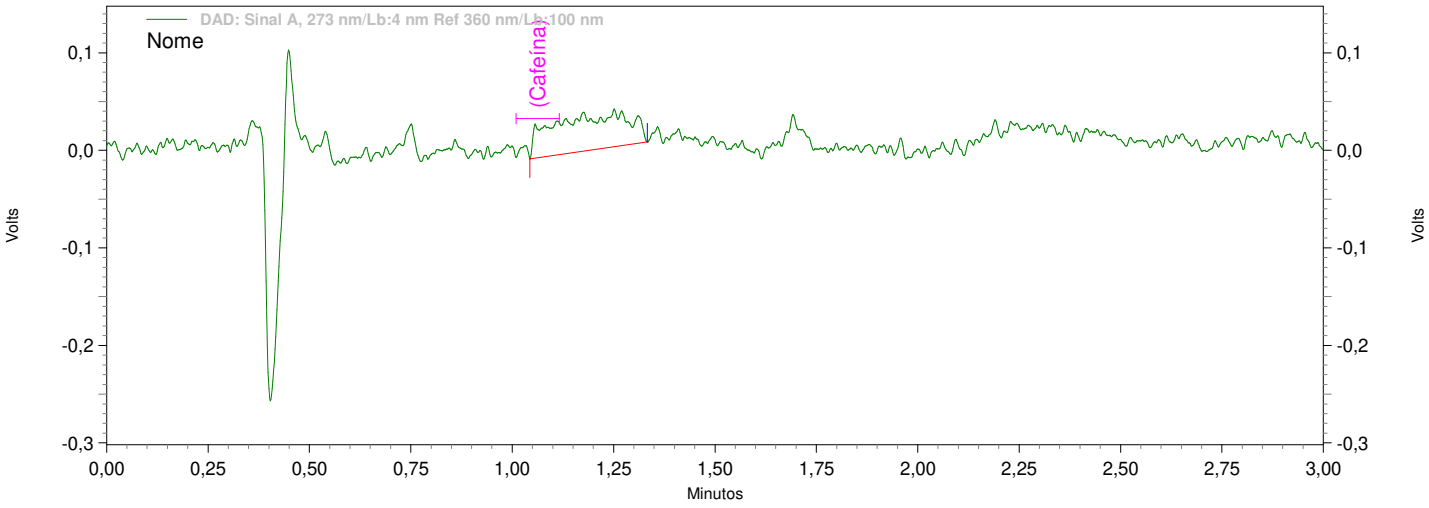

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína			
	1,252	66226	5187
Totais		66226	5187

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_01

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_01_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:33:19 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:42:41 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_01
Vial: P1-A2 Volume: 10

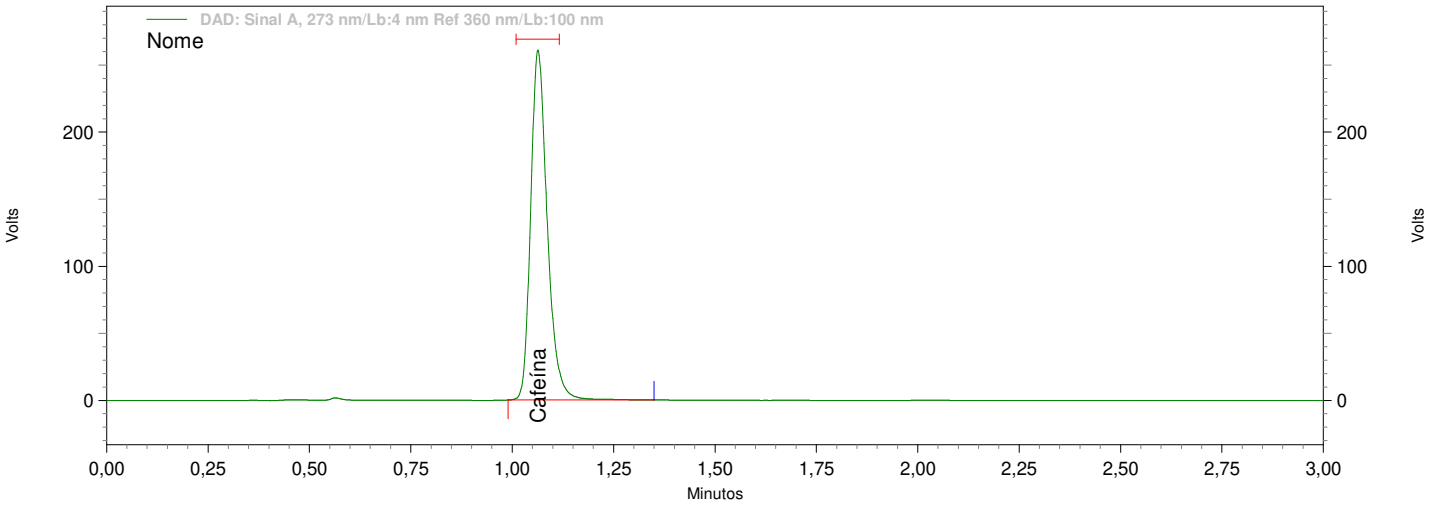

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,063	99908945	35032224


Totais		99908945	35032224

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_02

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_02_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:37:23 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:42:11 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_02
Vial: P1-A2 Volume: 10

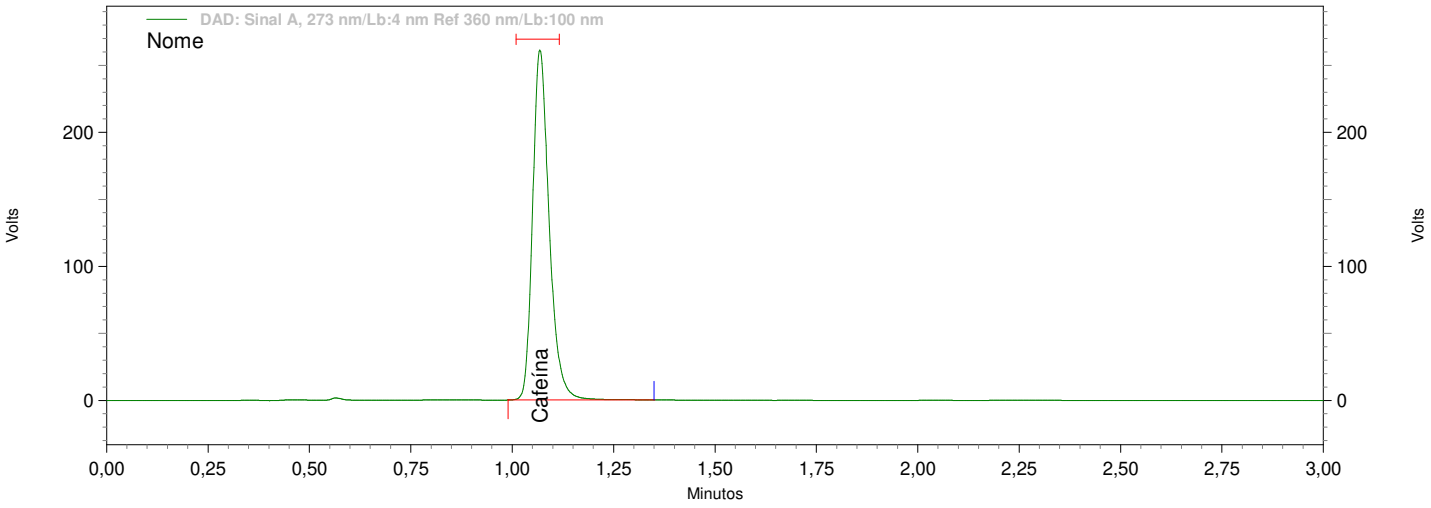

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,068	100067419	35069970
Totais		100067419	35069970

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_03

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_03_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:41:26 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:43:21 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_03
Vial: P1-A2 Volume: 10

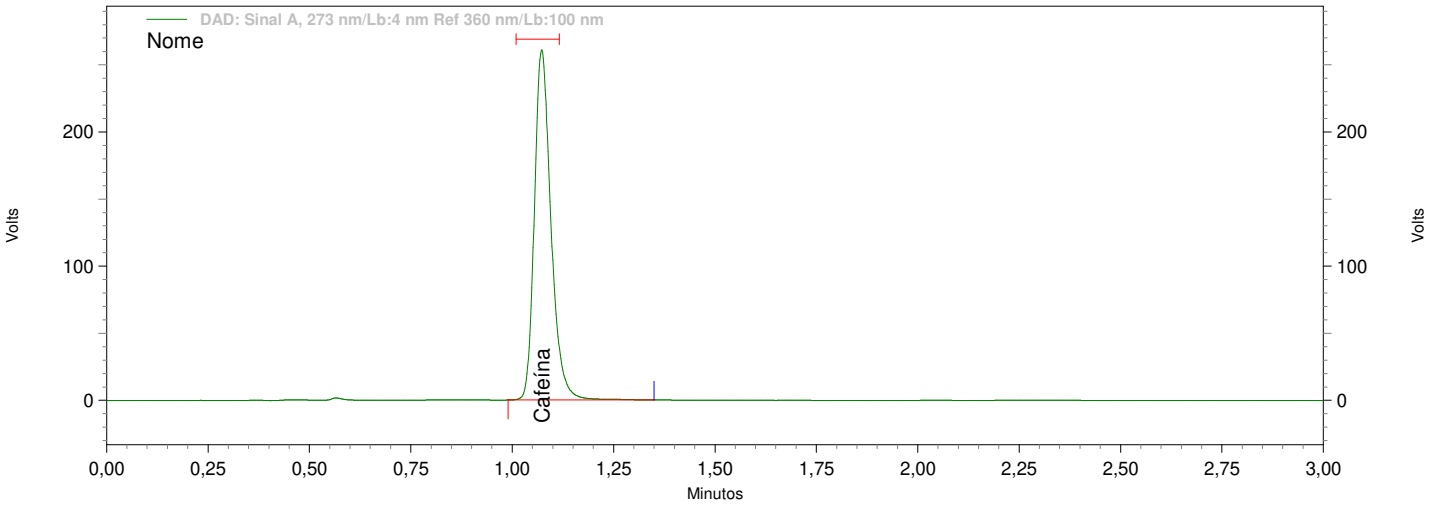

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,073	99958029	35019529


Totais		99958029	35019529

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - Branco_02

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\Branco_02_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:45:36 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:43:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: Branco_02
Vial: P1-A1 Volume: 10

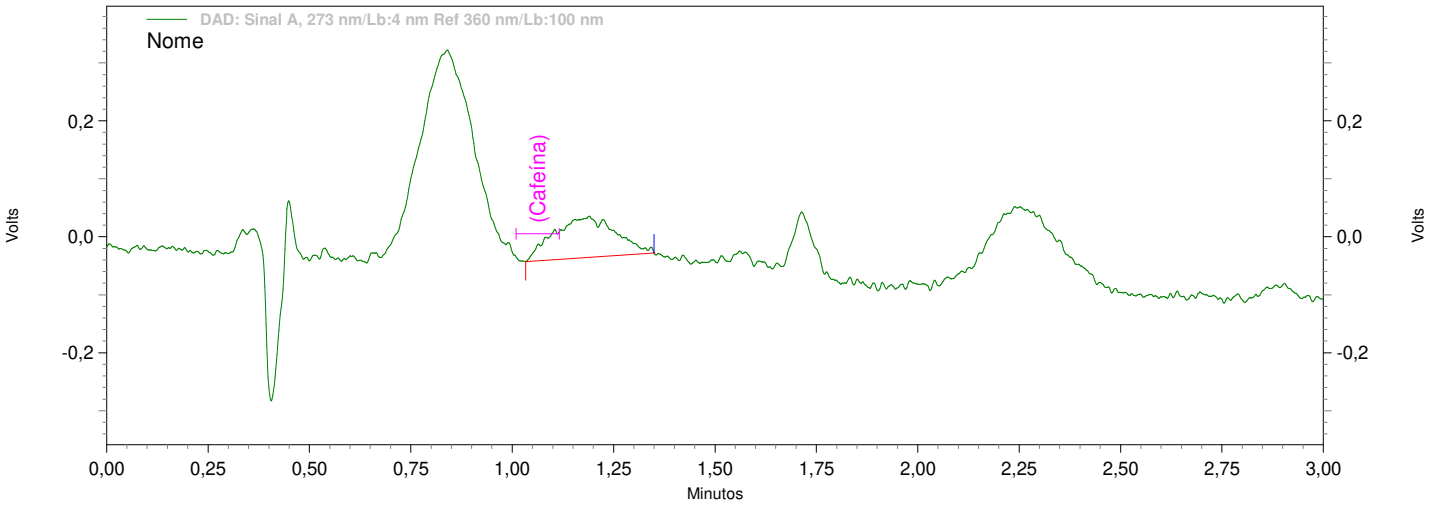

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína			
	1,190	100536	9575


Totais			
		100536	9575

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_04

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_04_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:49:36 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:44:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_04
Vial: P1-A2 Volume: 10

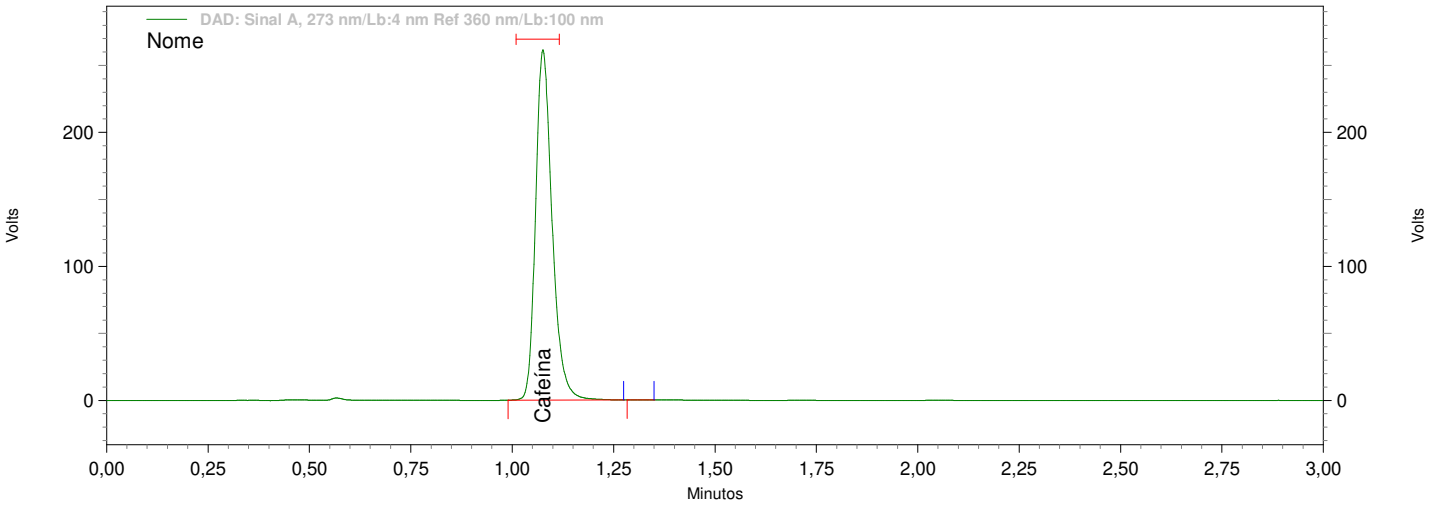

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,075	99822071	35084882
	1,328	22550	9316
Totais		99844621	35094198

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_05

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_05_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:53:40 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:44:44 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_05
Vial: P1-A2 Volume: 10

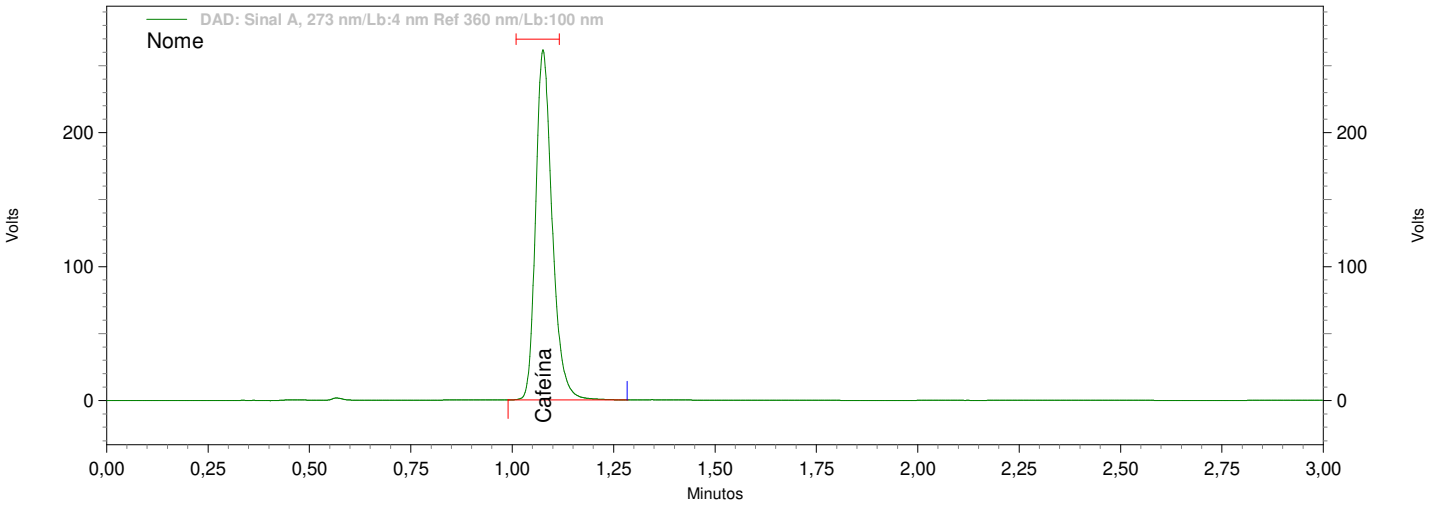

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,077	99763442	35086259


Totais		99763442	35086259

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - PCIN_06

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\PCIN_06_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 16:57:45 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:45:11 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: PCIN_06
Vial: P1-A2 Volume: 10

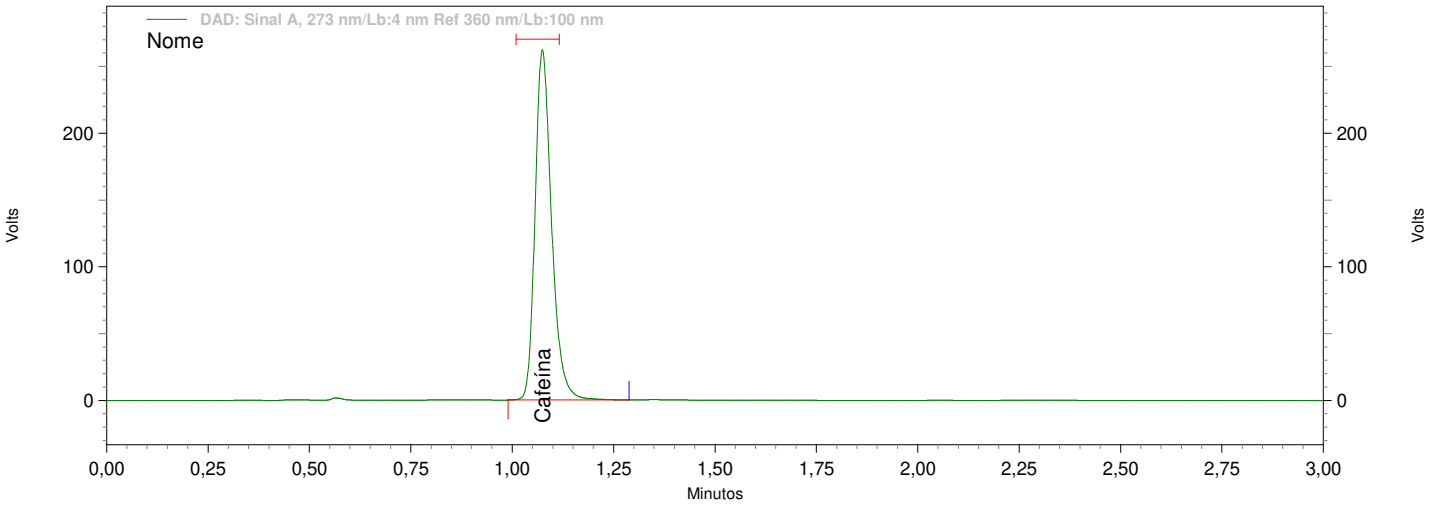

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,075	99846247	35182419
Totais		99846247	35182419

Relatório de Qualificação - Teste de Precião do Injetor - PCIN - Branco_03

Arquivo de Dados:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\CL-LABMAR-001_002.rslt\Branco_03_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:01:50 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 08:45:38 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: Branco_03
Vial: P1-A1 Volume: 10

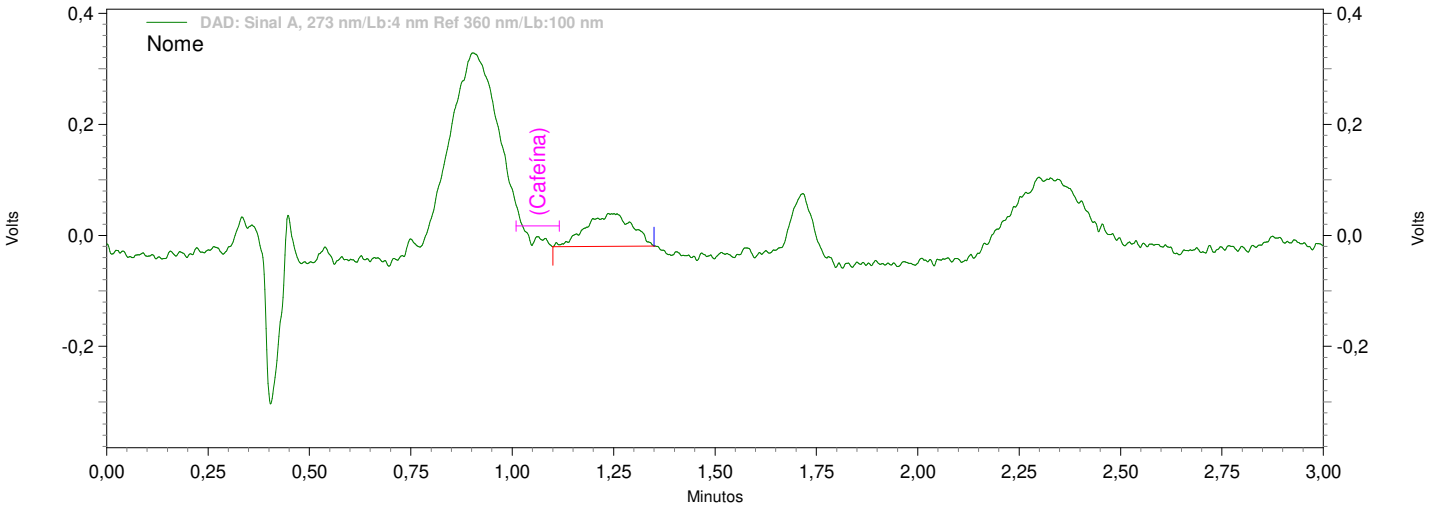

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,237	62670	7977
Totais		62670	7977

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LDUV_01_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:05:56 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:06:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LDUV_01
Vial: P1-A3 Volume: 10

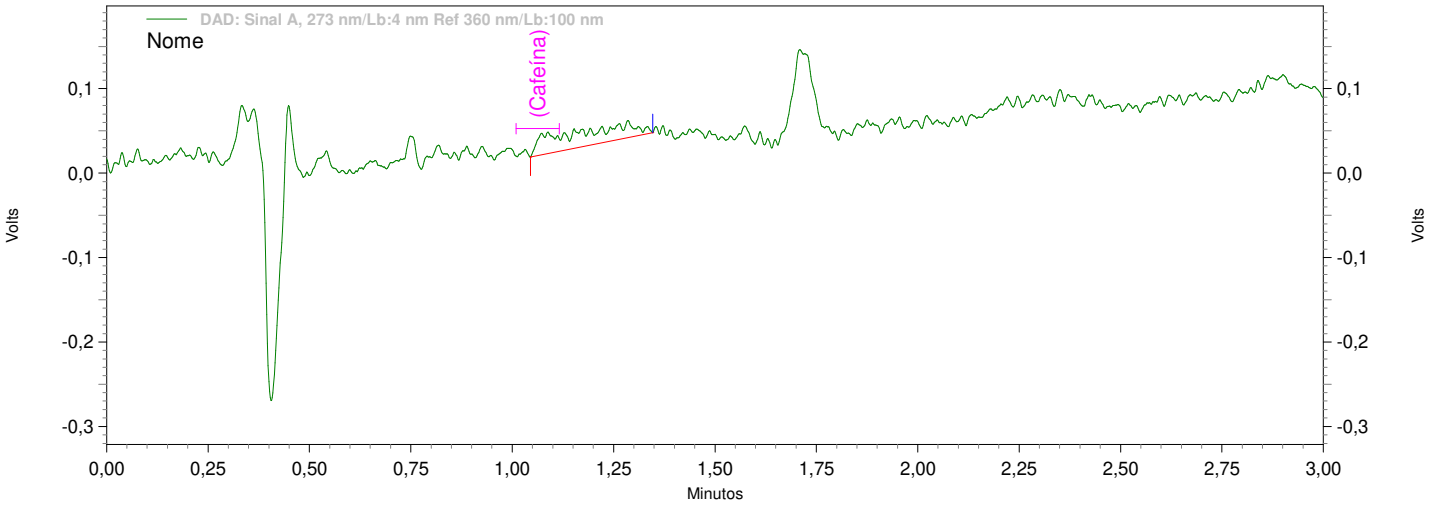

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,285	35502	2745
Totais		35502	2745

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LDUV_02_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:10:01 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:05:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LDUV_02
Vial: P1-A4 Volume: 10

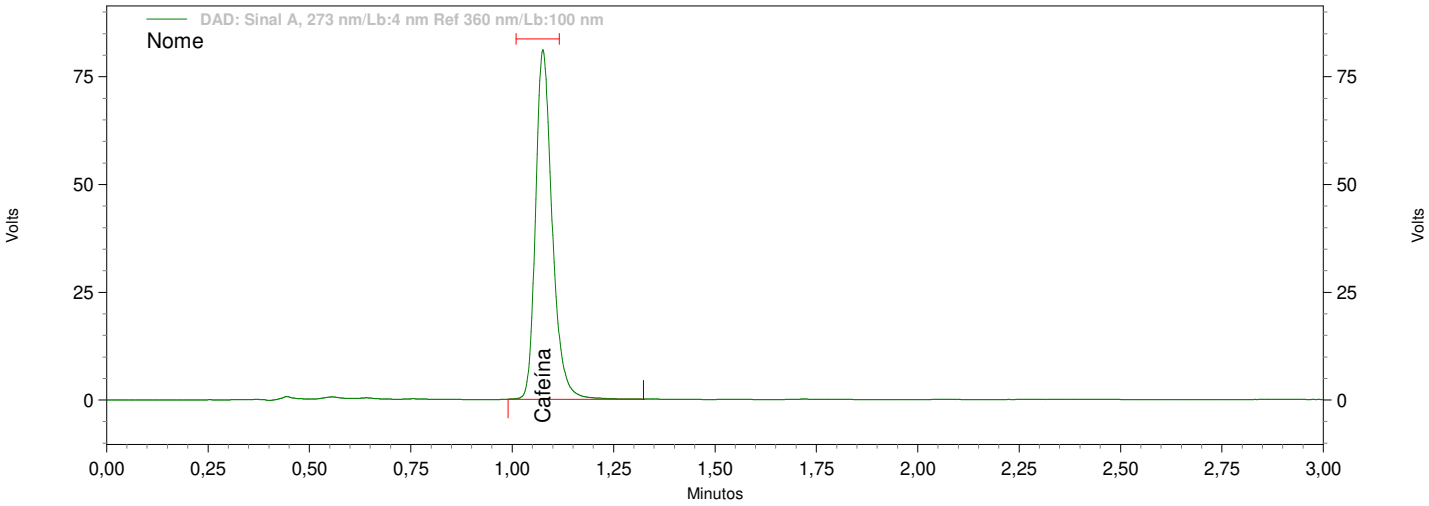

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,075	31110476	10887373


Totais		31110476	10887373

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LDUV_03_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:14:03 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:06:27 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LDUV_03
Vial: P1-A5 Volume: 10

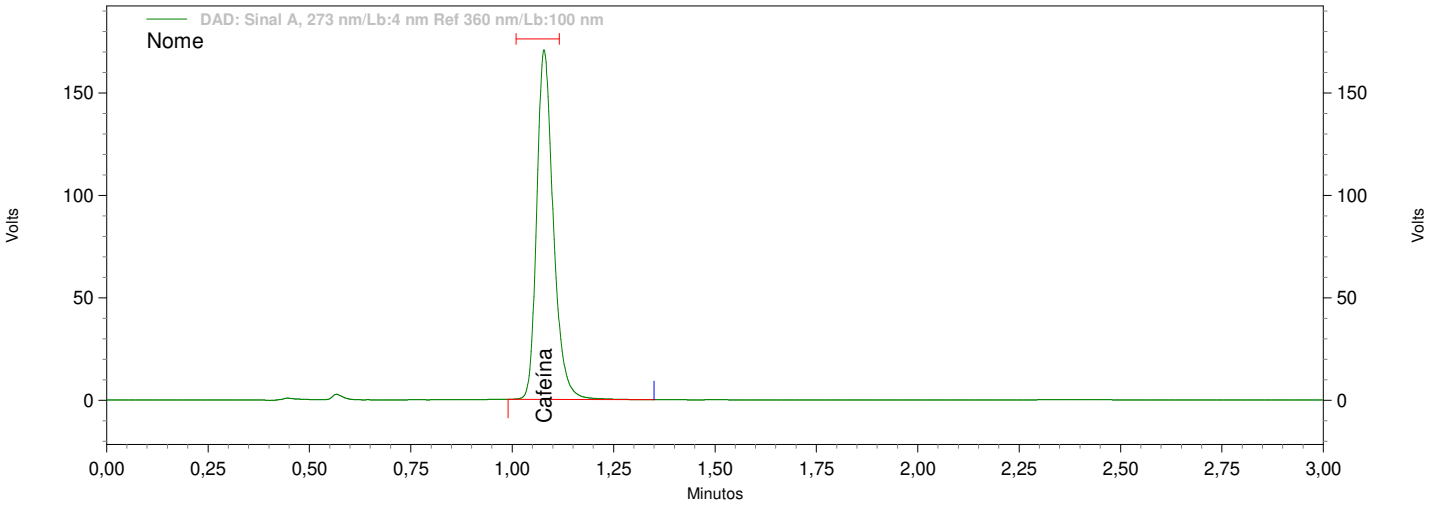

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,078	65344559	22925076
Totais		65344559	22925076

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LDUV_04_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:18:05 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:06:53 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LDUV_04
Vial: P1-A6 Volume: 10

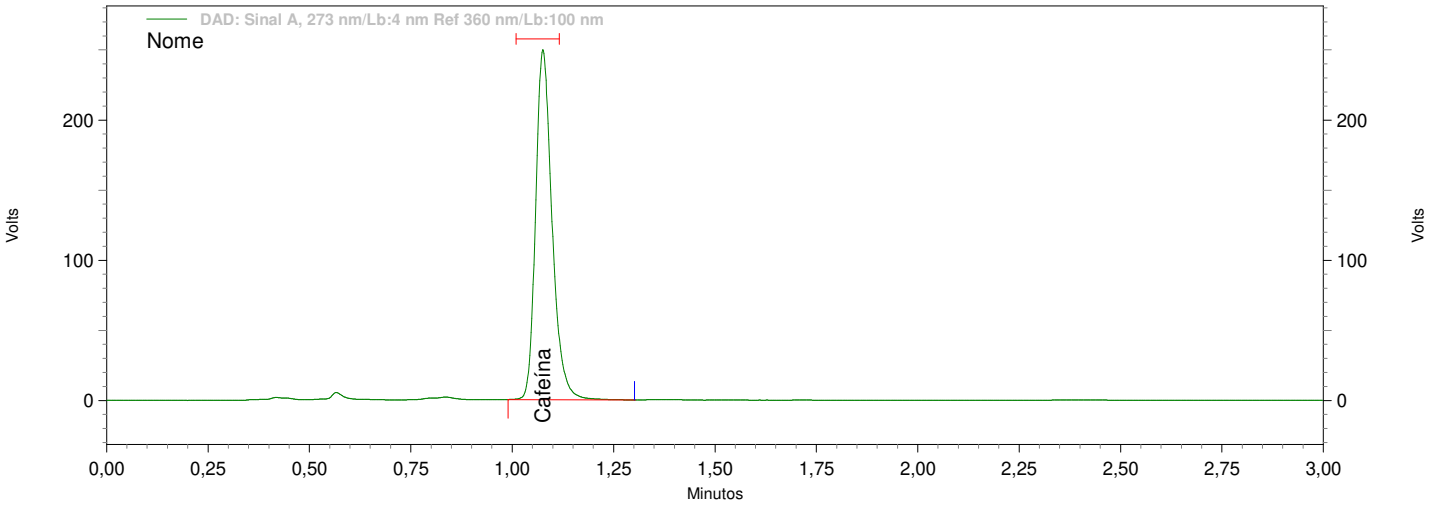

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,075	94745174	33508946
Totais		94745174	33508946

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Detector - LDUV_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LDUV_05_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:22:05 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:07:18 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LDUV_05
Vial: P1-A7 Volume: 10

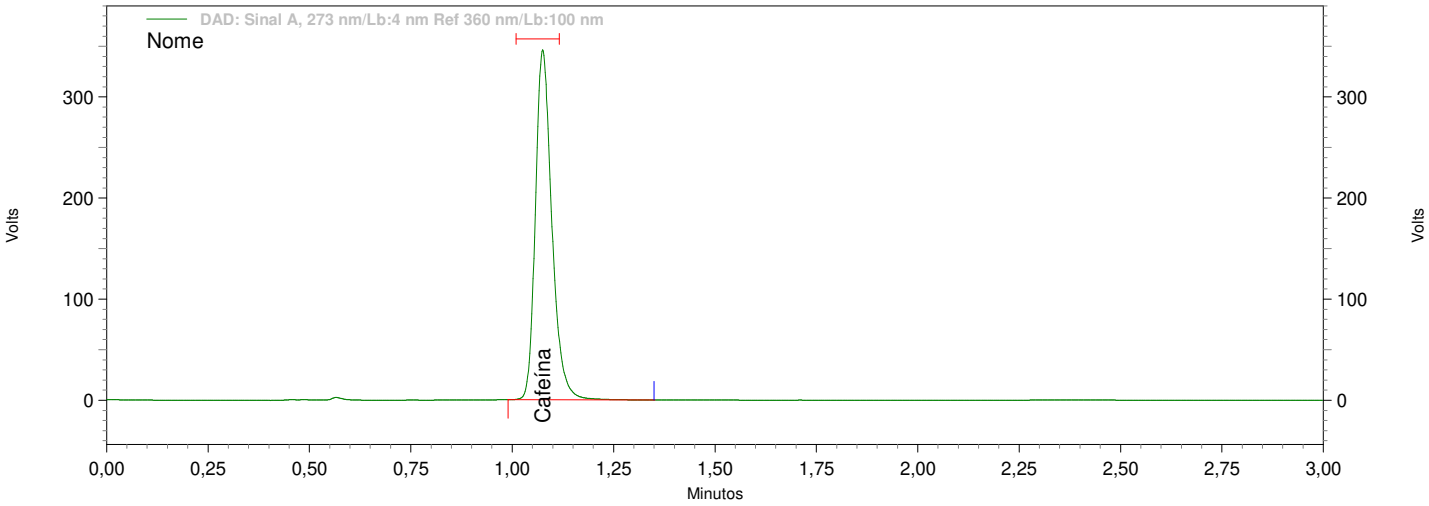

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura
Cafeína	1,075	131567350	46477589


Totais		131567350	46477589

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_01_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:26:05 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:09:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LIIN_01
Vial: P1-A8 Volume: 0

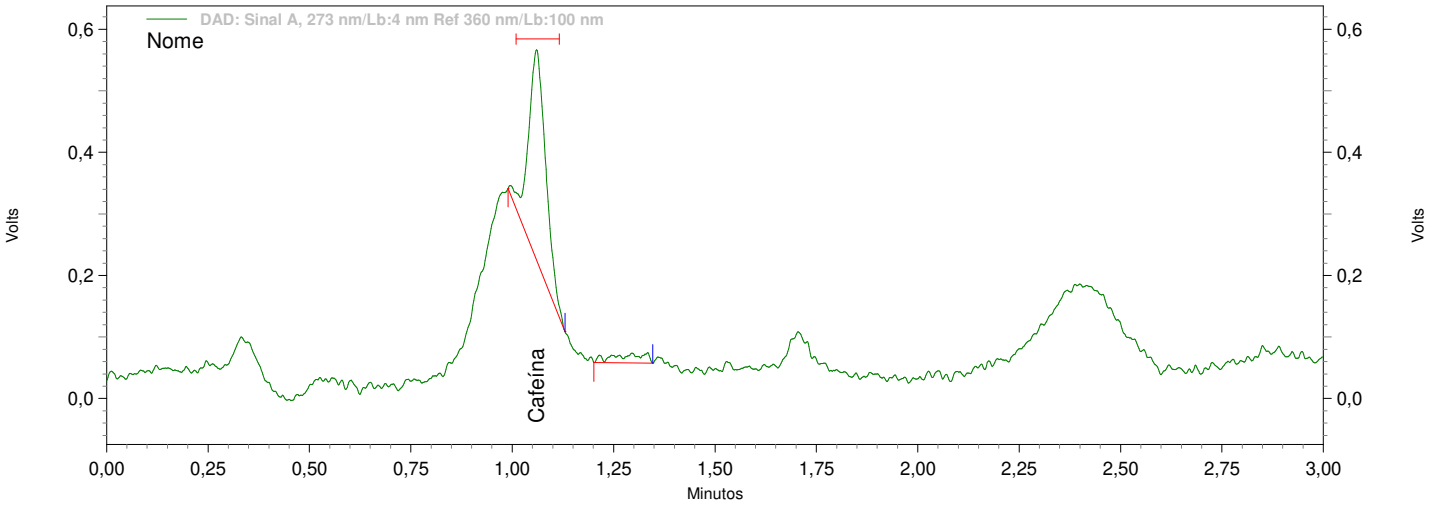

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,060	137752	45909
	1,295	11666	2154
Totais		149418	48063

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-03-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_02_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:29:59 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:09:34 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LIIN_02
Vial: P1-A8 Volume: 5

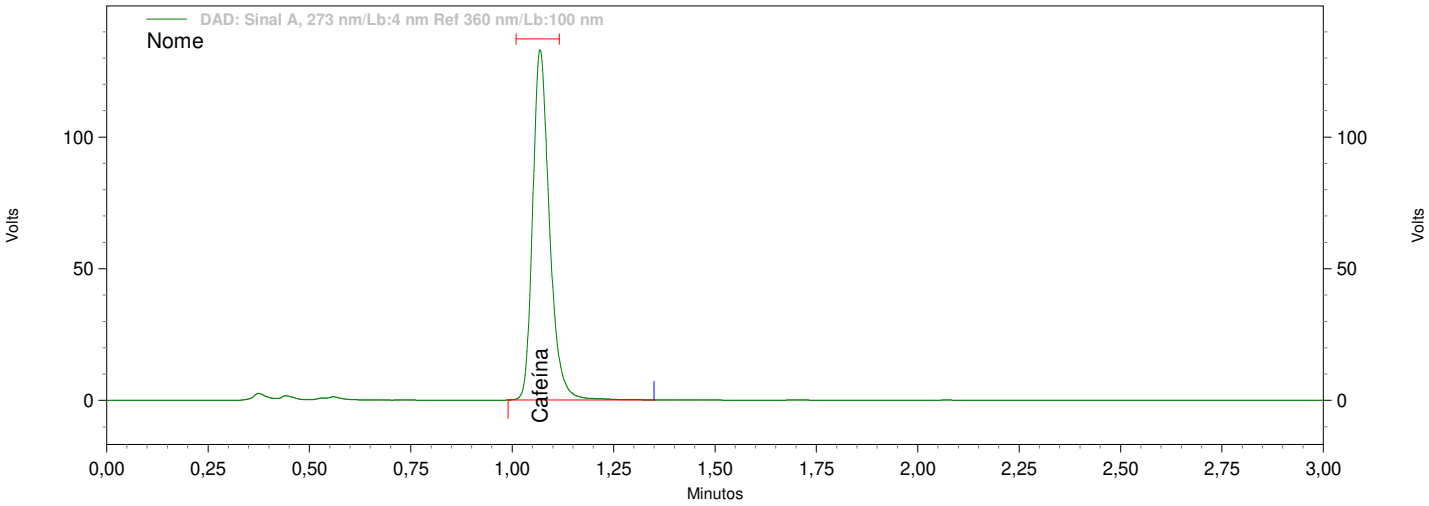

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,068	51547333	17858093


Totais		51547333	17858093

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-10-53 (GMT -03-00).rslt\LIIN_03_017.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:33:58 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:11:37 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LIIN_03
Vial: P1-A8 Volume: 10

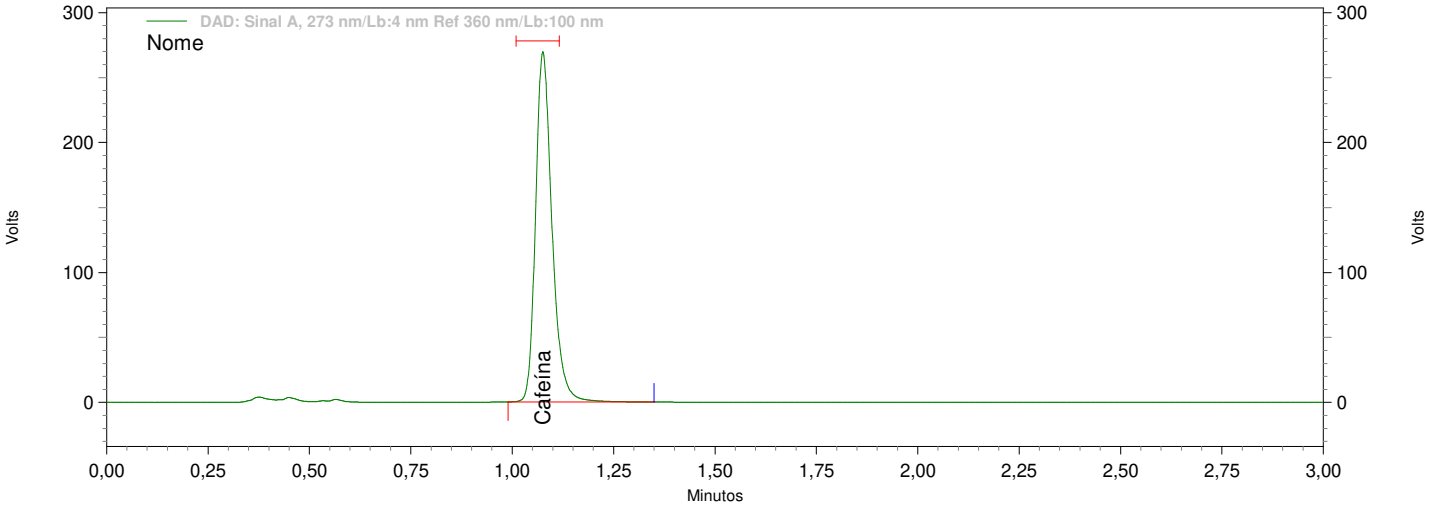

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,075	102161663	36190133


Totais		102161663	36190133

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-10-53 (GMT -03-00).rslt\LIIN_04_018.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:38:00 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:12:01 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LIIN_04
Vial: P1-A8 Volume: 15

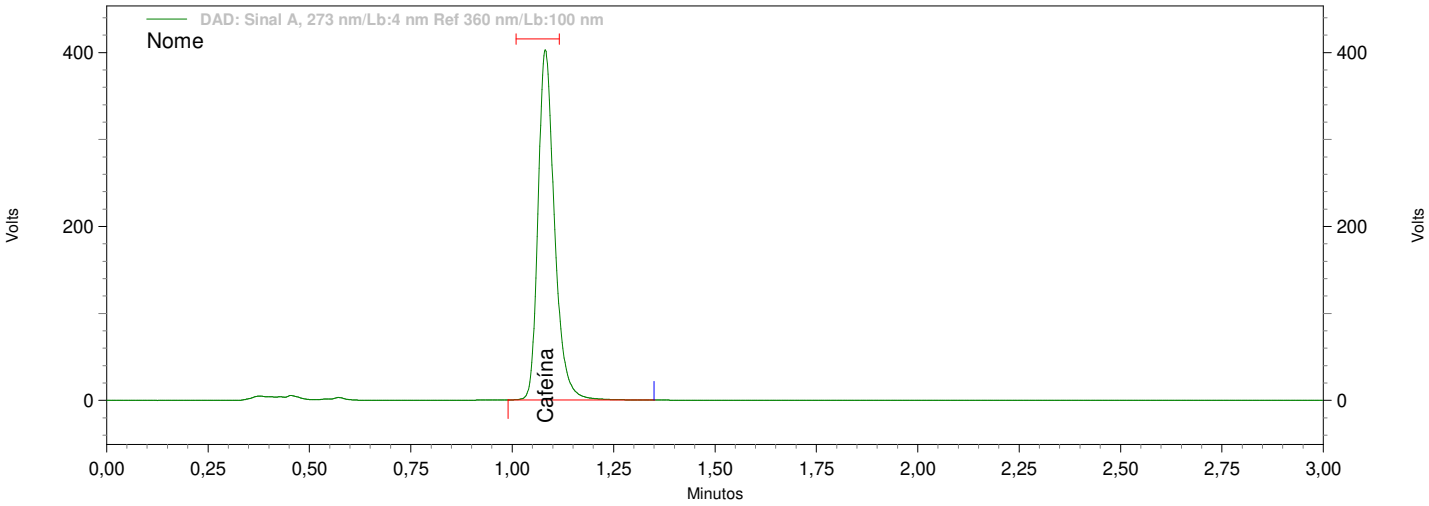

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,082	153046374	54080005


Totais		153046374	54080005

Relatório de Qualificação - Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 10-10-53 (GMT -03-00).rslt\LIIN_05_019.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 06/02/2024 17:42:08 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:12:25 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1 Multiplicador: 1

TAG: CL-LABMAR-001 Amostra: LIIN_05
Vial: P1-A8 Volume: 20

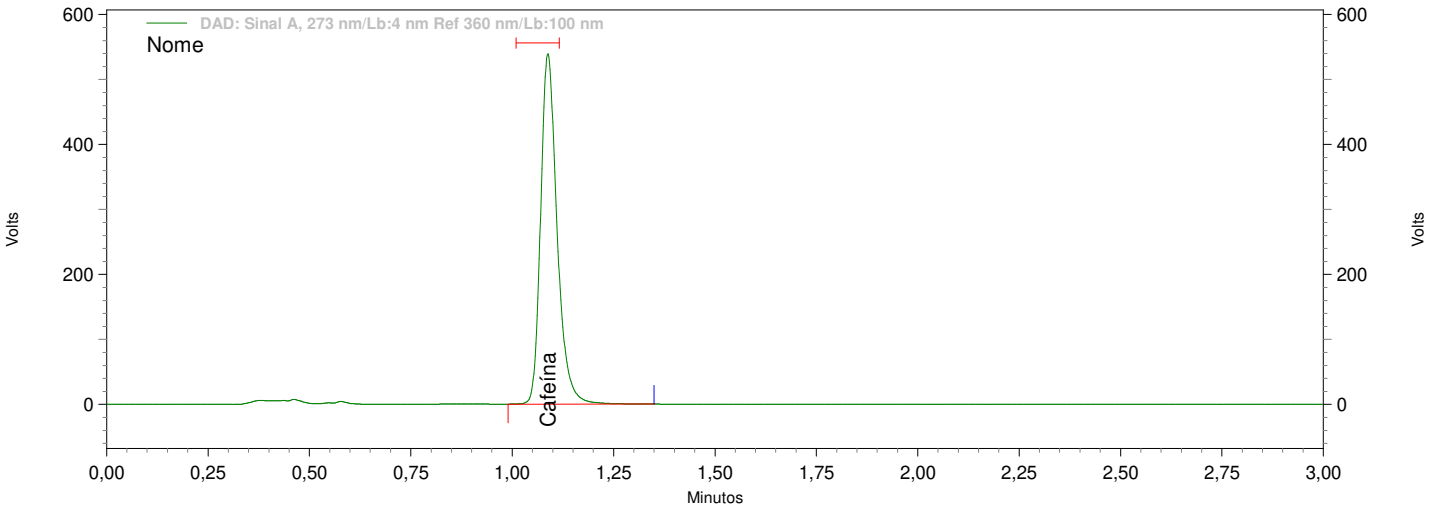

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,088	204769054	72406544
Totais		204769054	72406544

Relatório de Qualificação - Teste de Sinal e Ruído - RELB_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\CL-LABMAR-001.24 2024-02-07 09-49-49 (GMT -03-00).rslt\RELB_01_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Adquirido: 07/02/2024 09:02:10 (GMT -03:00)
Impresso: 07/02/2024 10:00:39 (GMT -03:00)

Qtde Amostra:	1	Multiplicador:	1
TAG:	CL-LABMAR-001	Amostra:	RELB_01
Vial:	P1-A9	Volume:	20

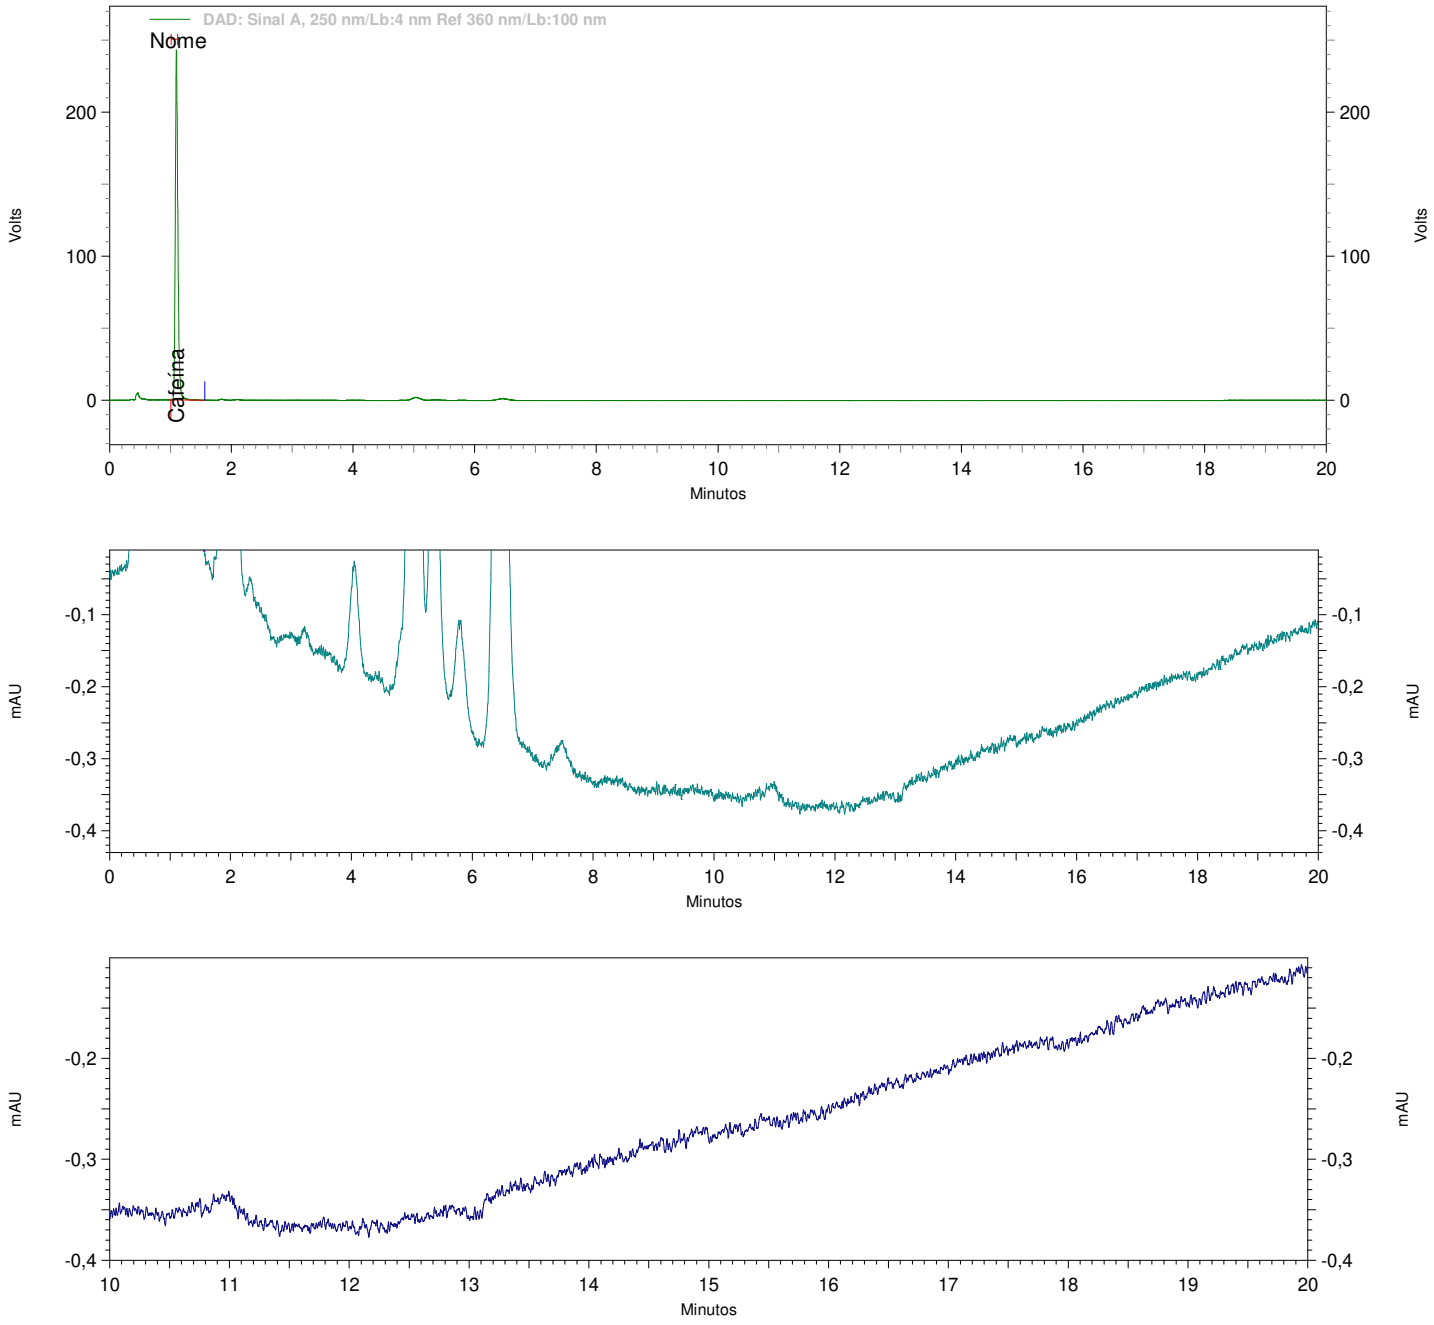


Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm Ref 360 nm/Lb:100 nm

Name	**Time**	**Area**	Altura	S/N (ASTM)
Cafeína	1,097	96248791	32625958	86,430375

Totais		96248791	32625958	

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRADIENTE AB.met
Data:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\GRADIENTES\CL-LABMAR-001003.rslt\Gradiente_AB_001.dat
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/02/2024 10:40:52 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/02/2024 11:50:23 (GMT -03:00)**
TAG: **CL-LABMAR-001** **Amostra:** **Gradiente_AB**
Vial: **P1-A1** **Volume:** **0 µL**

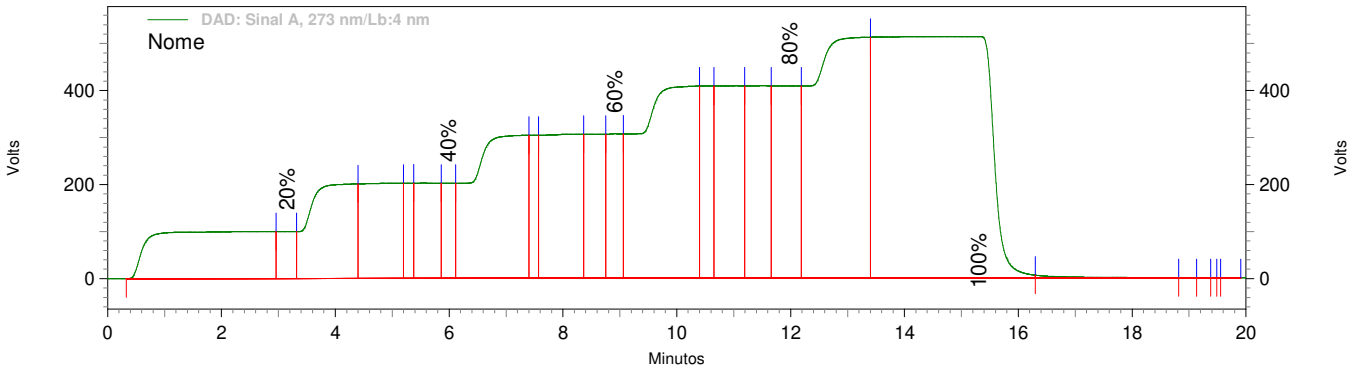


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Nome	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
20%	3,147	291728643	**13386563**
40%	5,990	412932705	**27171278**
60%	8,908	773877098	**41232809**
80%	11,983	1727918932	**54868178**
100%	15,300	9128769516	**68860620**

Totais		12335226894	**205519448**

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRADIENTE CD.met
Data:
C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Stevia\CL-LABMAR-001\GRADIENTES\CL-LABMAR-001003.rslt\Gradiente_CD_002
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **07/02/2024 11:01:43 (GMT -03:00)**
Impresso: **07/02/2024 11:57:04 (GMT -03:00)**
TAG: **CL-LABMAR-001** **Amostra:** **Gradiente_CD**
Vial: **P1-A1** **Volume:** **0 µL**

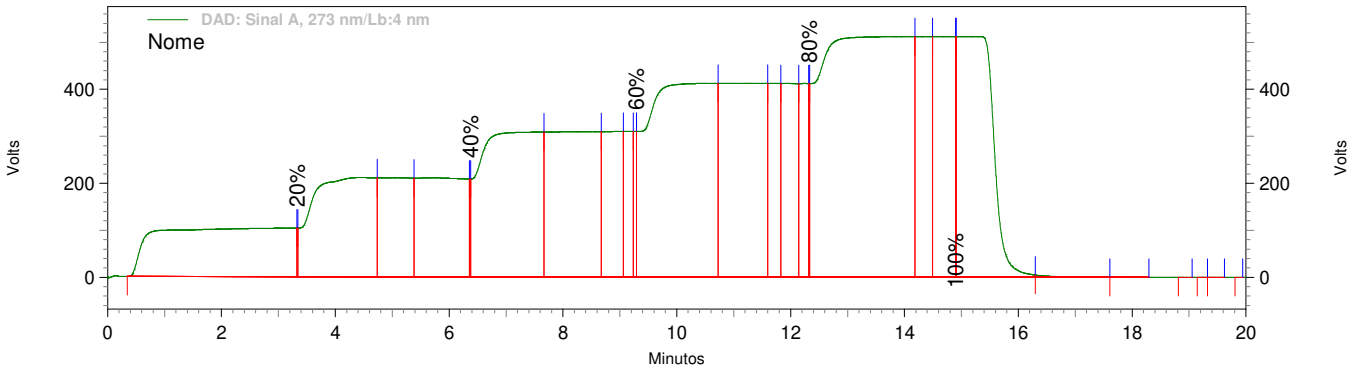

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Nome	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
20%	3,335	12463706	**13849148**
40%	6,378	39053927	**27902975**
60%	9,288	132914353	**41540676**
80%	12,325	55254708	**55255422**
100%	14,900	34349183	**68699963**

Totais		274035877	**207248184**