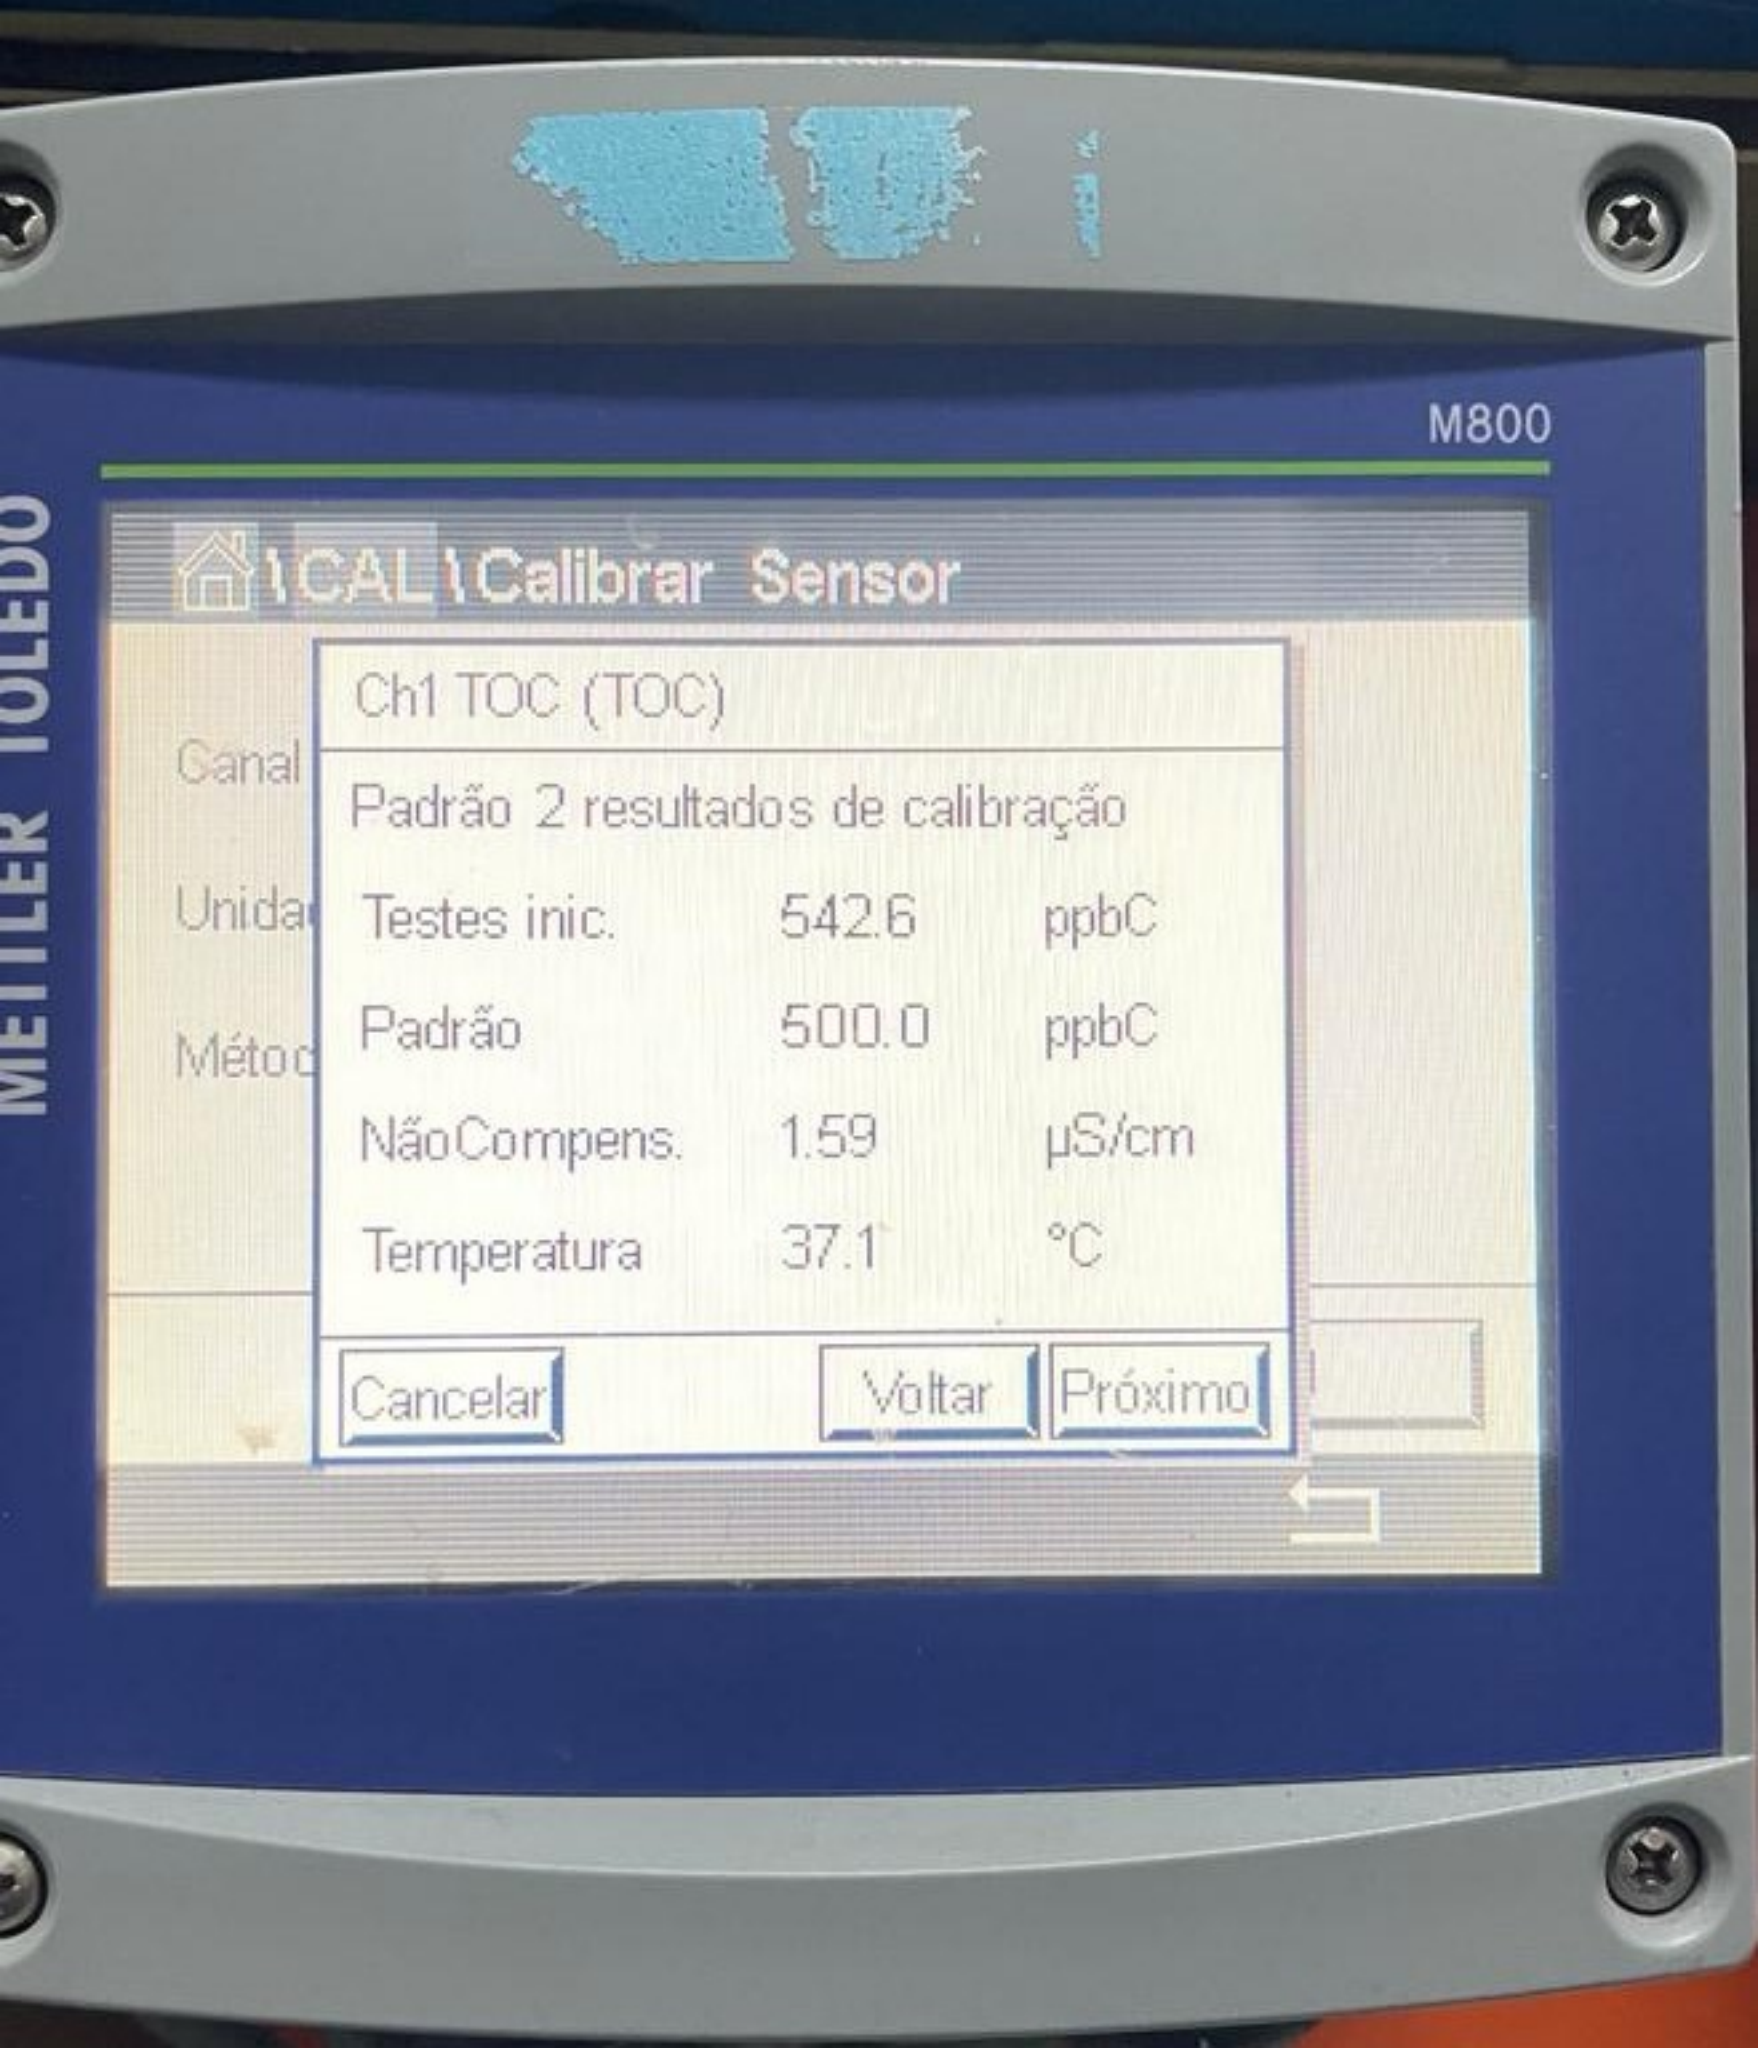

METTLER TOLEDO
M800
\CAL \Calibrar Sensor
Canal
Unidad
Método
Ch1 TOC (TOC)
H
Padrão 2 resultados de calibração
Testes inic. 250.8 ppbC
Padrão 250.0 ppbC
NãoCompens. 1.17 µS/cm
Temperatura 36.5 °C
Cancelar
Voltar
Próximo


METTLER TOLEDO
M800
\CAL\Calibrar Sensor
Canal
Unida
Métoc
Ch1 TOC (TOC)
Padrão 2 resultados de calibração
Testes inic. 542.6 ppbC
Padrão 500.0 ppbC
NãoCompens. 1.59 µS/cm
Temperatura 37.1 °C
Cancelar
Voltar
Próximo


M800
\CAL\Realizar SST
Ch1 TOC SST Resumo
Rw 13.6 ppbC
Rs 569.5 ppbC
Canal
Rss 544.5 ppbC
%da Efic.respos. 95.5 %
Rs-Rw 555.9 ppbC
Resultado Aprovado
Relatório
Voltar
Próximo


Digimed
CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:
28/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO:
FG-15800/23
Nº DE SÉRIE:
77158
CALIBRADO EM:
28/04/23
Digimed
CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:
27/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO:
FG-15801/23
Nº DE SÉRIE:
77158
CALIBRADO EM:
27/04/23
26/02/24 13:52
K
6.1085CH--
Auto
23.6°C
0.642
Cont
0067
HS/CM
@ 25°C
ST-BY
F1
F2
F3
F4
Digimed


ilac-MRA
Digimed
CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO
28/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO
FG-15800/23
Nº DE SÉRIE
77158
CALIBRADO EM:
28/04/23
ilac-MRA
Digimed
CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO
27/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO
FG-15801/23
Nº DE SÉRIE
77158
CALIBRADO EM:
27/04/23
26/02/24 13:52
K
0.1085CH--
Auto
23.6°C
0.642
Cont
0067
HS/cm
@ 25°C
ST-BY
F1
F2
F3
F4
Digimed


CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:
28/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO:
FG-15800/23
Nº DE SÉRIE:
77158
CALIBRADO EM:
28/04/23
CALIBRAÇÃO ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CAL 0378
PRÓXIMA CALIBRAÇÃO:
27/04/24
Preenchido pelo cliente
Nº DO CERTIFICADO:
FG-15801/23
Nº DE SÉRIE:
77158
CALIBRADO EM:
27/04/23
26/02/24 13:52
K
0.1085CM--
Auto
23.8°C
0.640
Cont
0067
mS/cm
@ 25°C
ST-BY
F1
F2
F3
F4
Digimed


METTLER TOLEDO
M800
TA-PW-18
CHAN_1
1.91
ppb TOC
0.70
µS/cm
CHAN_2
5.84
pH
22.0
°C
ISM