



Spectral Scan - MWD [DE64255828]
Absorbance [mAU]
600
500
400
300
200
100
0
(204, 616.029249)
(273, 234.430436)
(245, 51.808209)
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]


Relatório SRELB

Detector VWD – G1365D – N/S DE64255828	Data: 15/02/2023
Ruído:	
Valor máximo: 0.586033 mAU	**Diferença: 0.016689 mAU**
Valor mínimo: 0.569344 mAU	

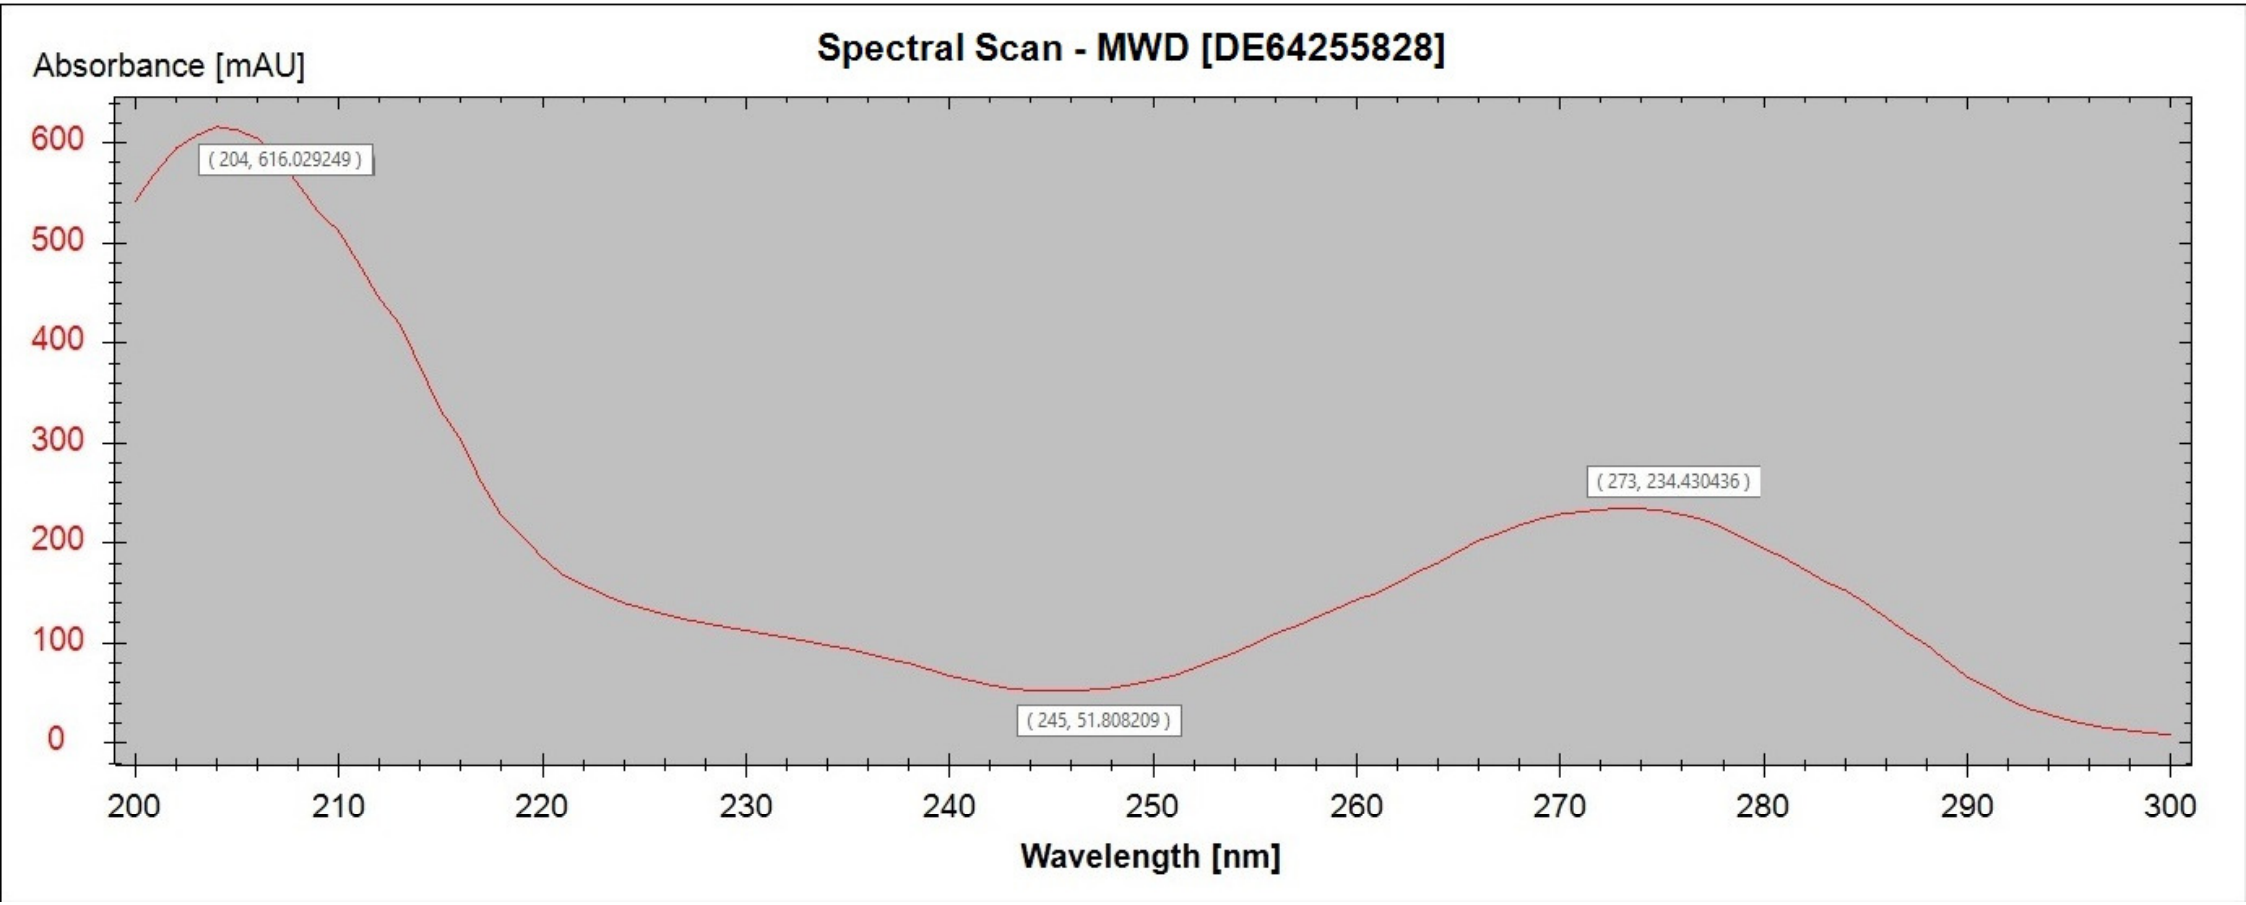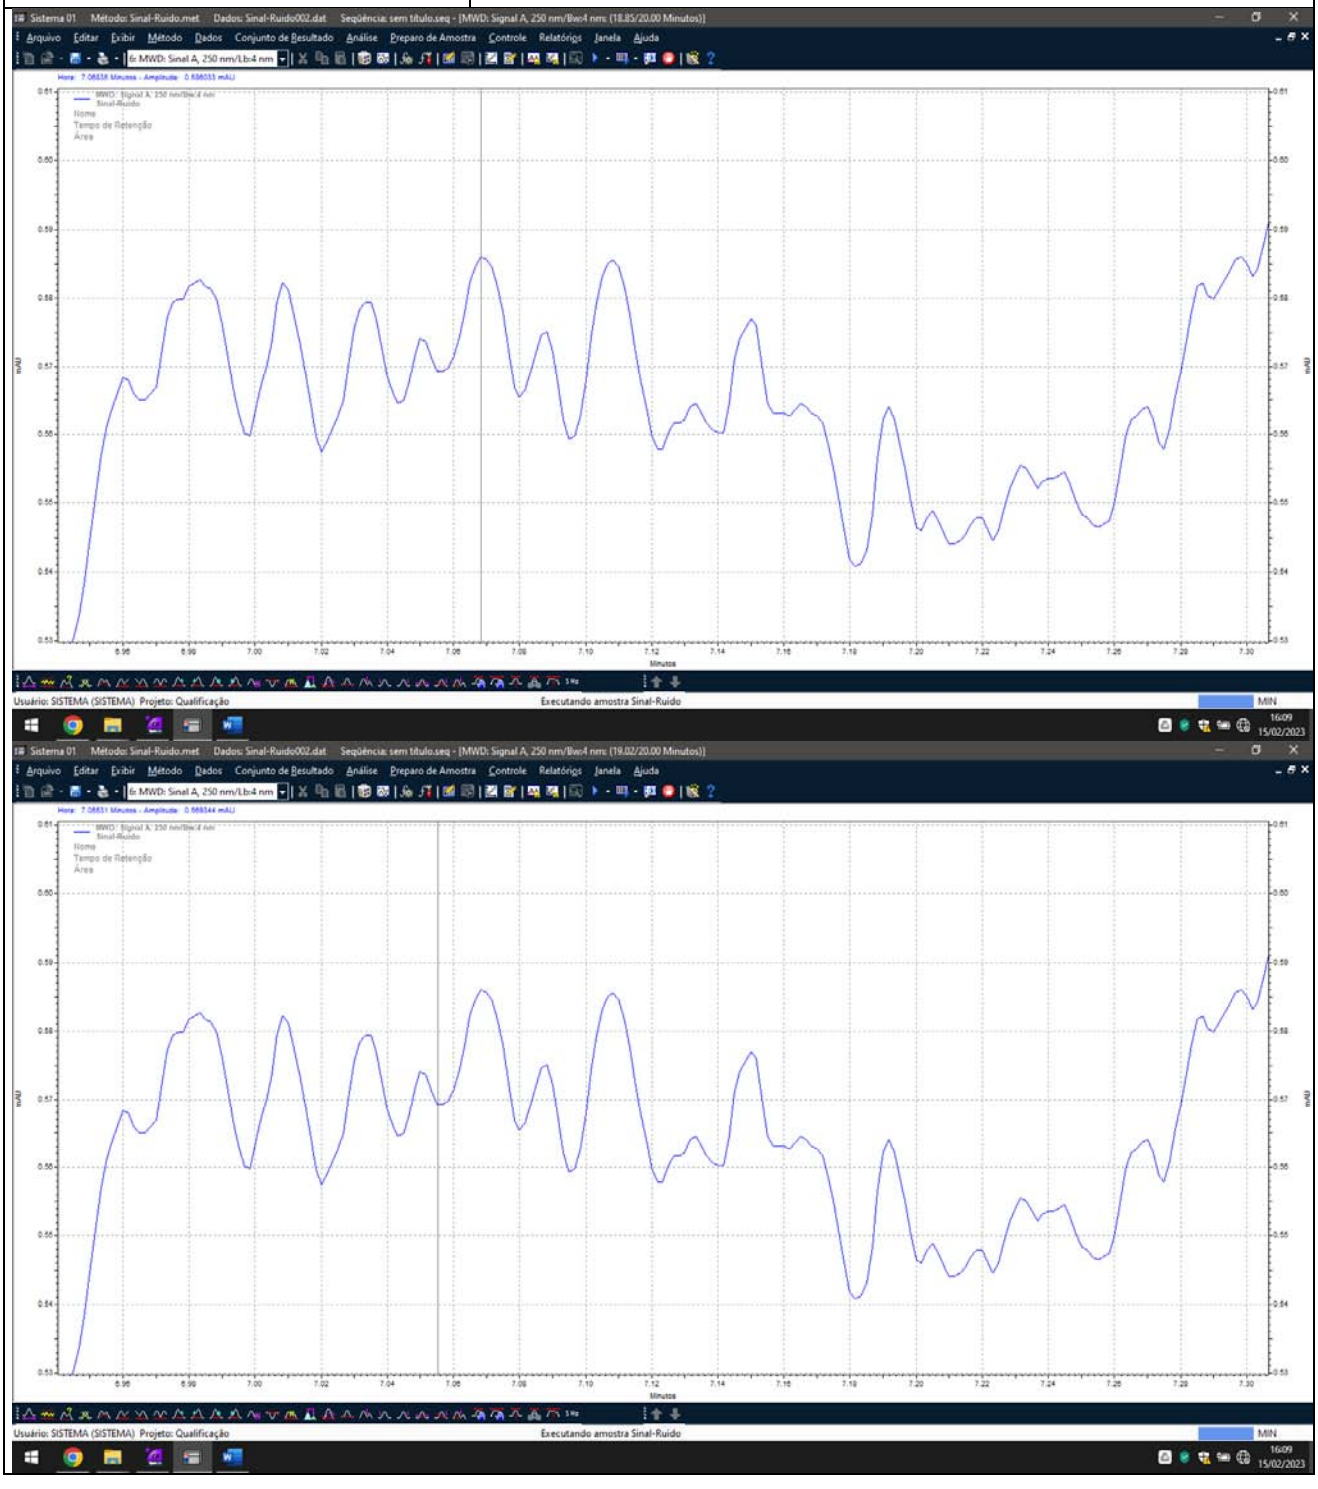


Estabilidade da Linha de Base:	
Valor máximo: 0.621319 mAU	**Diferença (20 minutos): 0.736241 mAU**
Valor mínimo: 1.35756 mAU	**Diferença (60 minutos): 0.736241 x 3 = 2.208723 mAU**

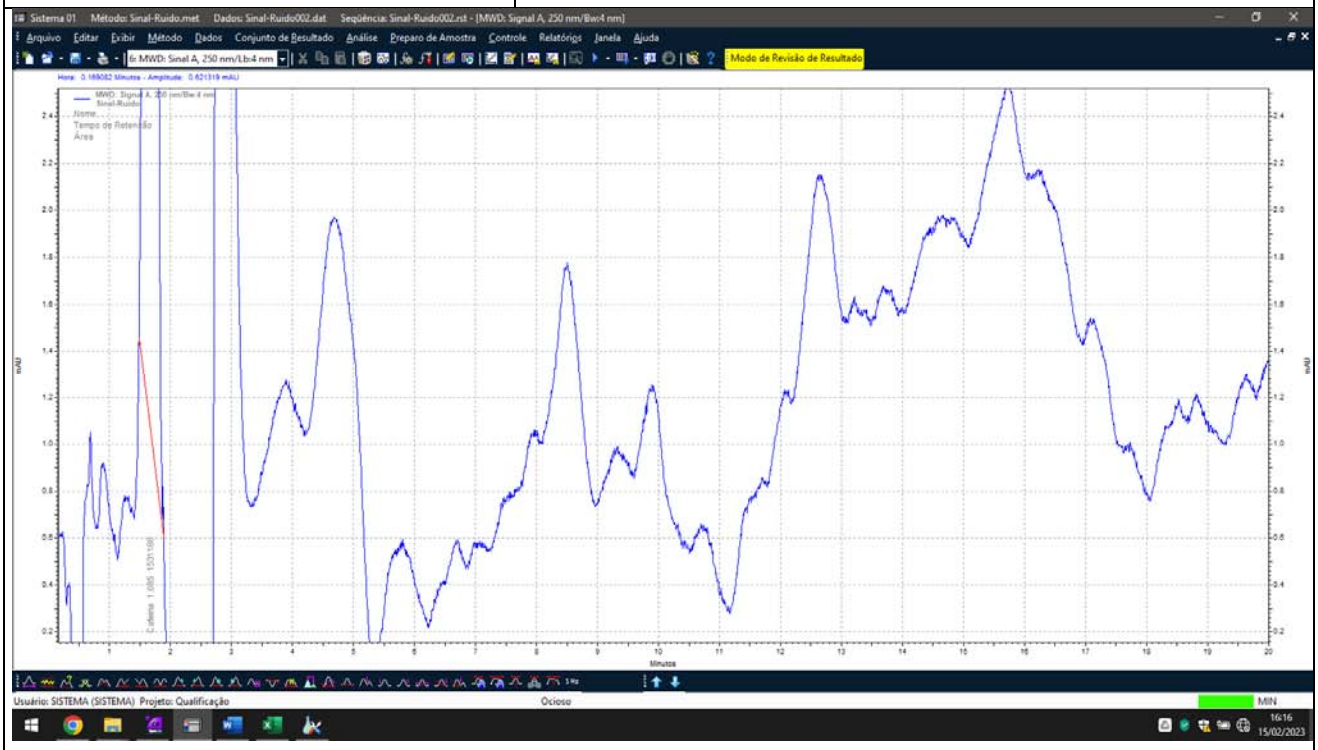

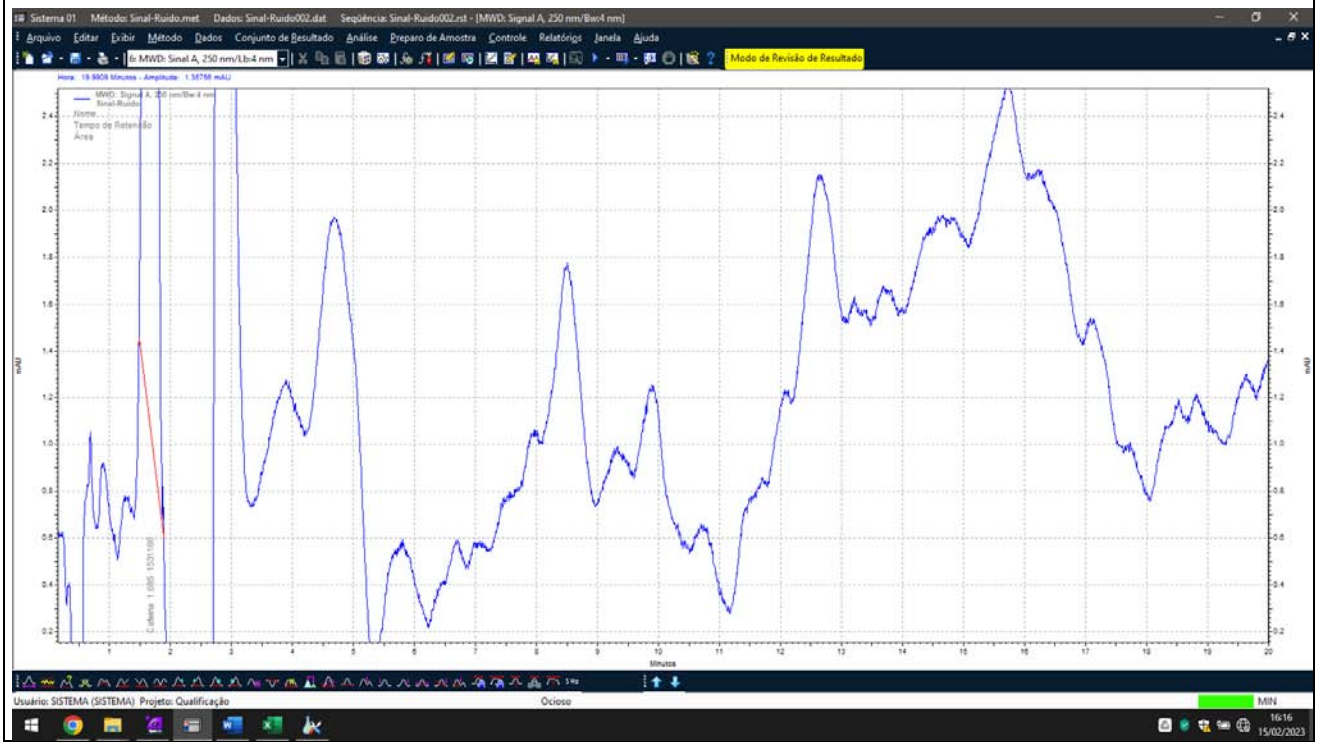


Altura do Pico:

Valor: 122.606 mAU

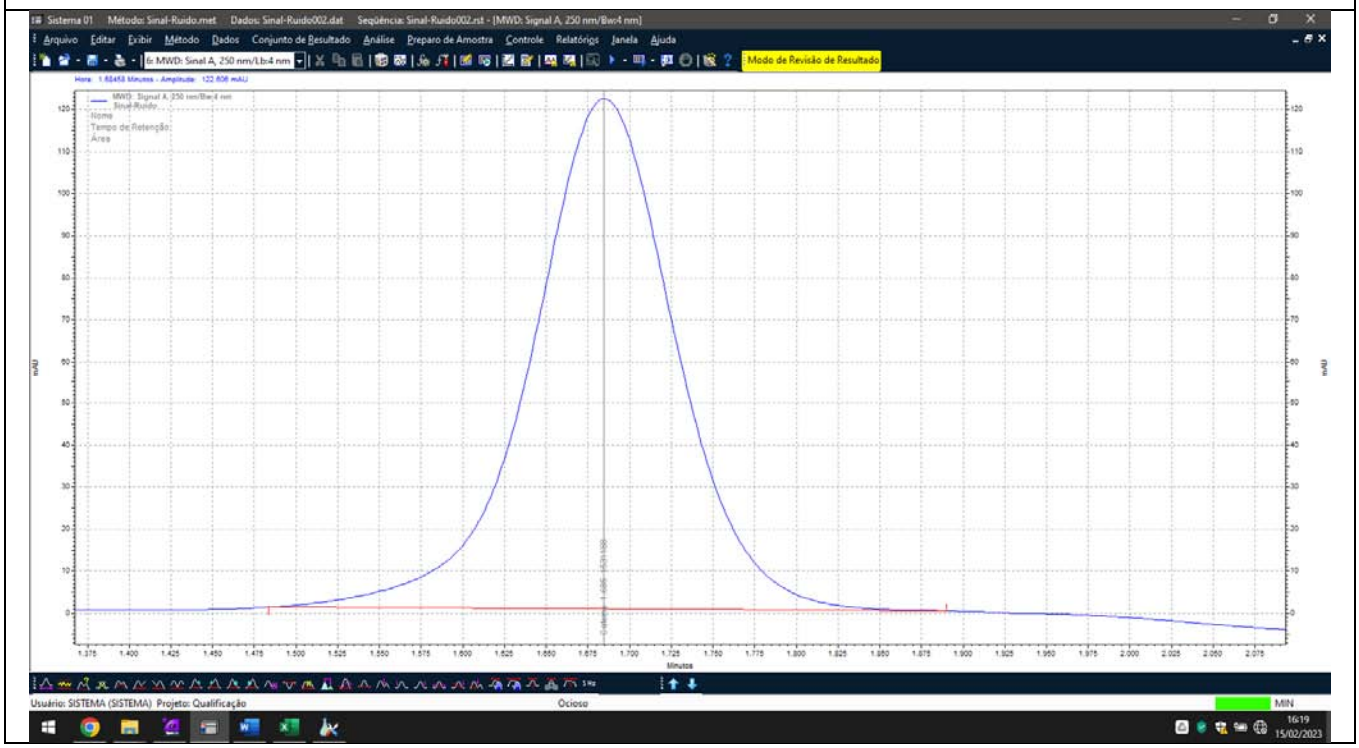

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\Sinal-Ruido\Sinal-Ruido002.rslt\Sinal-Ruido002.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:50:26 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 16:23:17 (GMT -03:00)

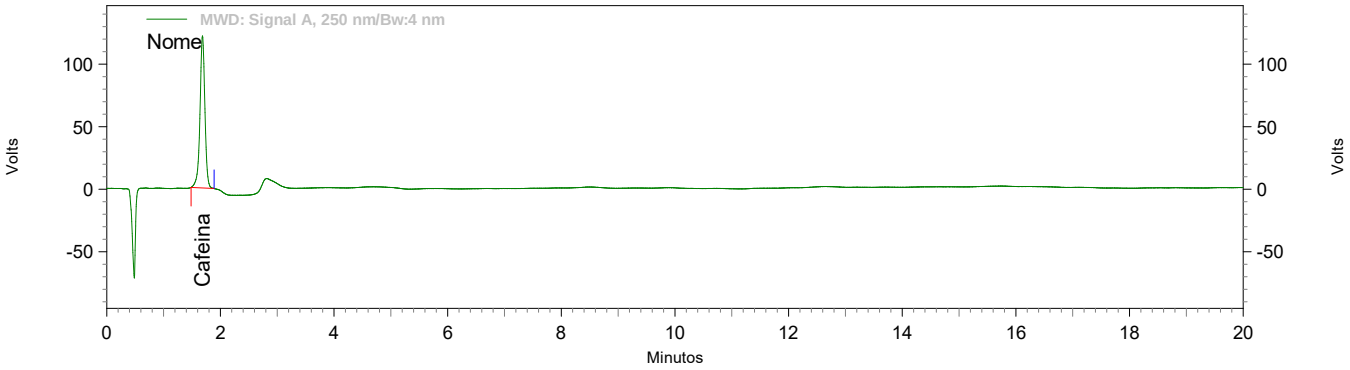


Resultados MWD: Signal A, 250 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.685	1531188	**0.000**
Totais			1531188	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\Branco 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **15/02/2023 13:52:25 (GMT -03:00)**
Impresso: **15/02/2023 14:02:30 (GMT -03:00)**

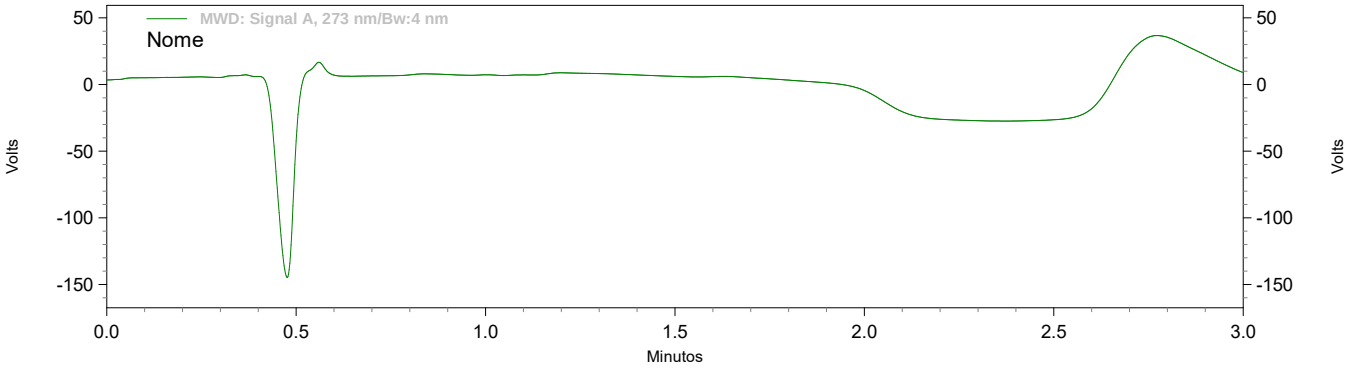


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 1
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 13:56:39 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:02:55 (GMT -03:00)

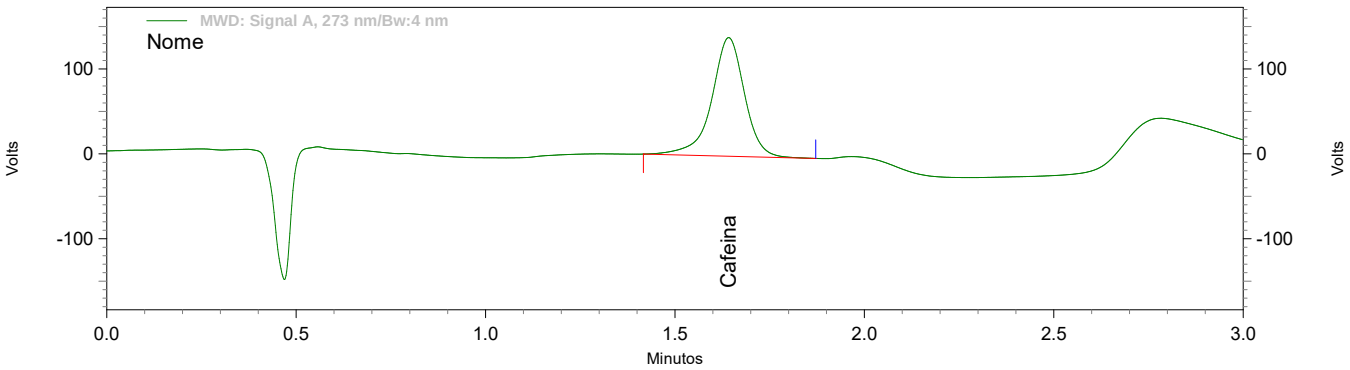


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.642	1762338	**0.000**
Totais			1762338	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **15/02/2023 14:00:54 (GMT -03:00)**
Impresso: **15/02/2023 14:07:55 (GMT -03:00)**

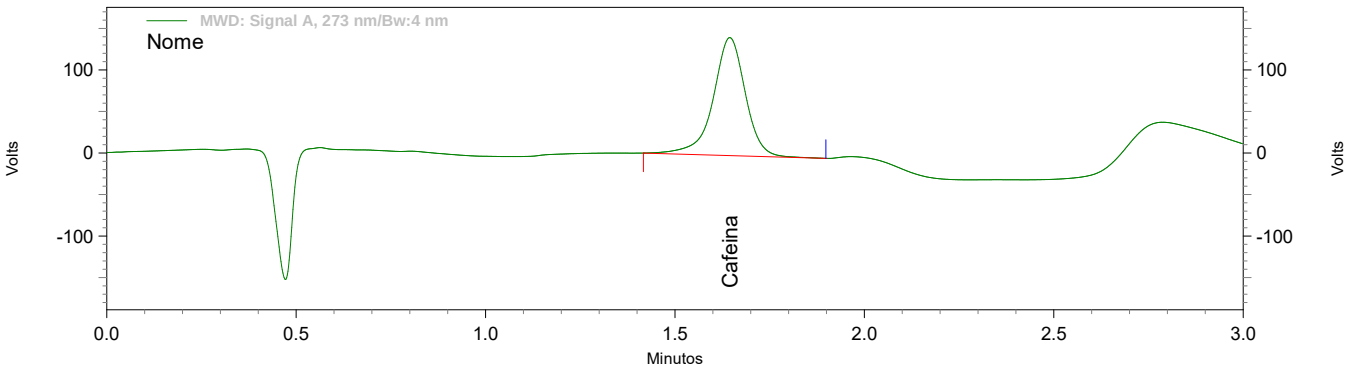


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.645	1756671	**0.000**
Totais			1756671	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:05:08 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:12:18 (GMT -03:00)

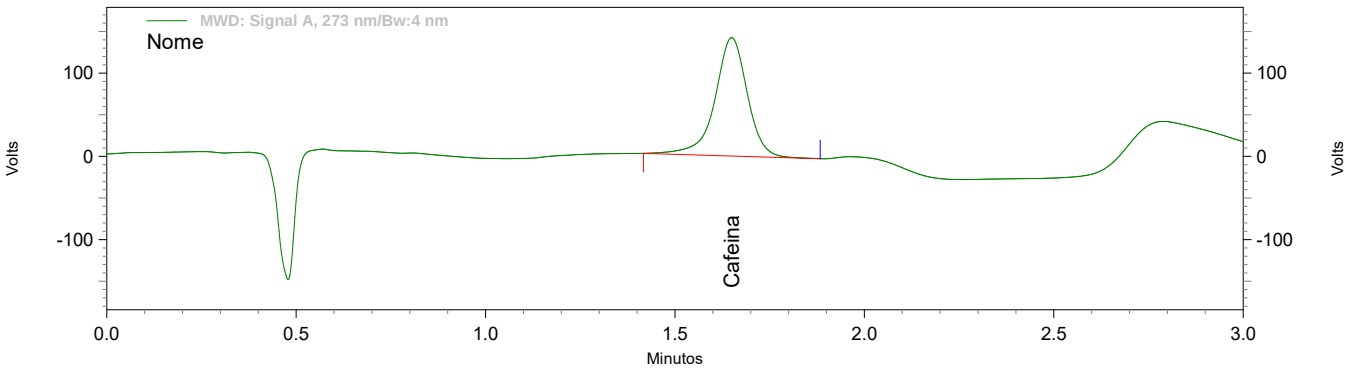


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.650	1766319	**0.000**
Totais			1766319	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\Branco 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **15/02/2023 14:09:26 (GMT -03:00)**
Impresso: **15/02/2023 14:13:20 (GMT -03:00)**

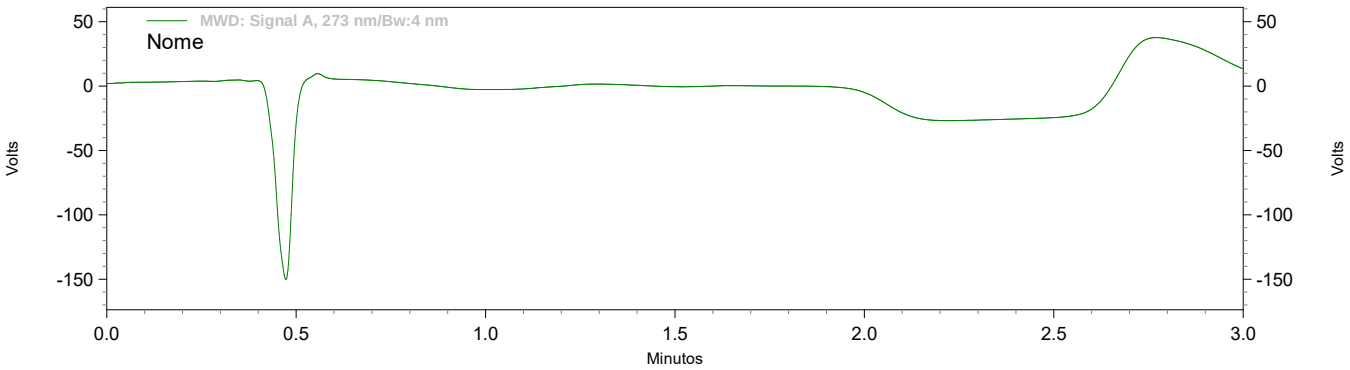


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:13:37 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:17:31 (GMT -03:00)

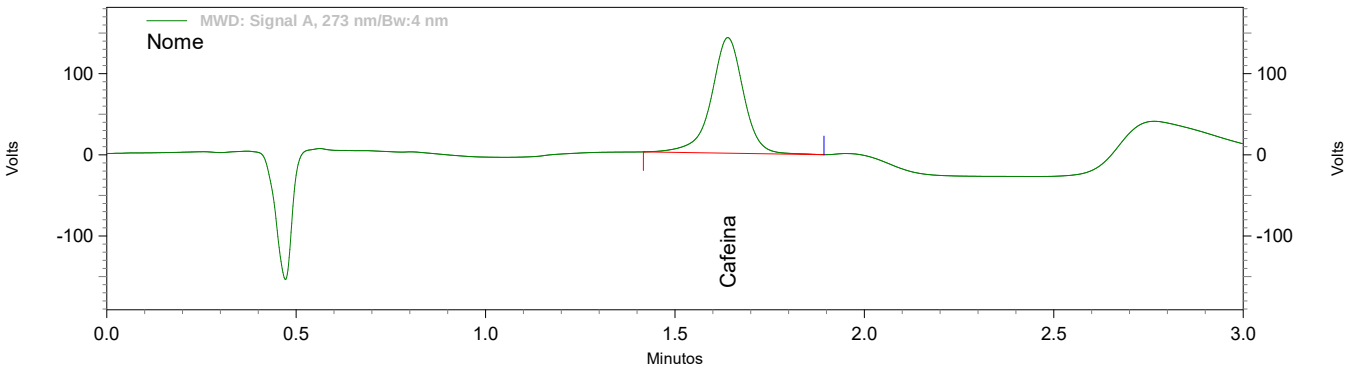


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.640	1759096	**0.000**
Totais			1759096	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:17:46 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:21:33 (GMT -03:00)

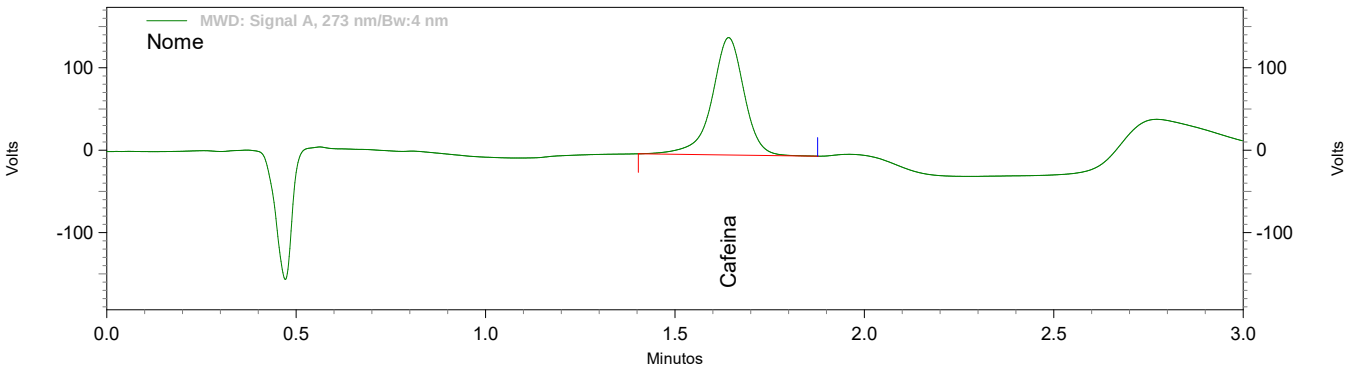


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.642	1765146	**0.000**
Totais			1765146	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\PCIN 6
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:22:01 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:25:55 (GMT -03:00)

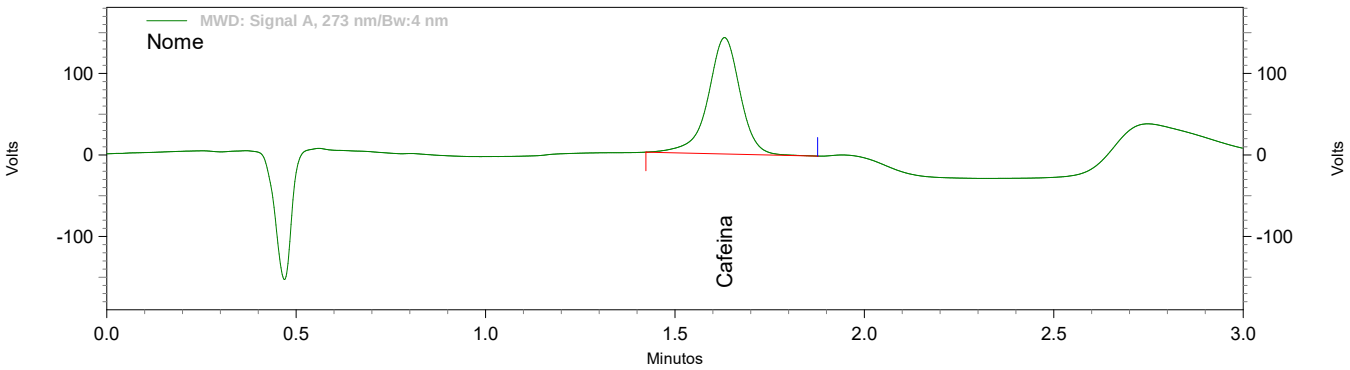


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.632	1763202	**0.000**
Totais			1763202	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\PCIN\PCIN.seq001.rslt\Branco 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **15/02/2023 14:26:11 (GMT -03:00)**
Impresso: **15/02/2023 14:33:55 (GMT -03:00)**

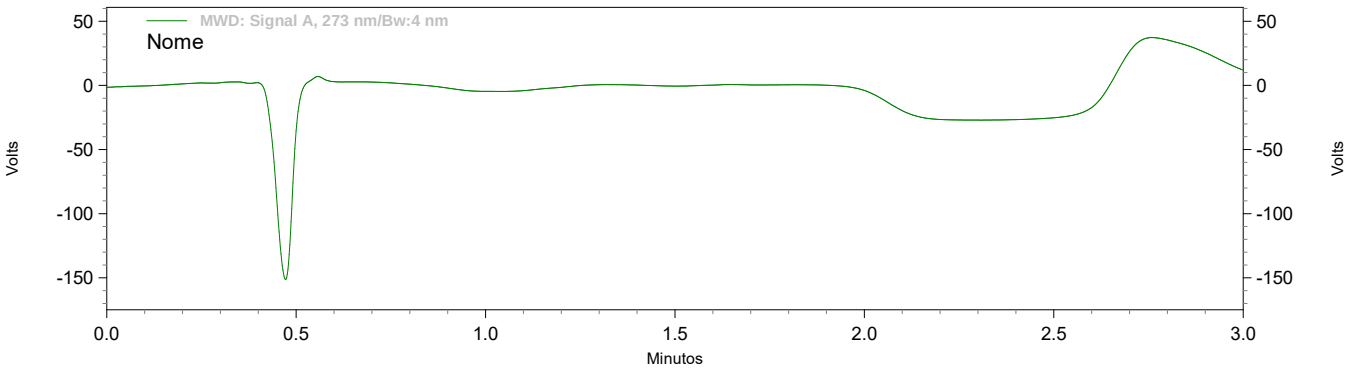


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:35:03 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:43:25 (GMT -03:00)

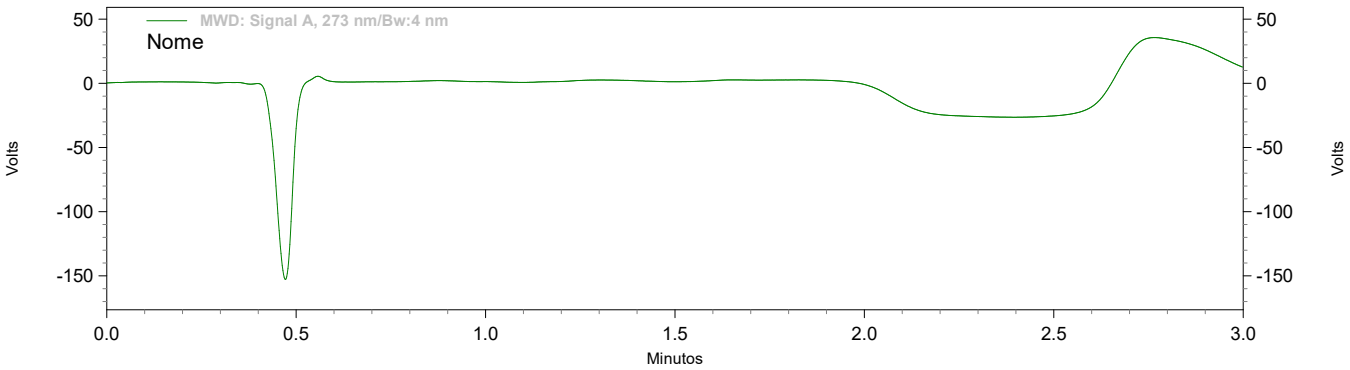


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:39:17 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:44:23 (GMT -03:00)

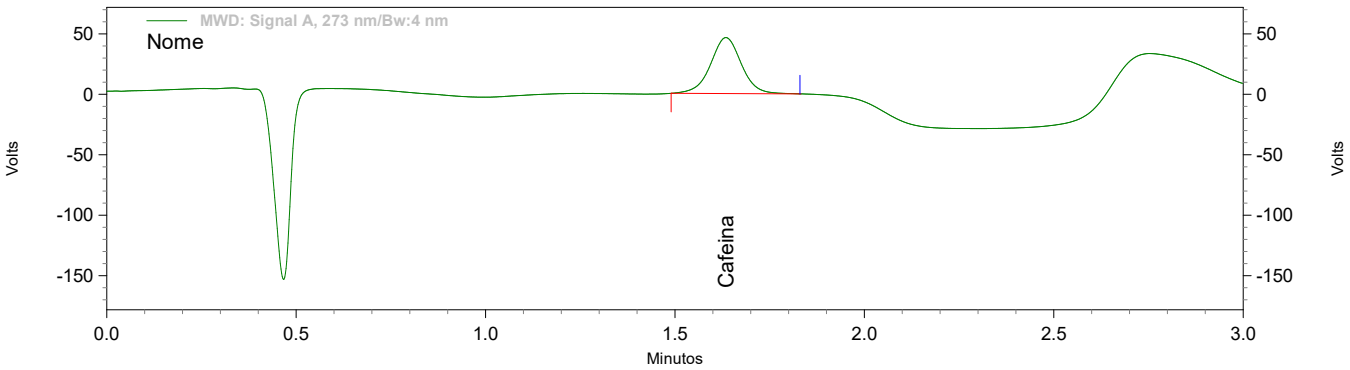


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.635	549298	**0.000**
Totais			549298	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:43:34 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:48:49 (GMT -03:00)

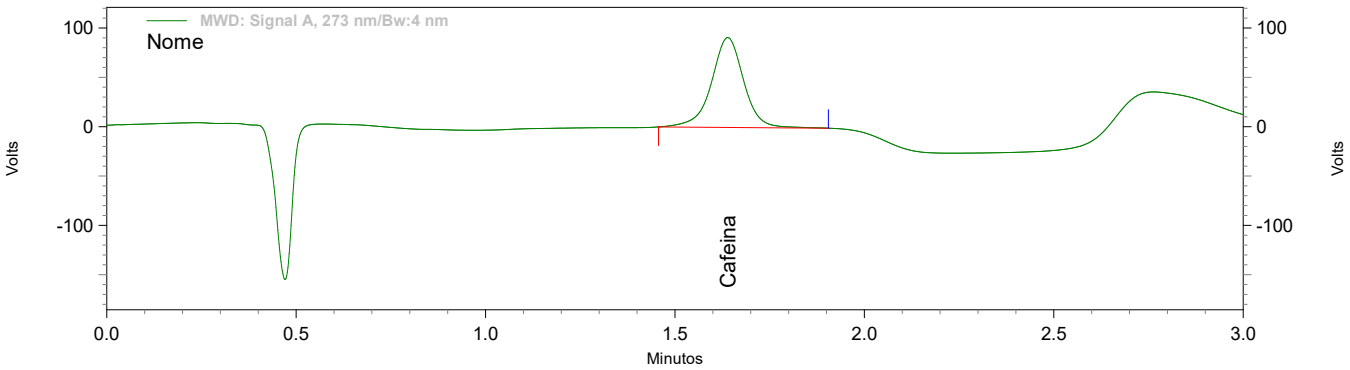


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.640	1130093	**0.000**
Totais			1130093	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:47:51 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:55:25 (GMT -03:00)

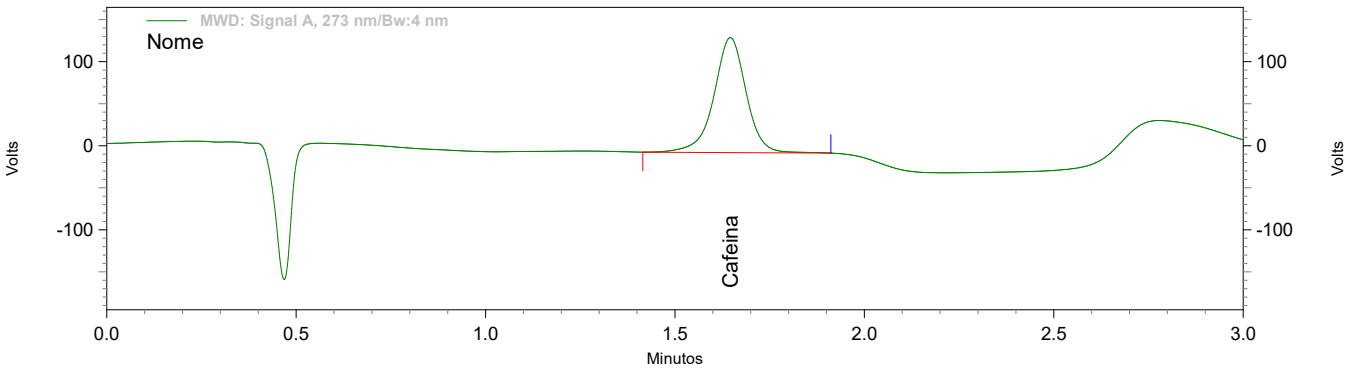


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.647	1694811	**0.000**
Totais			1694811	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LDUV\LDUV.seq001.rslt\LDUV 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 14:52:08 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 14:57:42 (GMT -03:00)

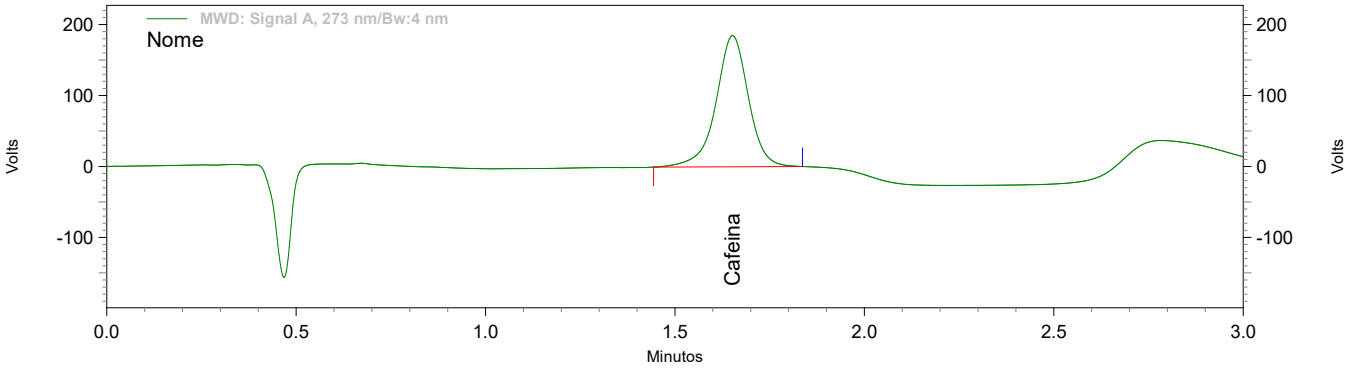


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.652	2304132	**0.000**
Totais			2304132	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 1.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:01:24 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 15:05:18 (GMT -03:00)

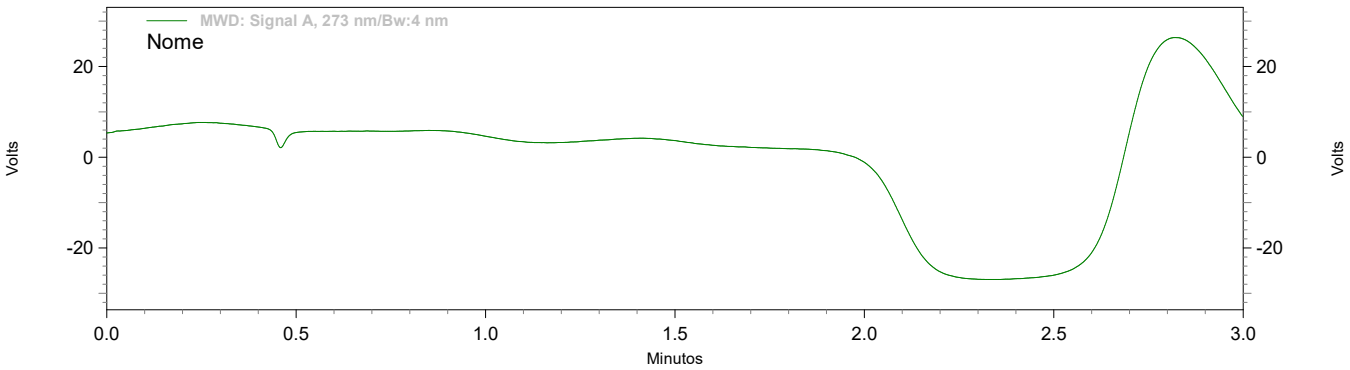


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 2
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:05:34 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 15:11:05 (GMT -03:00)

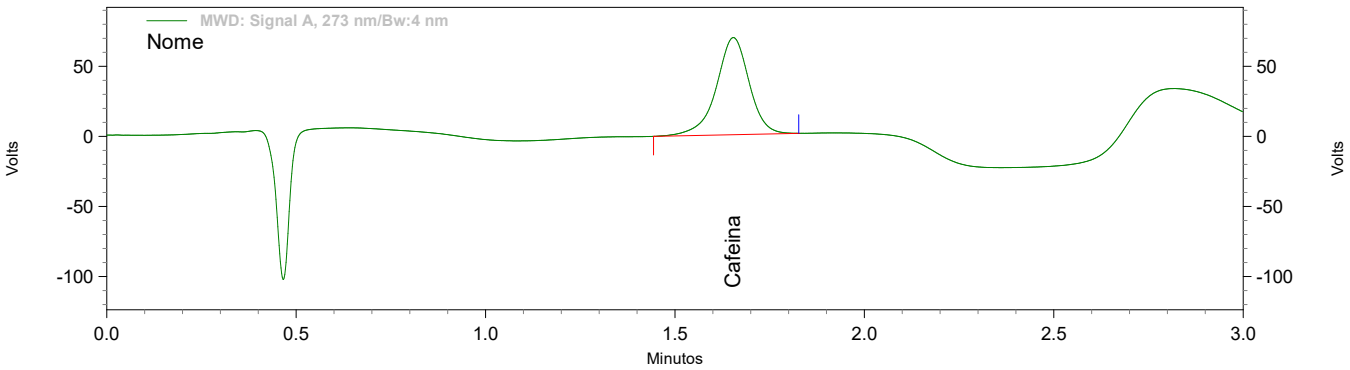


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.653	876325	**0.000**
Totais			876325	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 3
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:09:46 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 15:13:30 (GMT -03:00)

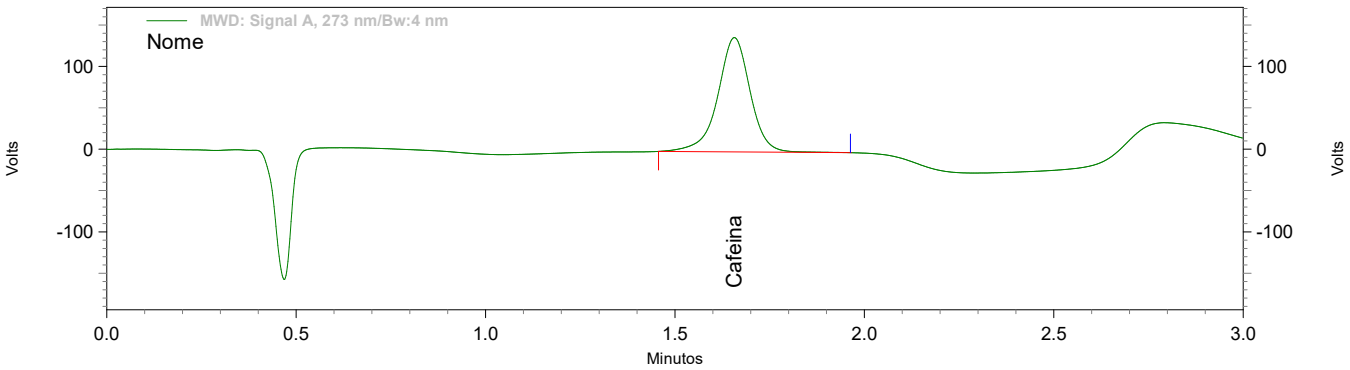


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.657	1717529	**0.000**
Totais			1717529	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 4
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:14:03 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 15:18:53 (GMT -03:00)

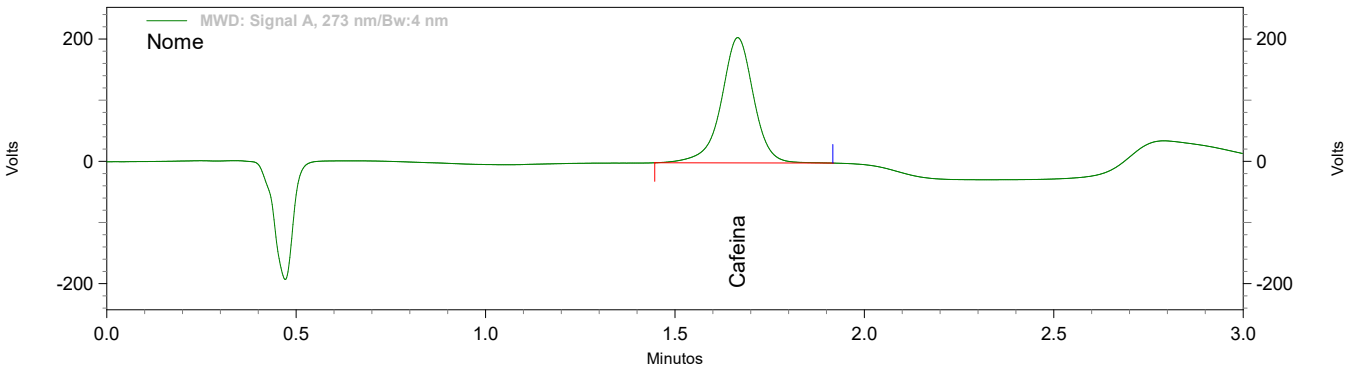


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.665	2555059	**0.000**
Totais			2555059	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\LIIN\LIIN.seq001.rslt\LIIN 5
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 15/02/2023 15:18:21 (GMT -03:00)
Impresso: 15/02/2023 15:22:34 (GMT -03:00)

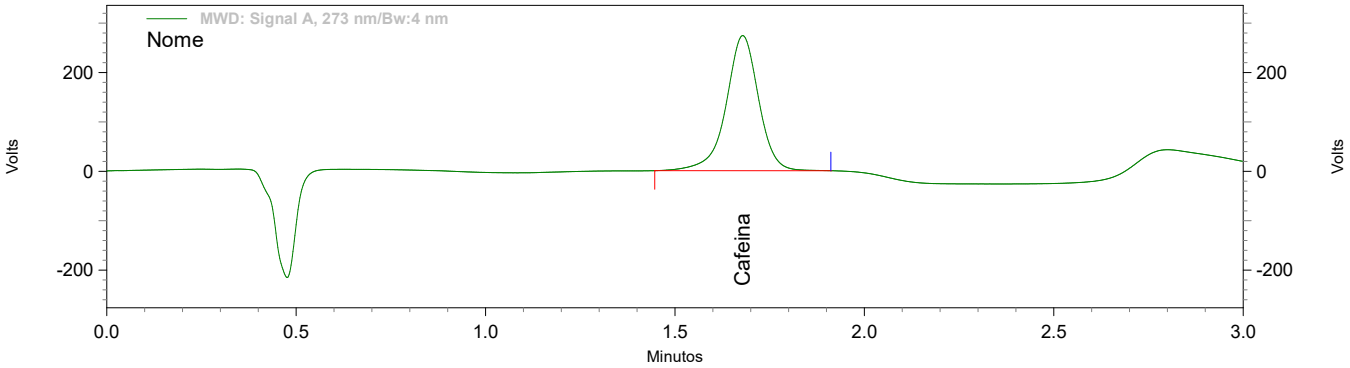


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.678	3421860	**0.000**
Totais			3421860	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad AB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\Grad AB\Grad AB001.rslt\Grad AB001.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/02/2023 08:44:38 (GMT -03:00)
Impresso: 16/02/2023 09:07:46 (GMT -03:00)

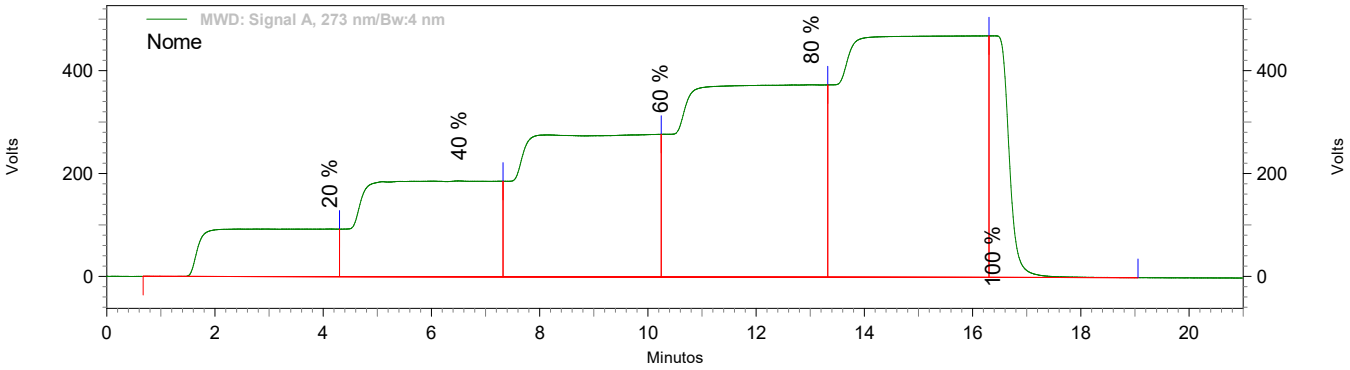


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	4.123	194124	**0.000**
2	40 %	6.508	390792	**0.000**
3	60 %	10.233	581906	**0.000**
4	80 %	13.025	784476	**0.000**
6	100 %	16.370	984975	**0.000**

Totais			2936273	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Grad CD.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 01\Grad CD\Grad CD002.rslt\Grad CD002.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 16/02/2023 09:33:41 (GMT -03:00)
Impresso: 16/02/2023 09:58:17 (GMT -03:00)

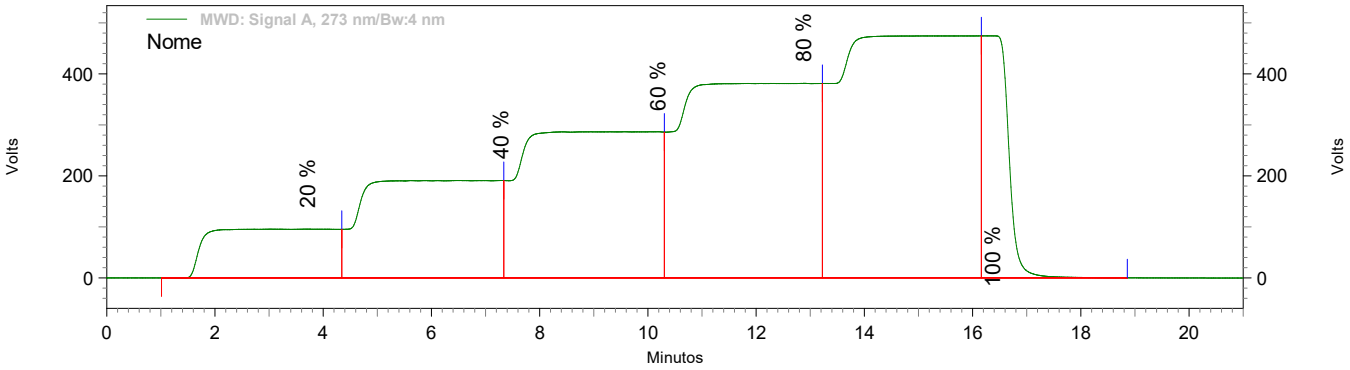

Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração NORM*
1	20 %	3.712	200435	**0.000**
2	40 %	7.292	400478	**0.000**
3	60 %	10.190	600746	**0.000**
4	80 %	12.887	799685	**0.000**
6	100 %	16.372	994818	**0.000**

Totais			2996162	**0.000**