
Certificado Nº: 000/00 -RELB	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**171,1580**

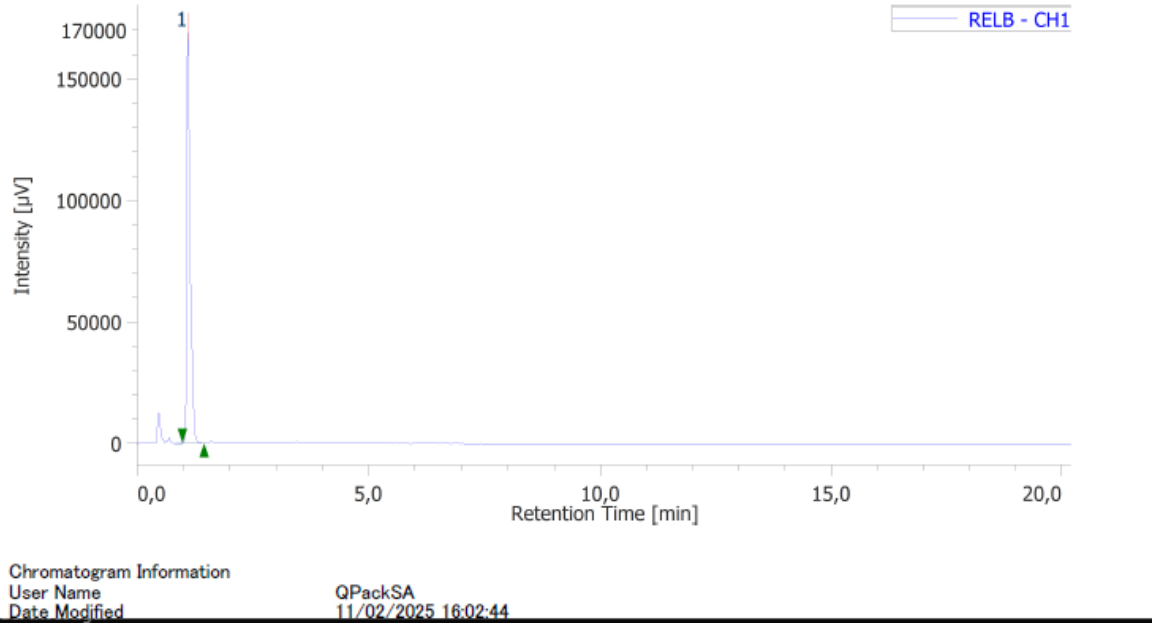


#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [µV·sec]	Height [µV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning
1	Cafeína	1	1,092	853296	171158	100,000	100,000	N/A	1494	N/A	1,762	

Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,1230
VALOR MÍNIMO:	-0,1370
	Ruído
	0,0140

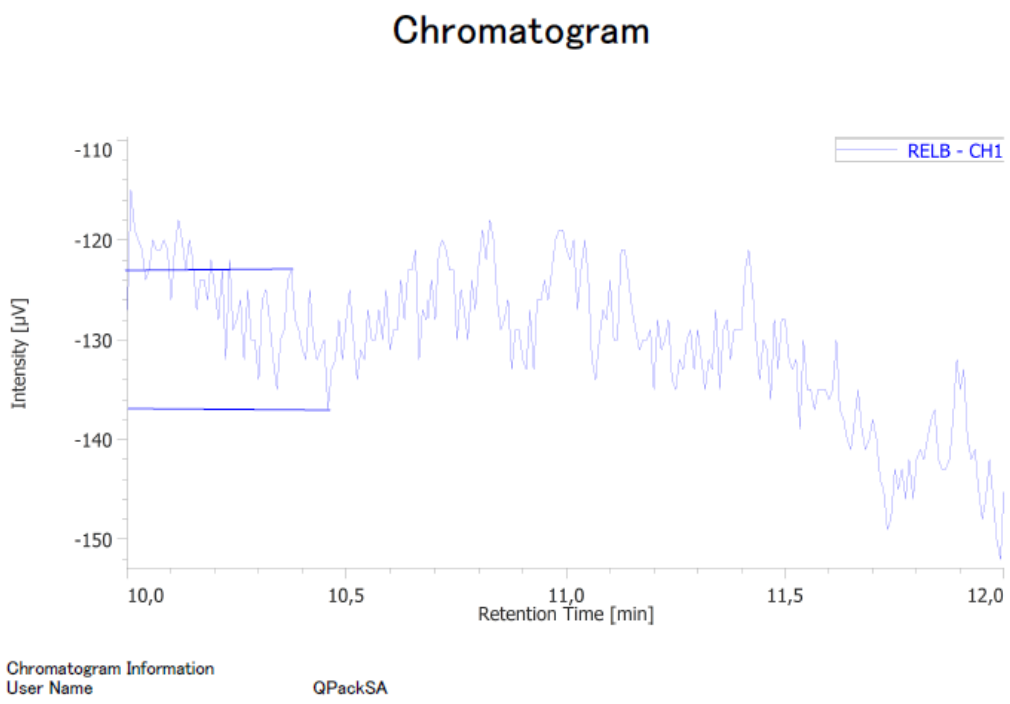

Certificado Nº: 000/00	Início da Qualificação: 00/00/0000	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,6000
VALOR MÍNIMO:	-0,2000	
Resultado:	0,2000	

