

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\Rampa Temperatura 001.sirslt\Rampa Temperatura 001.dx		
Nome da amostra:	Rampa Temperatura 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	
Data da Injeção:	2025-02-14 12:08:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Rampa Temperatura.amx	**Volume de Injeção:**	0.000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 08:34:04-03:00		

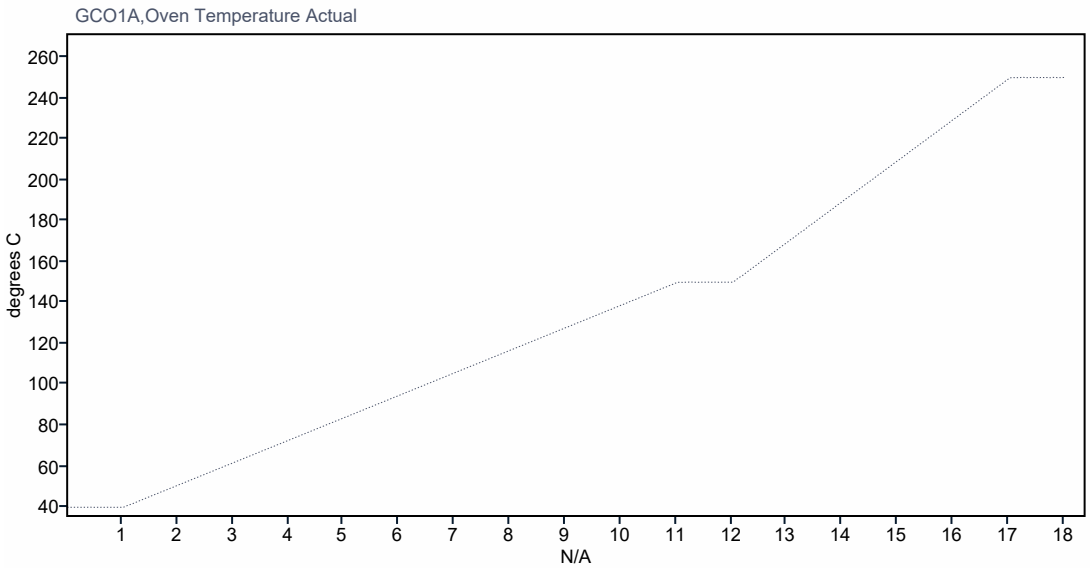

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 001 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 001 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 11:00:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

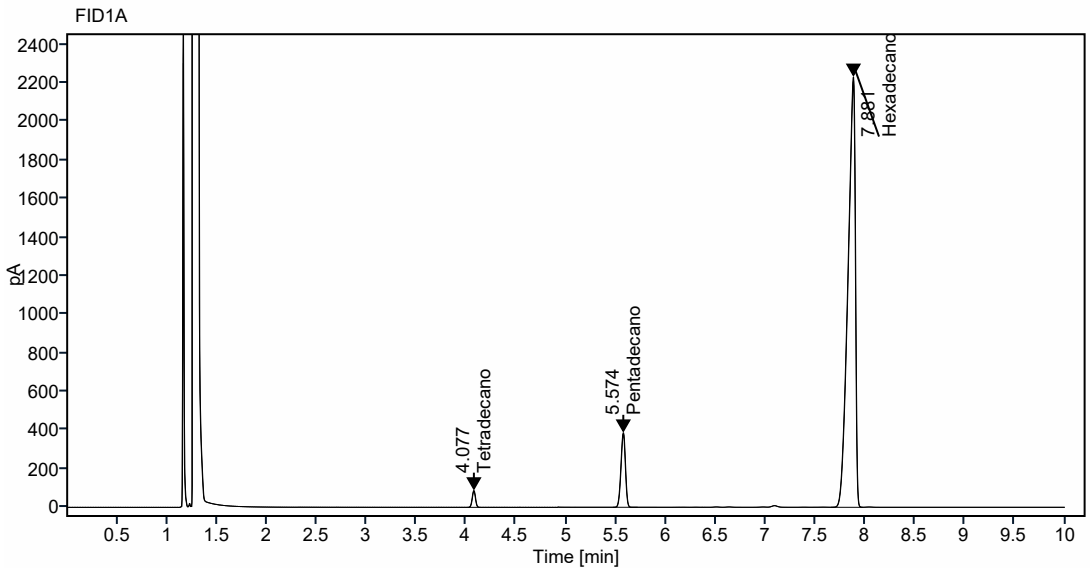


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	197.4854	87.0407	1.5265	3.22	PCIN 001 FRONT
5.574	1202.4362	386.7834	9.2944	14.29	PCIN 001 FRONT
7.881	11537.2776	2233.0597	89.1791	82.50	PCIN 001 FRONT
Sum	12937.1992				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 002 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 002 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 11:12:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

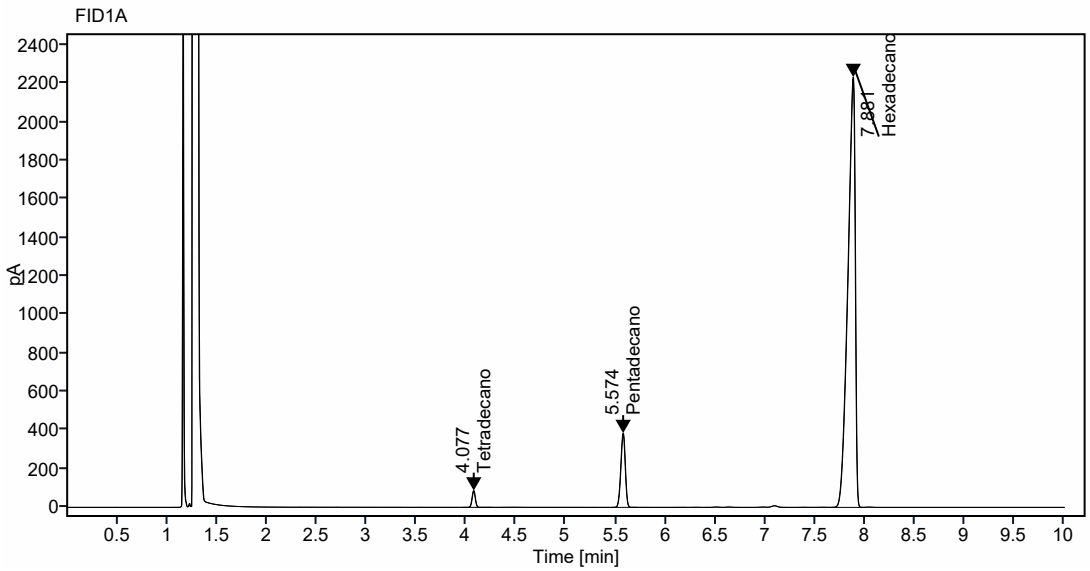


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	195.4462	87.0334	1.5148	3.22	PCIN 002 FRONT
5.574	1195.4247	385.4069	9.2648	14.24	PCIN 002 FRONT
7.881	11511.9277	2233.1476	89.2204	82.54	PCIN 002 FRONT
Sum	12902.7985				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 003 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 003 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 11:23:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

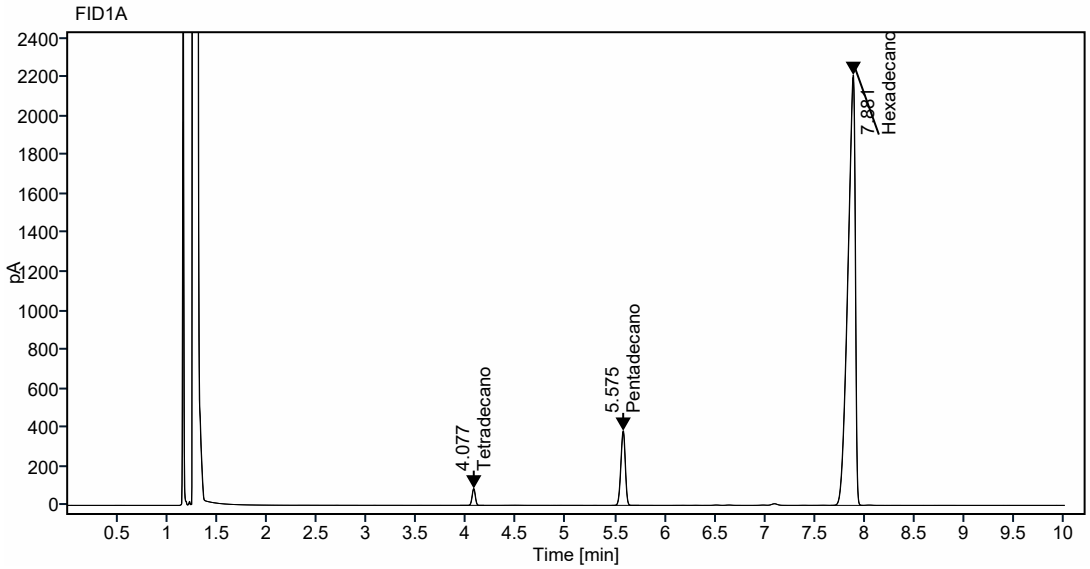


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	192.8447	86.3929	1.5026	3.22	PCIN 003 FRONT
5.575	1184.1648	383.4948	9.2269	14.29	PCIN 003 FRONT
7.881	11456.8819	2213.3693	89.2705	82.49	PCIN 003 FRONT
Sum	12833.8914				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 004 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 004 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 11:47:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

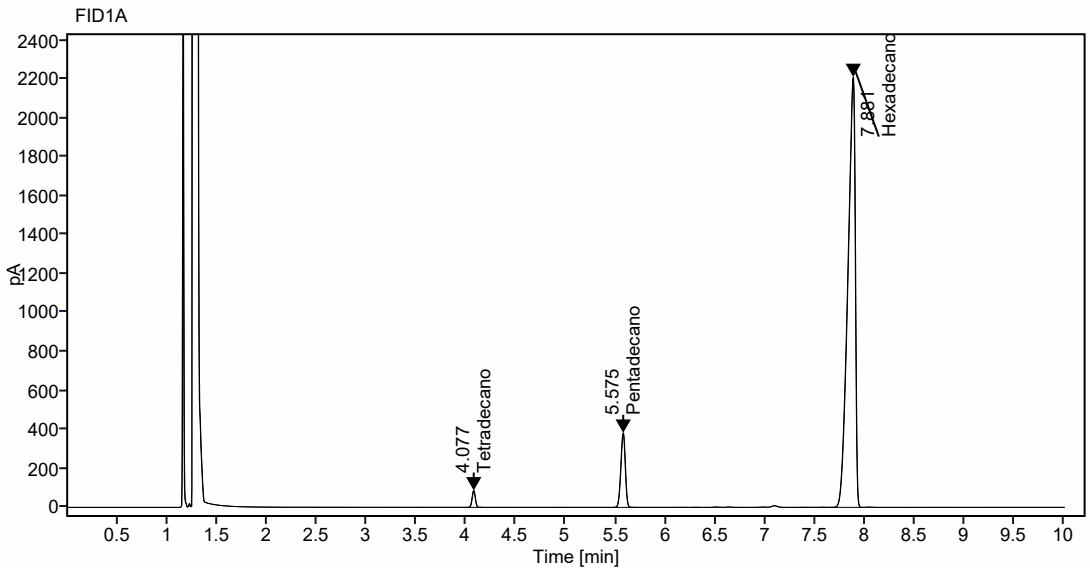


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	193.5231	87.0256	1.5047	3.24	PCIN 004 FRONT
5.575	1187.7581	383.4057	9.2349	14.29	PCIN 004 FRONT
7.881	11480.3513	2211.7019	89.2605	82.46	PCIN 004 FRONT
Sum	12861.6324				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 005 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 005 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 11:58:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

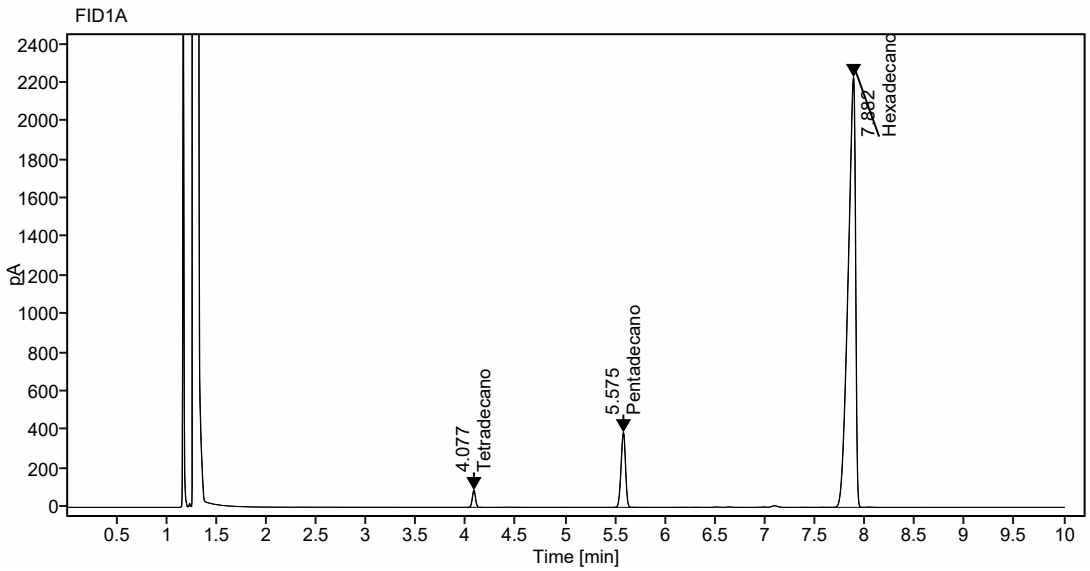


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	197.0227	88.1948	1.5187	3.26	PCIN 005 FRONT
5.575	1204.3601	387.8056	9.2836	14.34	PCIN 005 FRONT
7.882	11571.5762	2228.6487	89.1977	82.40	PCIN 005 FRONT
Sum	12972.9589				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN FRONT 001.rslt\PCIN 006 FRONT.dx		
Nome da amostra:	PCIN 006 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 12:10:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:27:02-03:00		

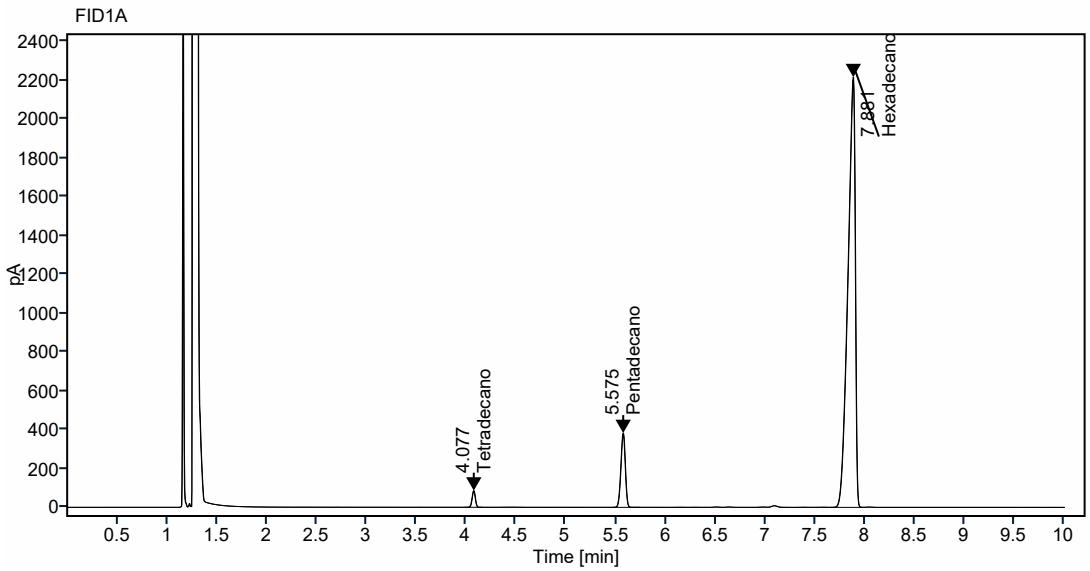


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	192.3838	86.0523	1.5047	3.20	PCIN 006 FRONT
5.575	1181.2588	382.8675	9.2388	14.26	PCIN 006 FRONT
7.881	11412.2494	2216.0595	89.2566	82.54	PCIN 006 FRONT
Sum	12785.8920				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI FRONT 001.rslt\LDFI 001 FRONT.dx		
Nome da amostra:	LDFI 001 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 12:34:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:43:31-03:00		

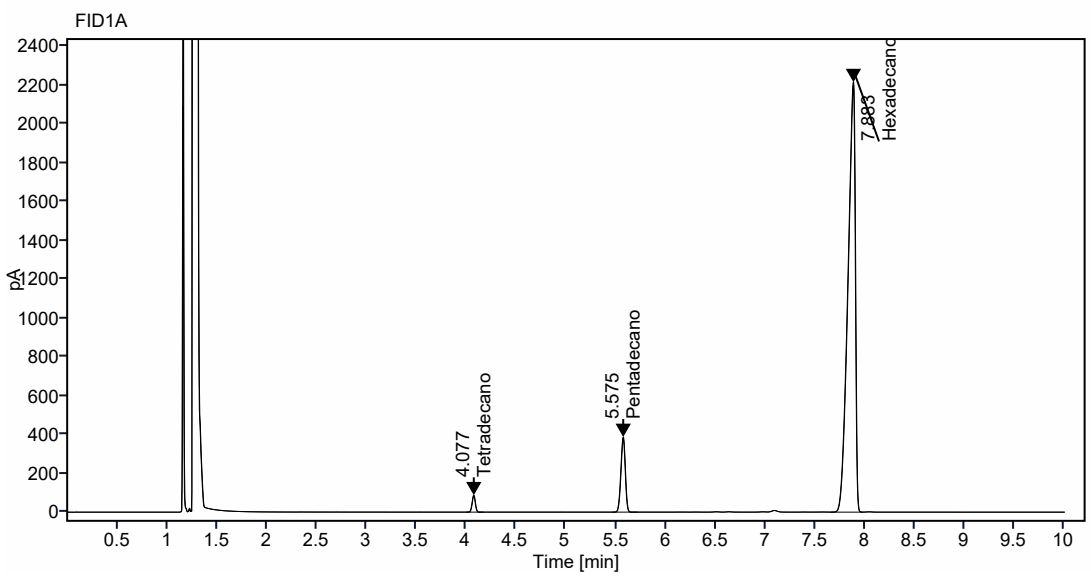


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	193.2647	86.9178	1.5057	3.23	LDFI 001 FRONT
5.575	1186.1895	387.1292	9.2416	14.39	LDFI 001 FRONT
7.883	11455.9355	2215.5207	89.2527	82.37	LDFI 001 FRONT
Sum	12835.3897				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI FRONT 001.rslt\LDFI 002 FRONT.dx		
Nome da amostra:	LDFI 002 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 12:45:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:43:31-03:00		

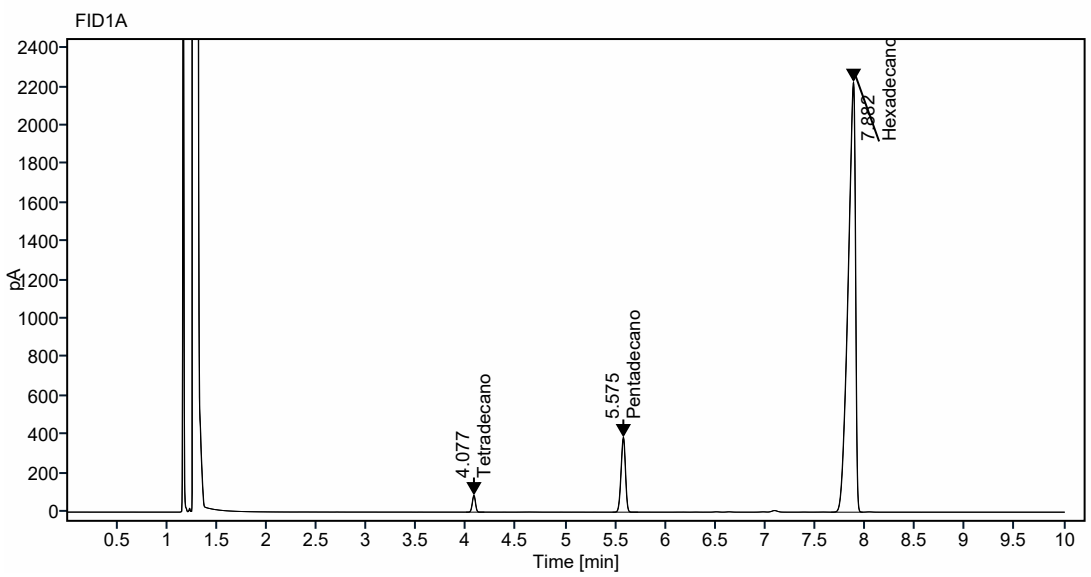


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	193.2683	86.5004	1.5054	3.20	LDFI 002 FRONT
5.575	1186.5491	387.0685	9.2420	14.34	LDFI 002 FRONT
7.882	11458.8655	2225.5006	89.2527	82.45	LDFI 002 FRONT
Sum	12838.6829				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI FRONT 001.rslt\LDFI 003 FRONT.dx		
Nome da amostra:	LDFI 003 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 12:57:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 13:43:31-03:00		

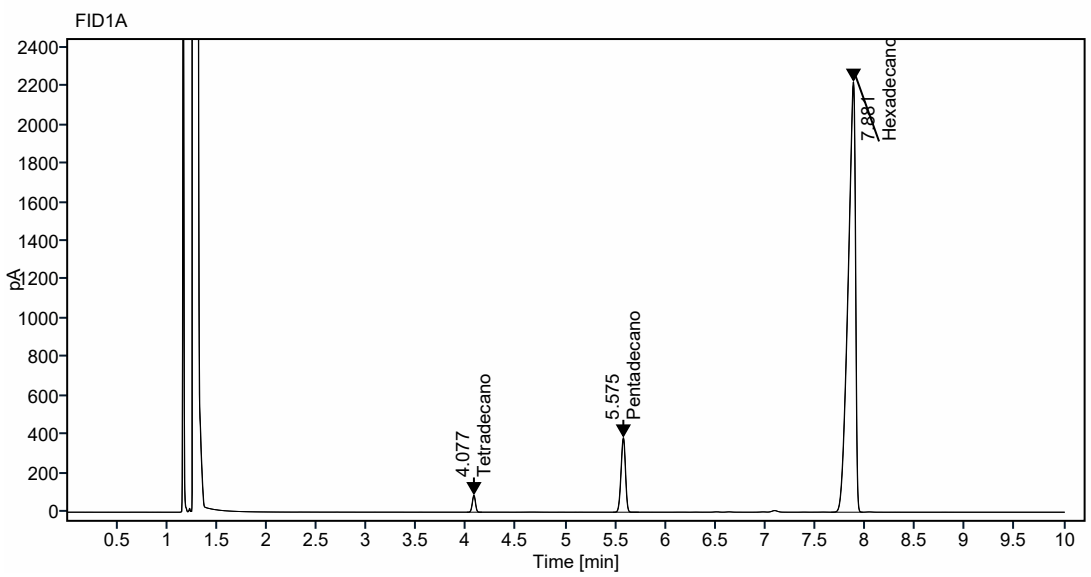


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.077	193.6492	86.7878	1.5061	3.22	LDFI 003 FRONT
5.575	1188.6146	384.5758	9.2442	14.28	LDFI 003 FRONT
7.881	11475.6339	2221.6789	89.2497	82.50	LDFI 003 FRONT
Sum	12857.8977				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	RELB 001.dx\RELB 001.dx		
Nome da amostra:	RELB 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	
Data da Injeção:	2025-02-17 13:47:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0.000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:			

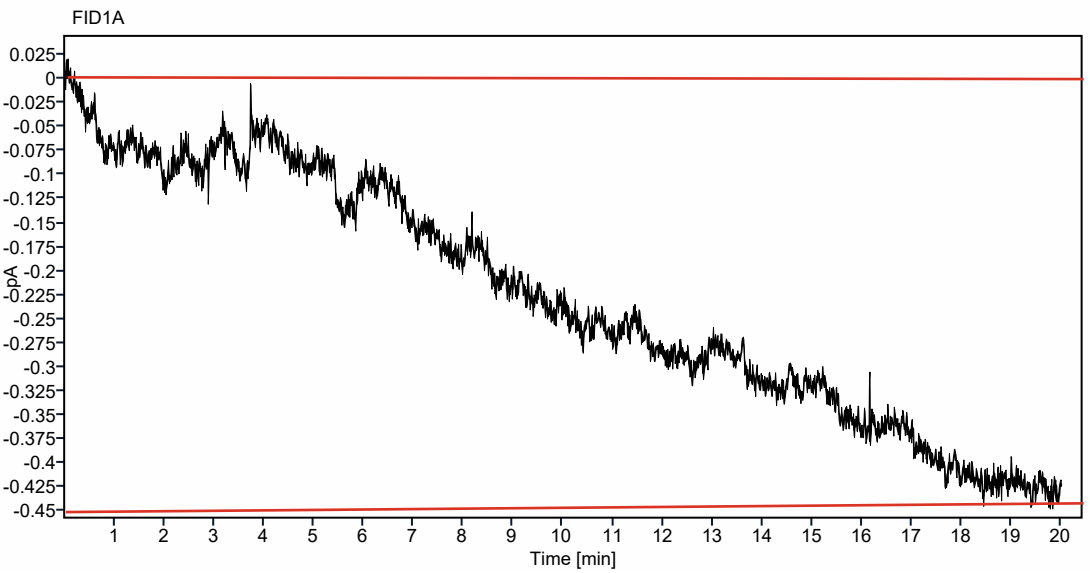


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	RELB 001.dx\RELB 001.dx		
Nome da amostra:	RELB 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	
Data da Injeção:	2025-02-17 13:47:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0.000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:			

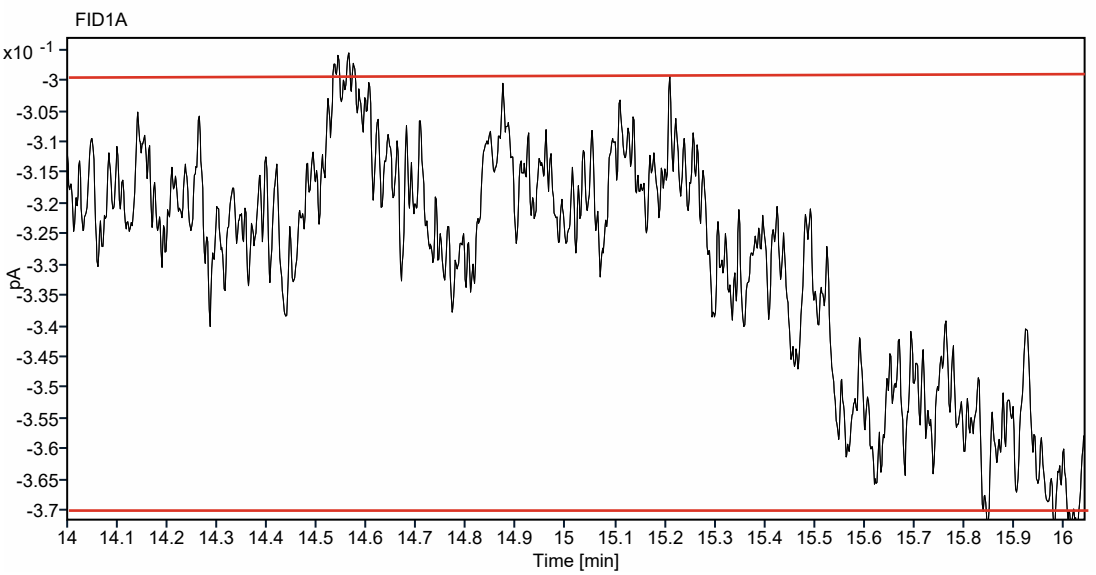


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\Branco PCIN 001 BACK.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 001 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	601
Data da Injeção:	2025-02-17 14:43:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:29:29-03:00		

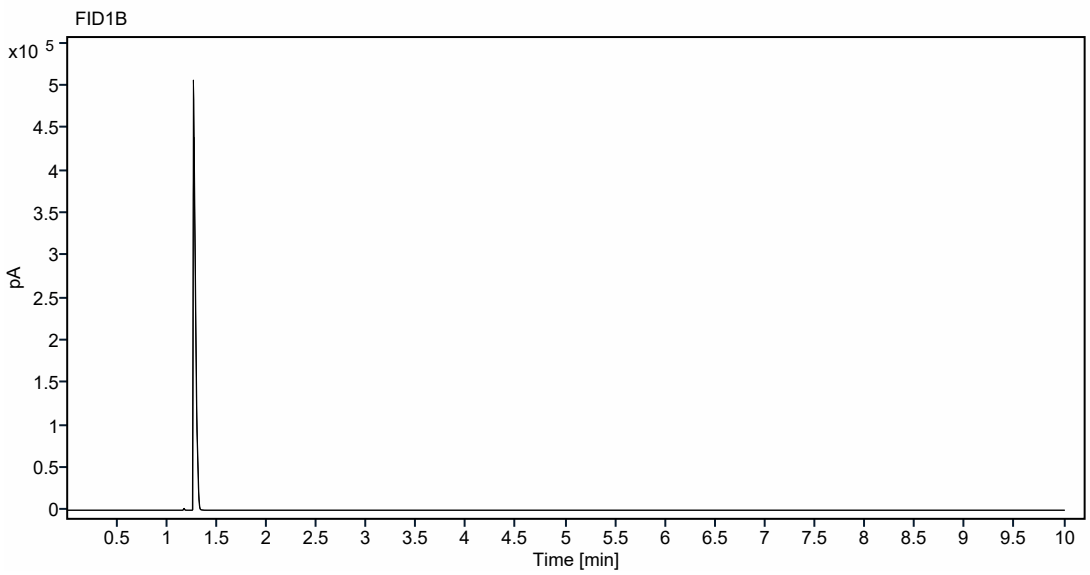

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 001 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 001 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 14:54:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

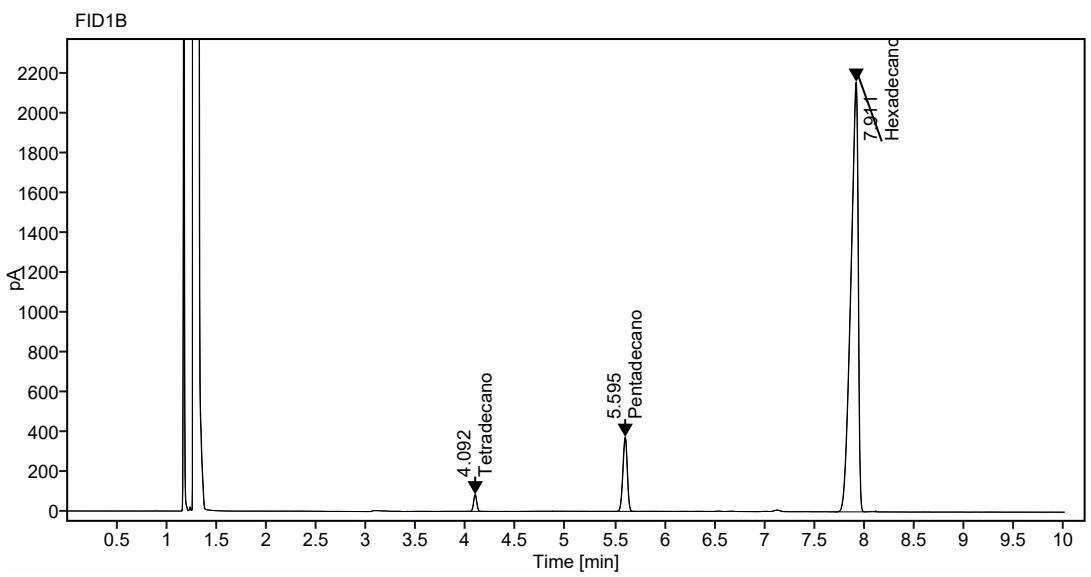


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	187.6497	84.8927	1.5065	3.23	PCIN 001 BACK
5.595	1151.0416	374.8122	9.2408	14.27	PCIN 001 BACK
7.911	11117.3710	2167.1180	89.2527	82.50	PCIN 001 BACK
Sum	12456.0623				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 002 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 002 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 15:06:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

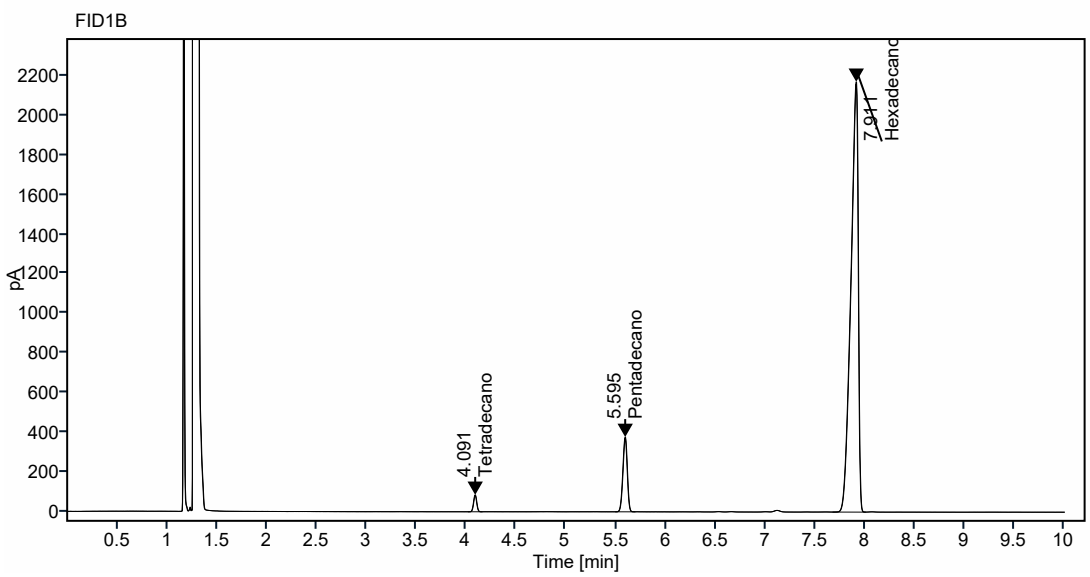


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.091	187.6972	85.3777	1.4980	3.24	PCIN 002 BACK
5.595	1156.7758	378.0308	9.2322	14.33	PCIN 002 BACK
7.911	11185.3245	2174.2004	89.2698	82.43	PCIN 002 BACK
Sum	12529.7975				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 003 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 003 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 15:17:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

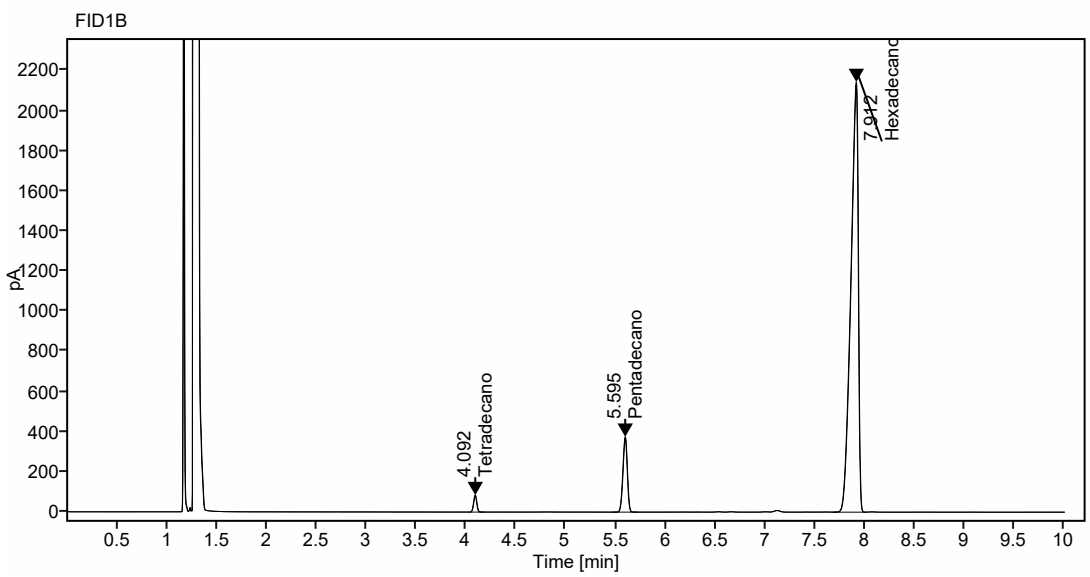


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	186.7569	84.3925	1.5030	3.24	PCIN 003 BACK
5.595	1146.8567	375.9495	9.2298	14.42	PCIN 003 BACK
7.912	11091.9352	2146.2523	89.2672	82.34	PCIN 003 BACK
Sum	12425.5488				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\Branco PCIN 002 BACK.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 002 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	601
Data da Injeção:	2025-02-17 15:28:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:29:29-03:00		

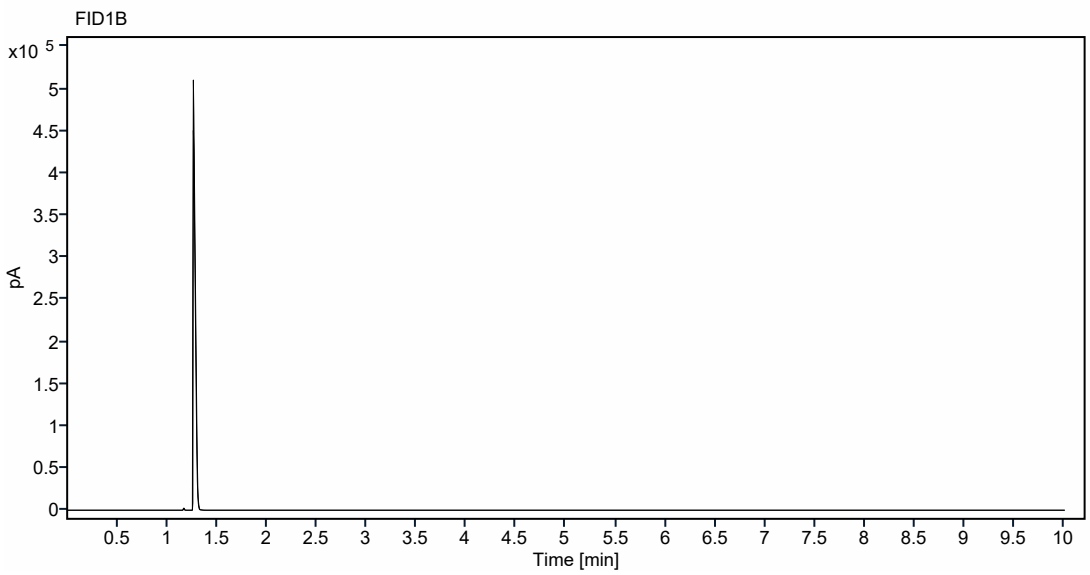

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 004 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 004 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 15:40:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

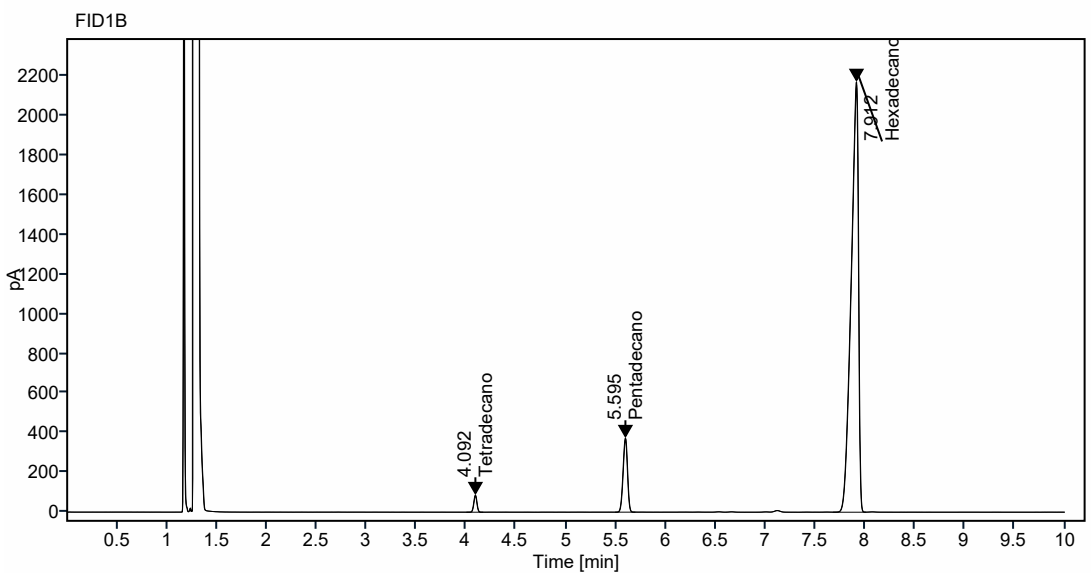


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	187.2809	85.8464	1.5045	3.26	PCIN 004 BACK
5.595	1148.9061	373.4045	9.2299	14.19	PCIN 004 BACK
7.912	11111.4736	2171.6864	89.2656	82.54	PCIN 004 BACK
Sum	12447.6605				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 005 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 005 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 15:53:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

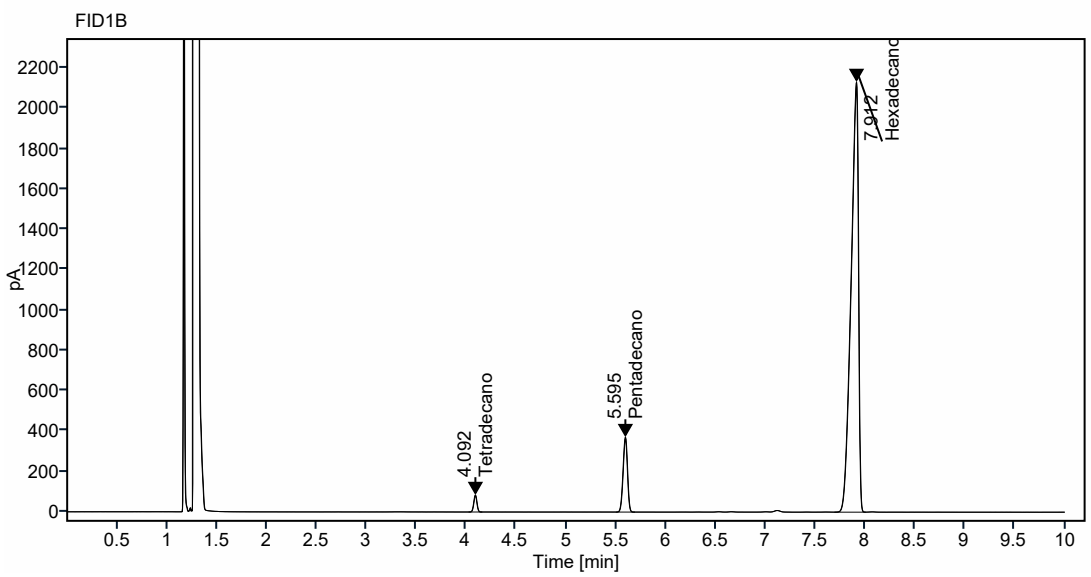


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	184.6882	83.7906	1.4987	3.24	PCIN 005 BACK
5.595	1136.0948	371.2352	9.2191	14.35	PCIN 005 BACK
7.912	11002.5285	2132.5790	89.2822	82.42	PCIN 005 BACK
Sum	12323.3116				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\PCIN 006 BACK.dx		
Nome da amostra:	PCIN 006 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 16:04:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:36:36-03:00		

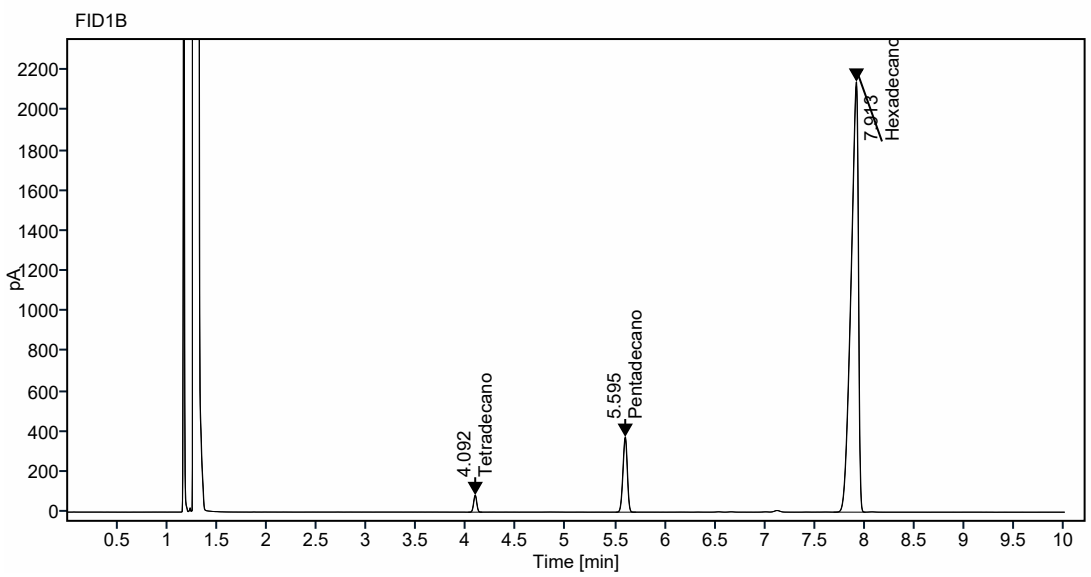


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	186.4995	84.6535	1.5102	3.25	PCIN 006 BACK
5.595	1138.9947	374.5755	9.2233	14.39	PCIN 006 BACK
7.913	11023.6464	2143.2081	89.2665	82.35	PCIN 006 BACK
Sum	12349.1406				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCIN BACK 002.rslt\Branco PCIN 003 BACK.dx		
Nome da amostra:	Branco PCIN 003 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	601
Data da Injeção:	2025-02-17 16:15:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 16:29:29-03:00		

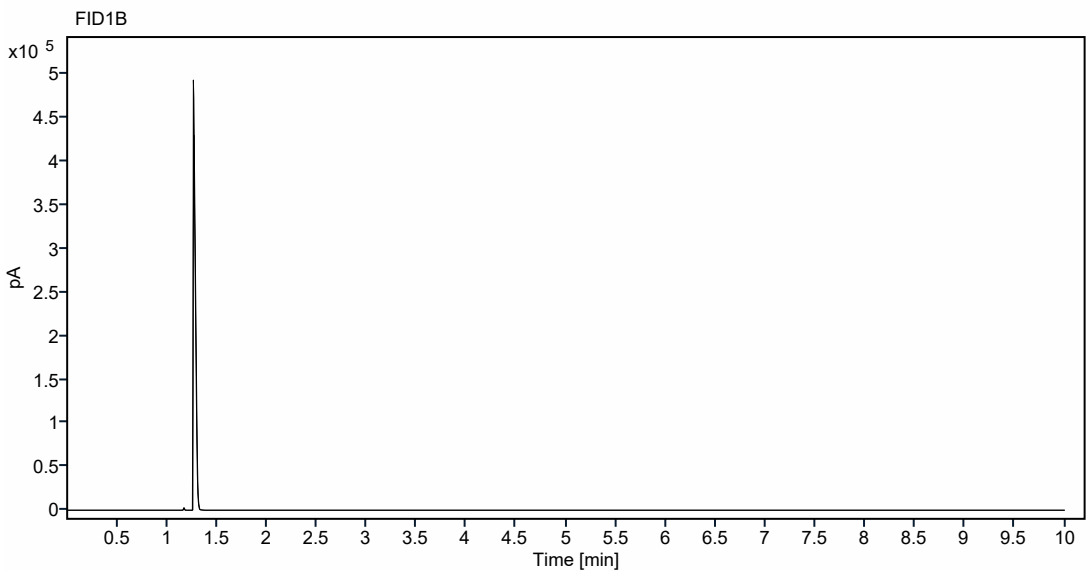

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI BACK 001.rslt\LDFI 001 BACK.dx		
Nome da amostra:	LDFI 001 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 16:29:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 17:05:01-03:00		

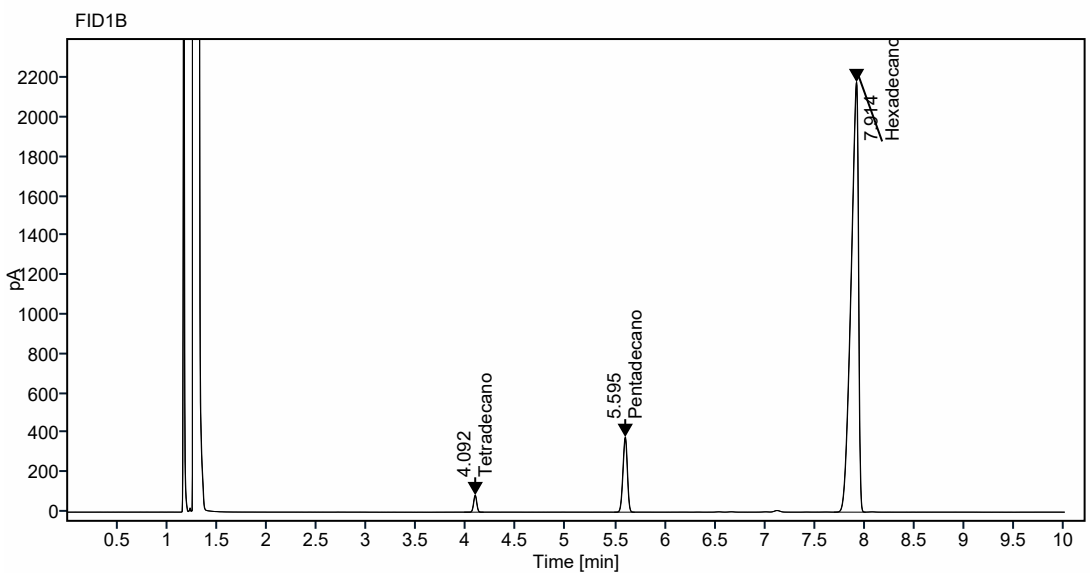


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	191.1319	85.8132	1.5102	3.24	LDFI 001 BACK
5.595	1168.3875	380.5221	9.2321	14.39	LDFI 001 BACK
7.914	11296.2481	2178.4361	89.2577	82.37	LDFI 001 BACK
Sum	12655.7675				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI BACK 001.rslt\LDFI 002 BACK.dx		
Nome da amostra:	LDFI 002 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 16:40:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 17:05:01-03:00		

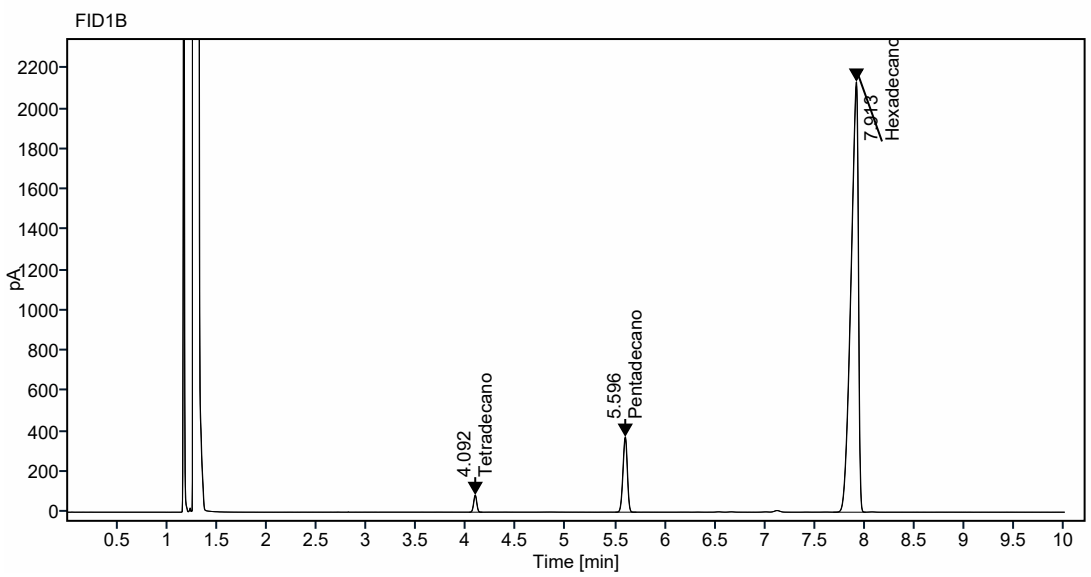


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.092	185.4295	84.7460	1.5028	3.27	LDFI 002 BACK
5.596	1138.9239	373.1341	9.2300	14.40	LDFI 002 BACK
7.913	11014.9650	2133.8402	89.2672	82.33	LDFI 002 BACK
Sum	12339.3184				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LDFI BACK 001.rslt\LDFI 003 BACK.dx		
Nome da amostra:	LDFI 003 BACK		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	602
Data da Injeção:	2025-02-17 16:51:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	1.000
Método de análise:	*Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-17 17:05:01-03:00		

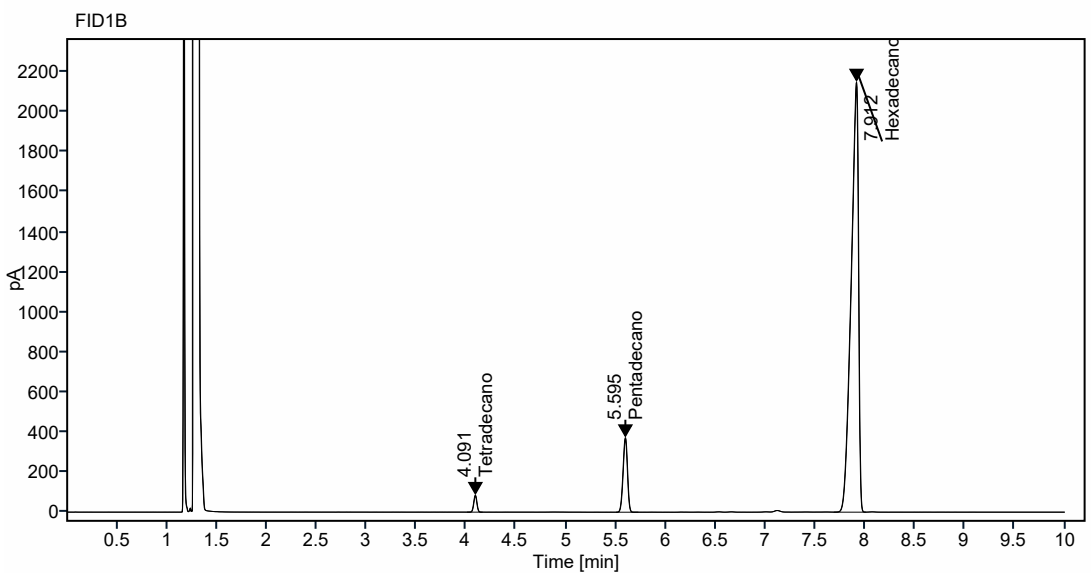


Signal: FID1B

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
4.091	186.1858	84.5839	1.5020	3.24	LDFI 003 BACK
5.595	1142.9703	372.9210	9.2207	14.29	LDFI 003 BACK
7.912	11066.5577	2151.7980	89.2773	82.47	LDFI 003 BACK
Sum	12395.7138				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\RELB BACK 001.sirslt\RELB BACK 001.dx		
Nome da amostra:	RELB BACK 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	
Data da Injeção:	2025-02-17 17:03:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0.000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 08:34:04-03:00		

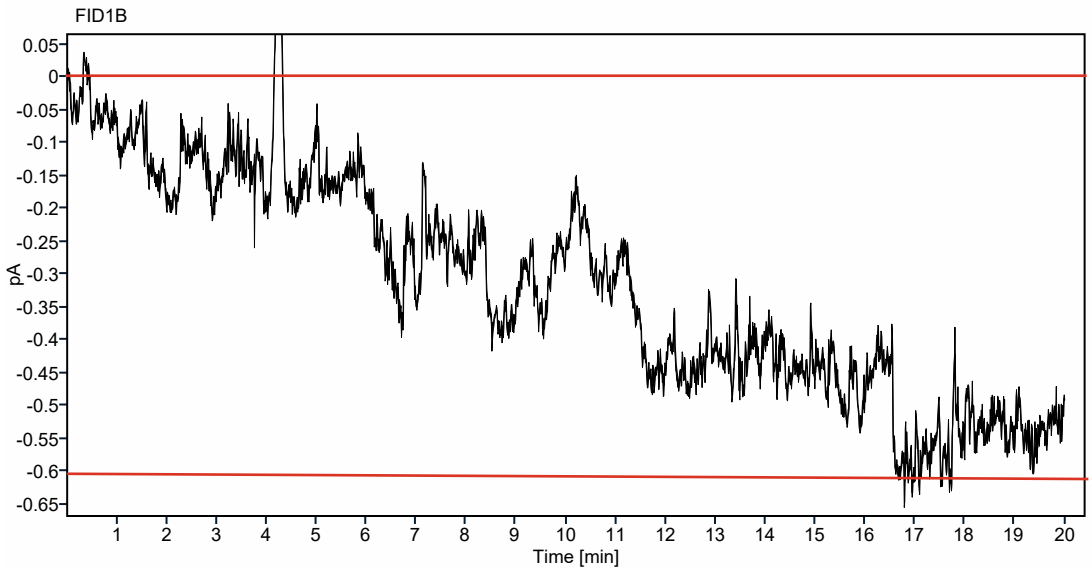


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\RELB BACK 001.sirslt\RELB BACK 001.dx		
Nome da amostra:	RELB BACK 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04	**Localização:**	
Data da Injeção:	2025-02-17 17:03:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0.000
Método de análise:	GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2023-06-27 08:34:04-03:00		

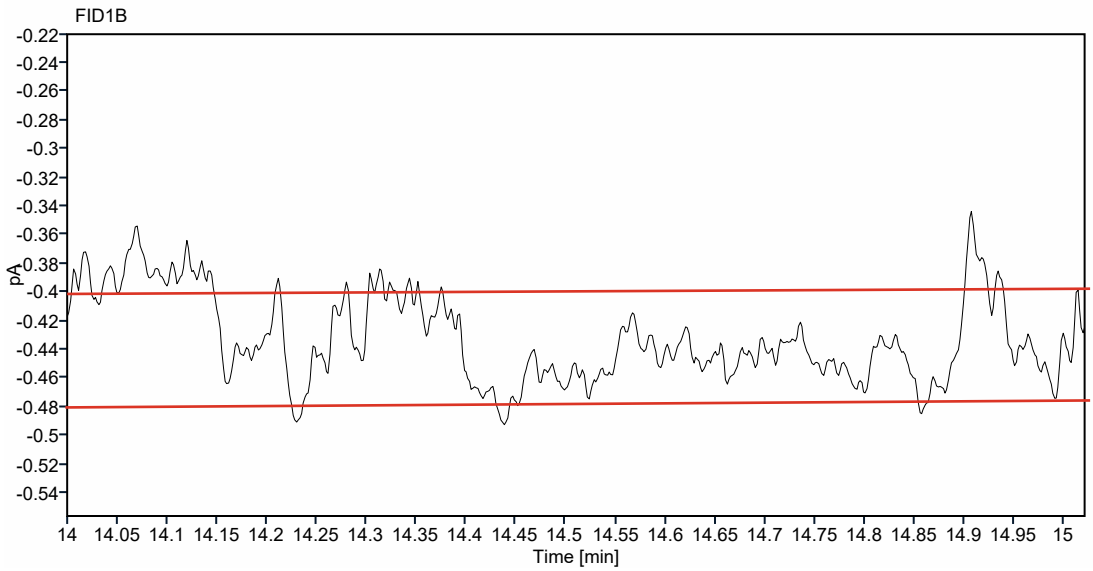


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\Branco PCHS 001.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	101
Data da Injeção:	2025-02-14 14:14:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

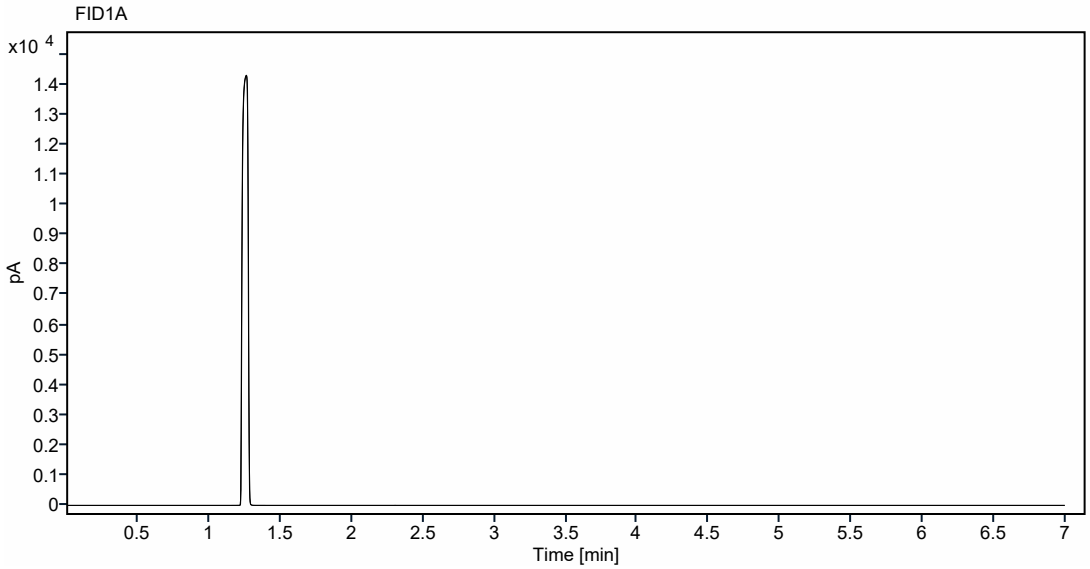

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 001.dx		
Nome da amostra:	PCHS 001		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	102
Data da Injeção:	2025-02-14 14:22:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

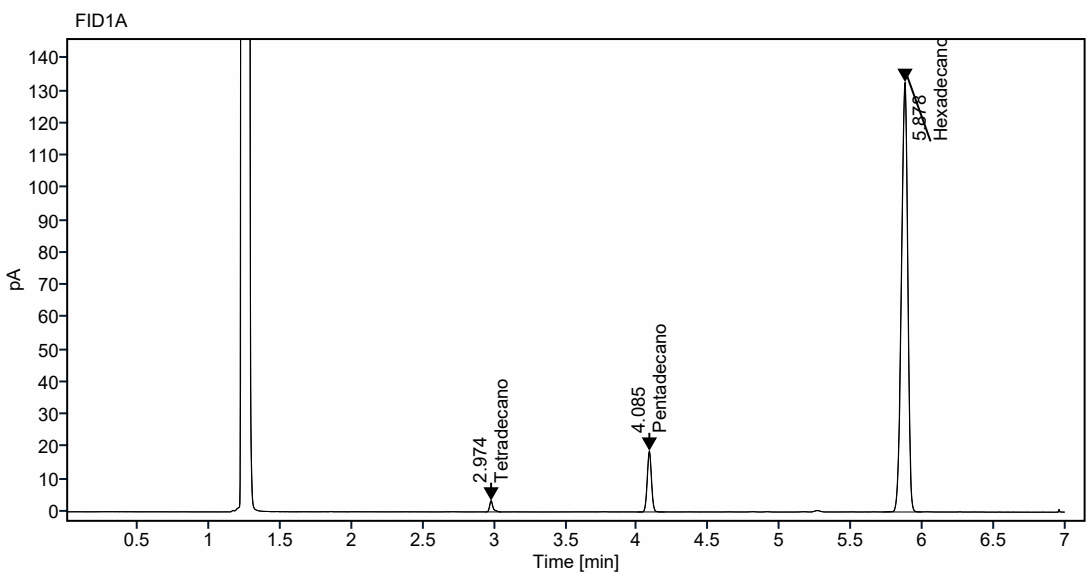


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.974	5.8110	3.5005	1.2771	2.26	PCHS 001
4.085	38.7209	18.9036	8.5096	12.18	PCHS 001
5.878	410.4957	132.7803	90.2134	85.56	PCHS 001
Sum	455.0276				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 002.dx		
Nome da amostra:	PCHS 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	103
Data da Injeção:	2025-02-14 14:30:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

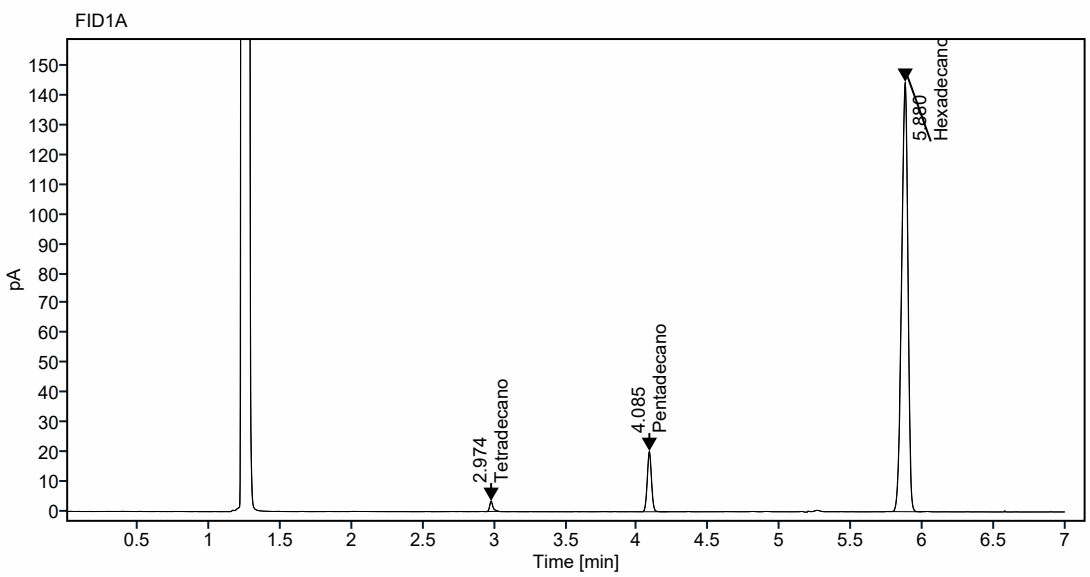


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.974	5.7424	3.5497	1.1602	2.10	PCHS 002
4.085	41.8100	20.4771	8.4472	12.12	PCHS 002
5.880	447.4026	144.8969	90.3926	85.78	PCHS 002
Sum	494.9551				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 003.dx		
Nome da amostra:	PCHS 003		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	104
Data da Injeção:	2025-02-14 14:38:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

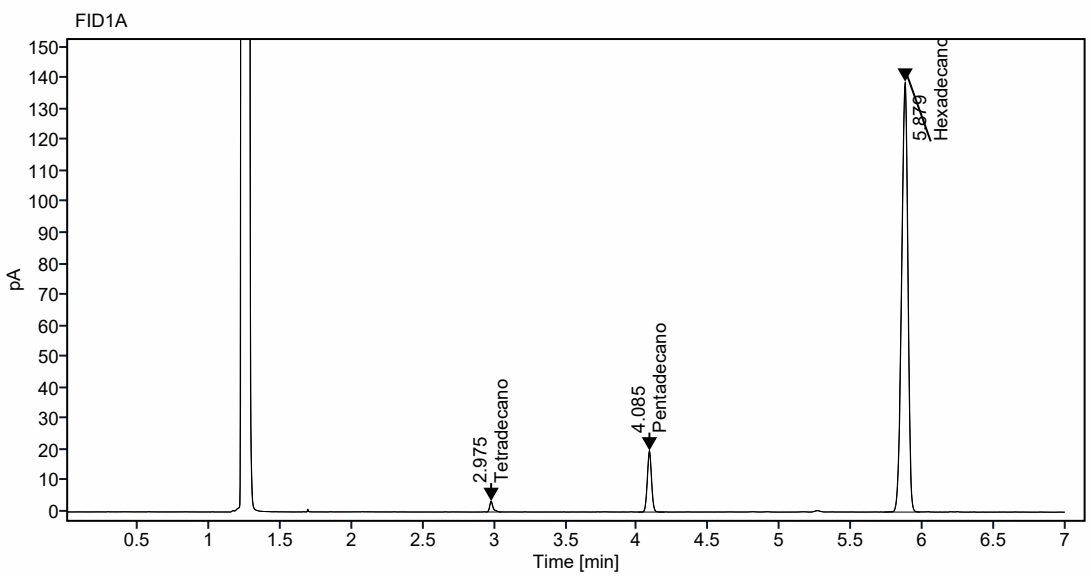


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.975	5.9453	3.5359	1.2551	2.18	PCHS 003
4.085	40.5772	19.8768	8.5664	12.24	PCHS 003
5.879	427.1559	138.9507	90.1785	85.58	PCHS 003
Sum	473.6784				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\Branco PCHS 002.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 002		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	105
Data da Injeção:	2025-02-14 14:45:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

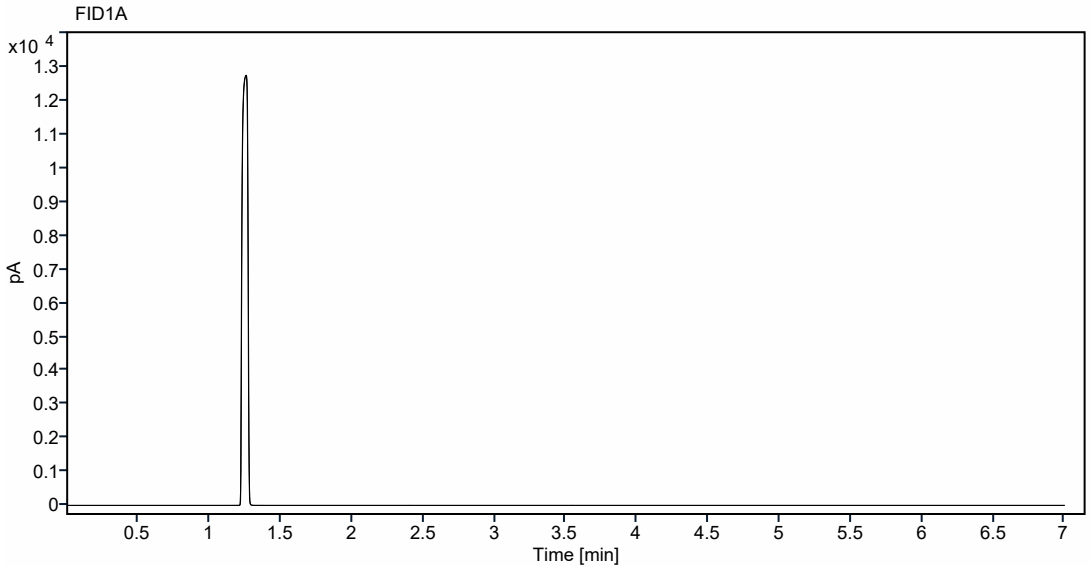

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 004.dx		
Nome da amostra:	PCHS 004		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	106
Data da Injeção:	2025-02-14 14:53:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

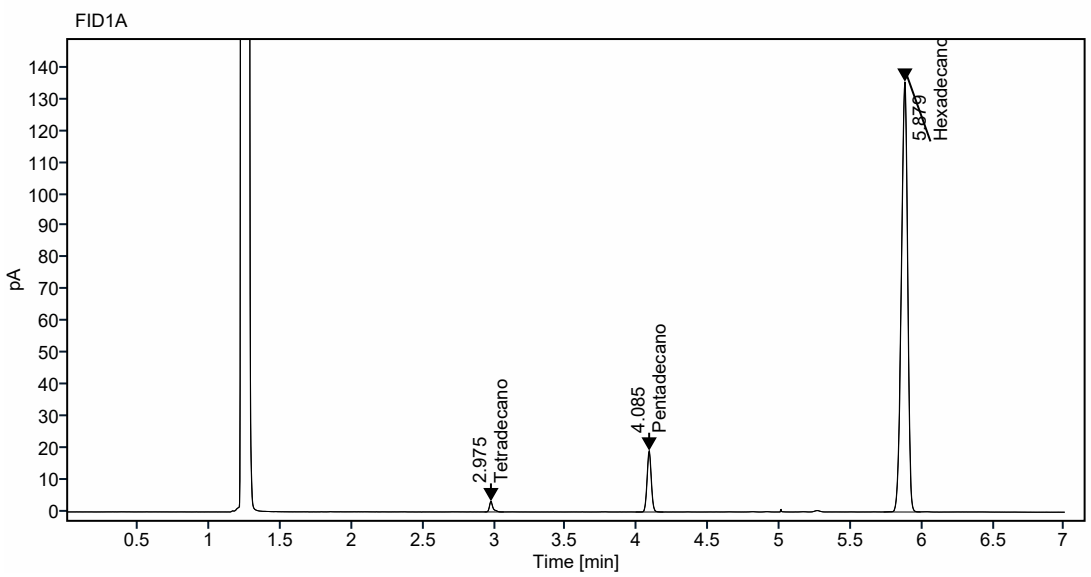


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.975	5.7714	3.3511	1.2476	2.12	PCHS 004
4.085	39.4861	19.3215	8.5355	12.22	PCHS 004
5.879	417.3513	135.4938	90.2169	85.67	PCHS 004
Sum	462.6088				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 005.dx		
Nome da amostra:	PCHS 005		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	107
Data da Injeção:	2025-02-14 15:01:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

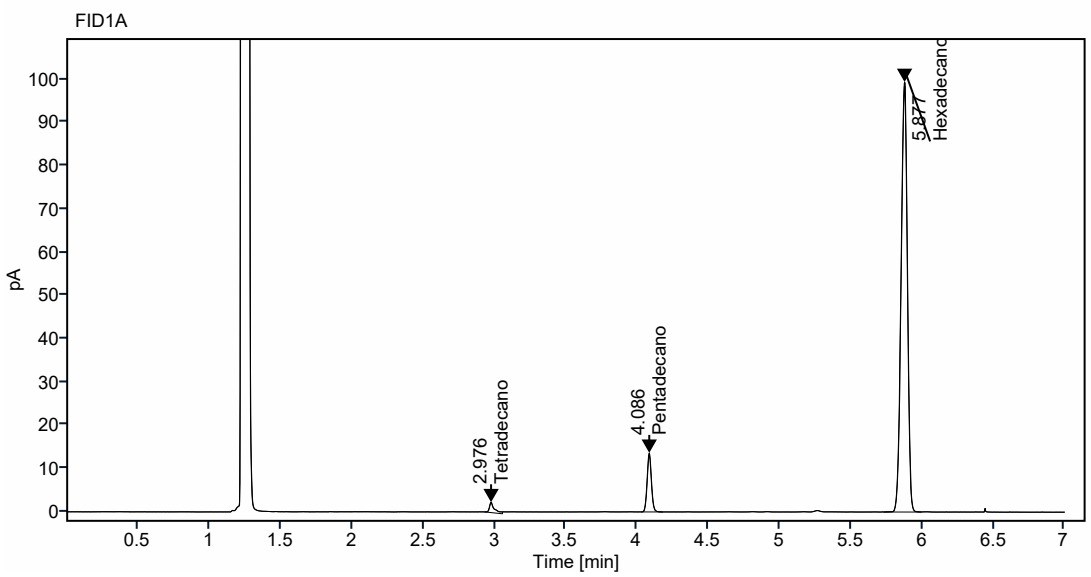


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.976	5.8800	2.3952	1.7310	2.08	PCHS 005
4.086	28.1887	13.6574	8.2983	11.84	PCHS 005
5.877	305.6253	99.3296	89.9707	86.09	PCHS 005
Sum	339.6940				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\PCHS 006.dx		
Nome da amostra:	PCHS 006		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	108
Data da Injeção:	2025-02-14 15:09:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

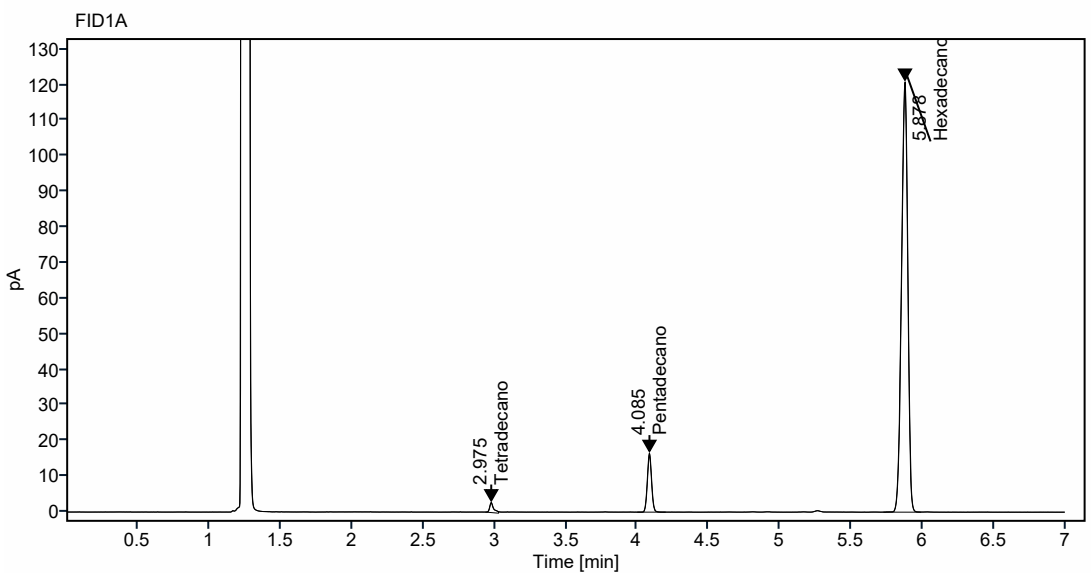


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.975	5.6448	2.8427	1.3729	2.03	PCHS 006
4.085	34.0546	16.6114	8.2828	11.83	PCHS 006
5.878	371.4493	120.9237	90.3443	86.14	PCHS 006
Sum	411.1488				


LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\PCHS 001.rslt\Branco PCHS 003.dx		
Nome da amostra:	Branco PCHS 003		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	109
Data da Injeção:	2025-02-14 15:17:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:47:50-03:00		

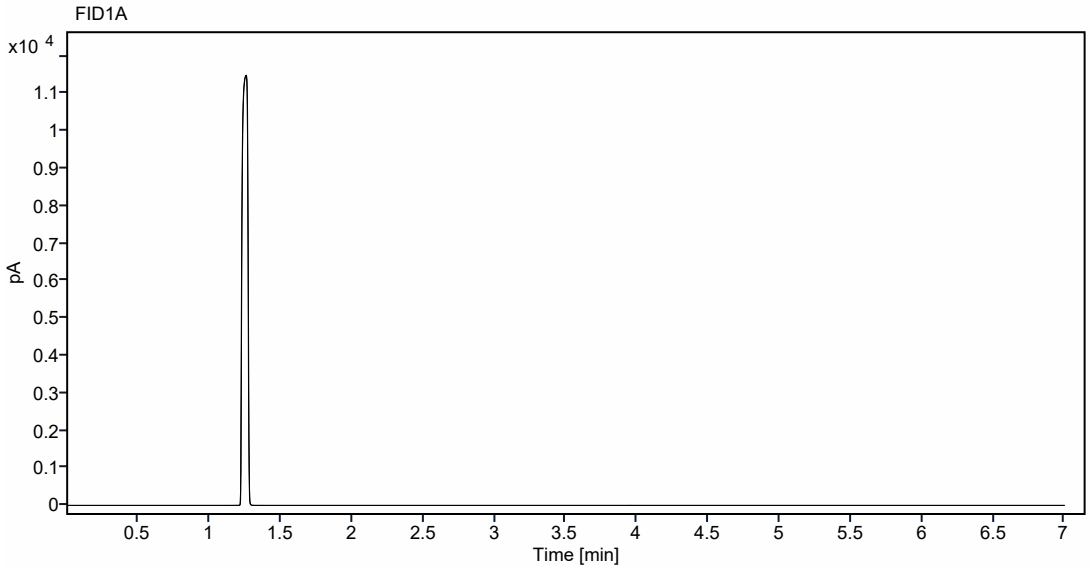

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LIHS 001.rslt\LIHS 01.dx		
Nome da amostra:	LIHS 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	110
Data da Injeção:	2025-02-14 16:00:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:32:30-03:00		

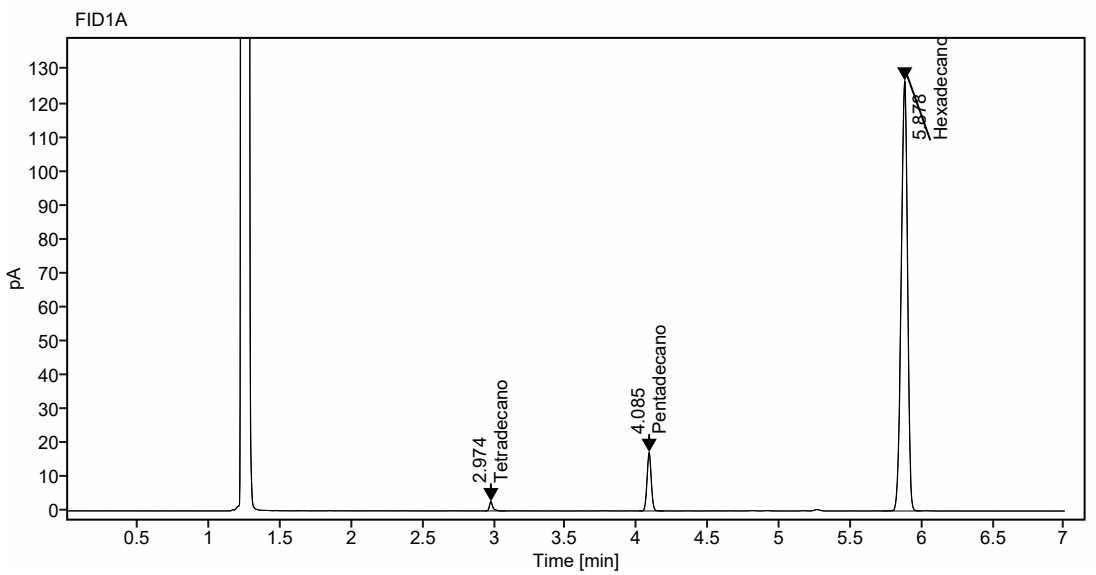


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.974	4.6777	2.8162	1.0824	1.92	LIHS 01
4.085	35.4310	17.3551	8.1985	11.81	LIHS 01
5.878	392.0571	126.8040	90.7191	86.28	LIHS 01
Sum	432.1658				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LIHS 001.rslt\LIHS 02.dx		
Nome da amostra:	LIHS 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	111
Data da Injeção:	2025-02-14 16:09:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:32:30-03:00		

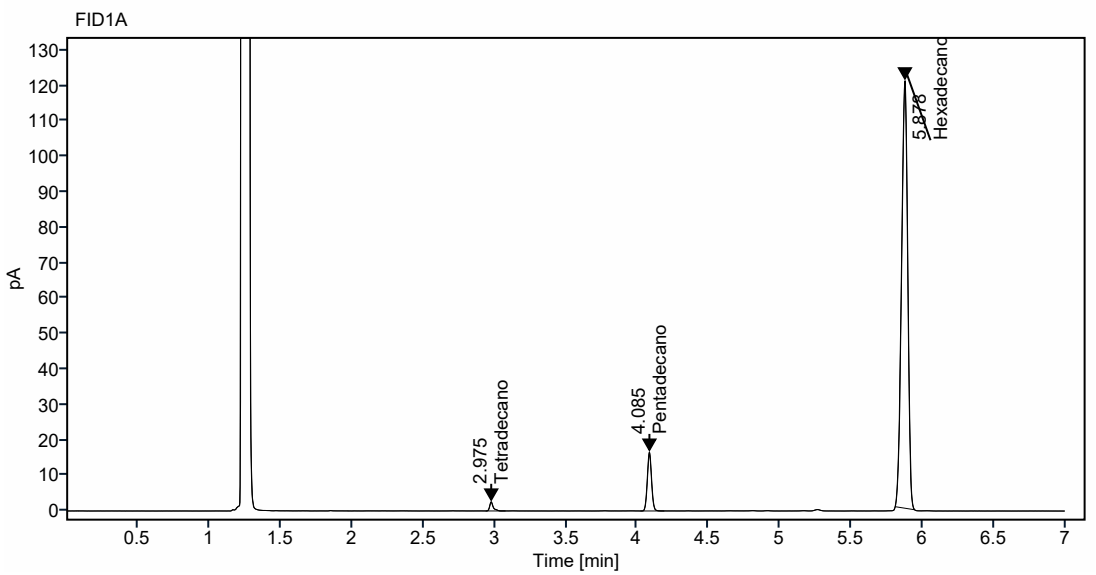


Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.975	4.5503	2.6090	1.1245	1.86	LIHS 02
4.085	34.1606	16.6895	8.4420	11.92	LIHS 02
5.878	365.9380	120.6864	90.4335	86.21	LIHS 02
Sum	404.6489				

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA
CRG 04

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Teste\Results\Qualificação 2025\LIHS 001.rslt\LIHS 03.dx		
Nome da amostra:	LIHS 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0.000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	CRG 04 HS	**Localização:**	112
Data da Injeção:	2025-02-14 16:17:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação HS.amx	**Volume de Injeção:**	500.000
Método de análise:	Padrão Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-14 15:32:30-03:00		

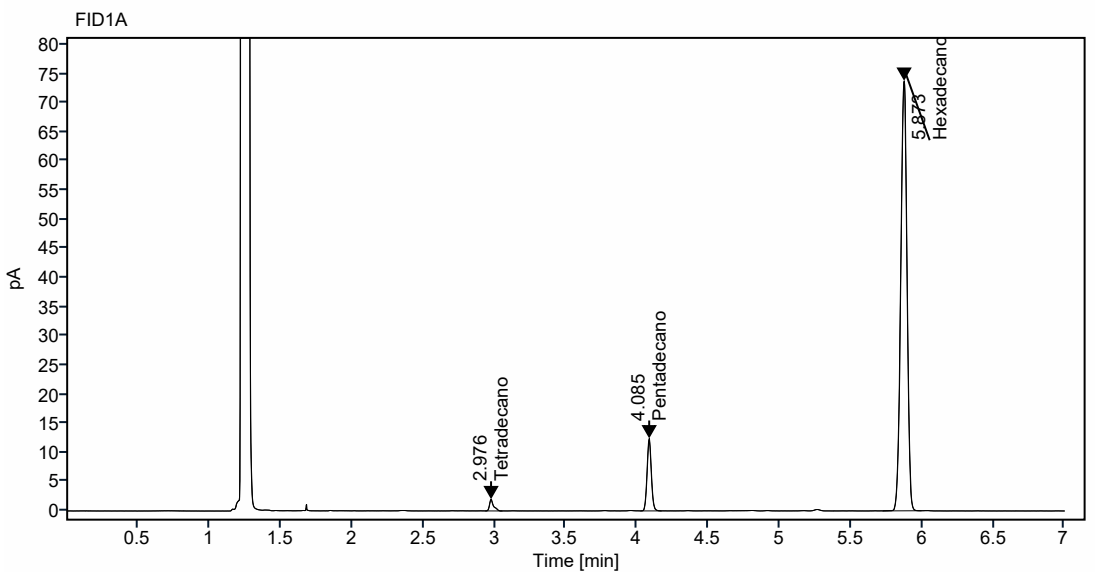

Signal: FID1A

RT [min]	Area	Height	Area%	Height %	Name
2.976	3.9618	2.0096	1.5499	2.28	LIHS 03
4.085	25.7134	12.4364	10.0595	14.10	LIHS 03
5.873	225.9379	73.7659	88.3906	83.62	LIHS 03
Sum	255.6131				