
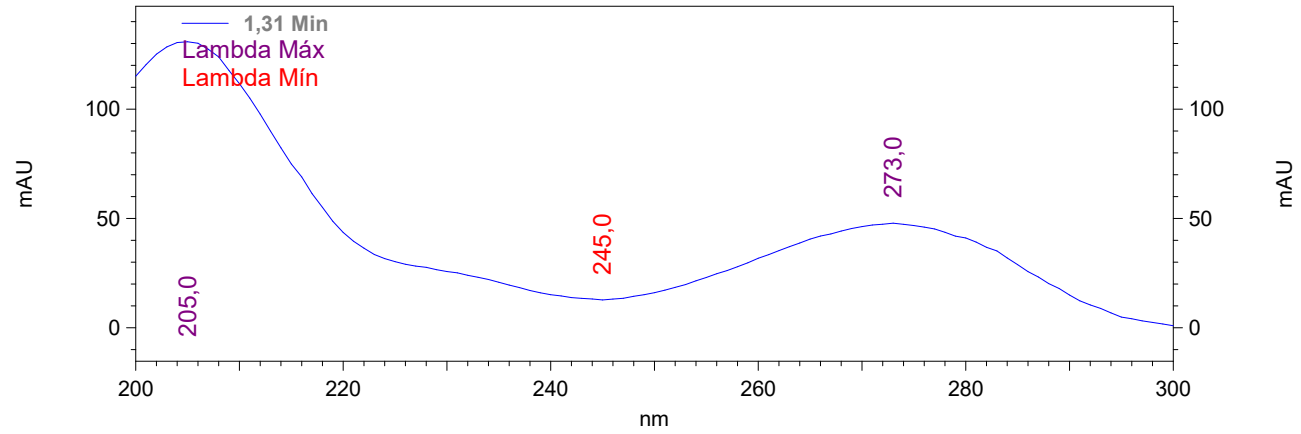


C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-0

Relatório de Normalização

Método: **C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **10/02/2023 11:31:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/02/2023 10:40:17 (GMT -03:00)**

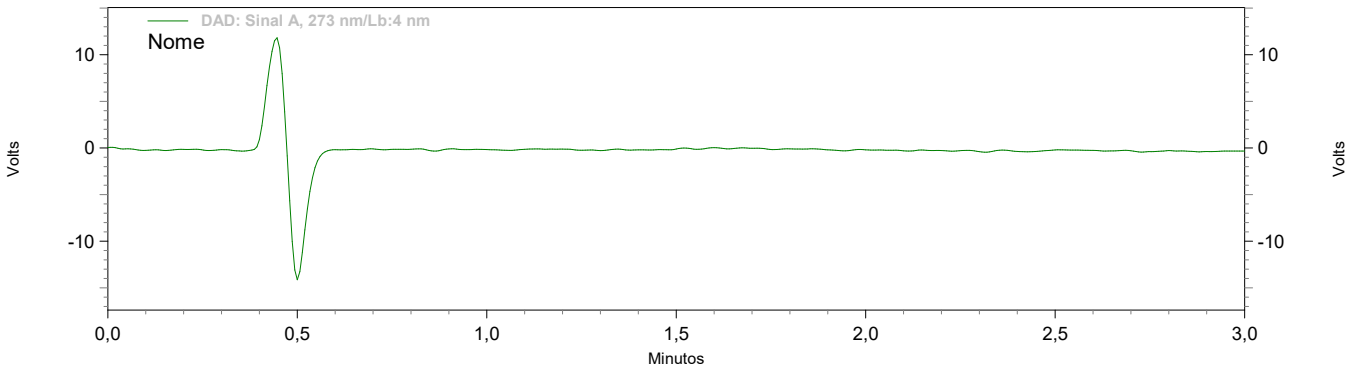


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/02/2023 11:35:37 (GMT -03:00)
Impresso: 23/02/2023 10:40:32 (GMT -03:00)

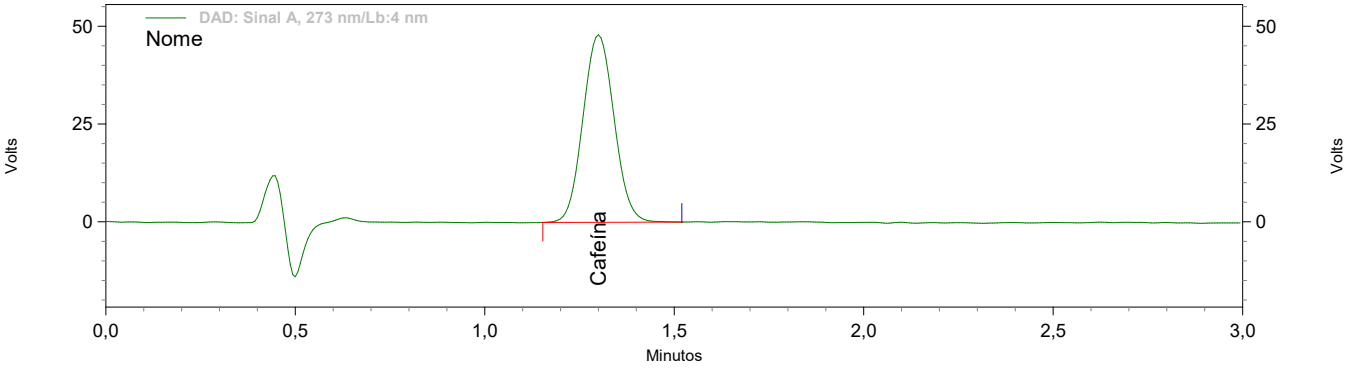


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,300	574194	**0,000**
Totais			574194	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/02/2023 11:39:35 (GMT -03:00)
Impresso: 23/02/2023 10:40:49 (GMT -03:00)

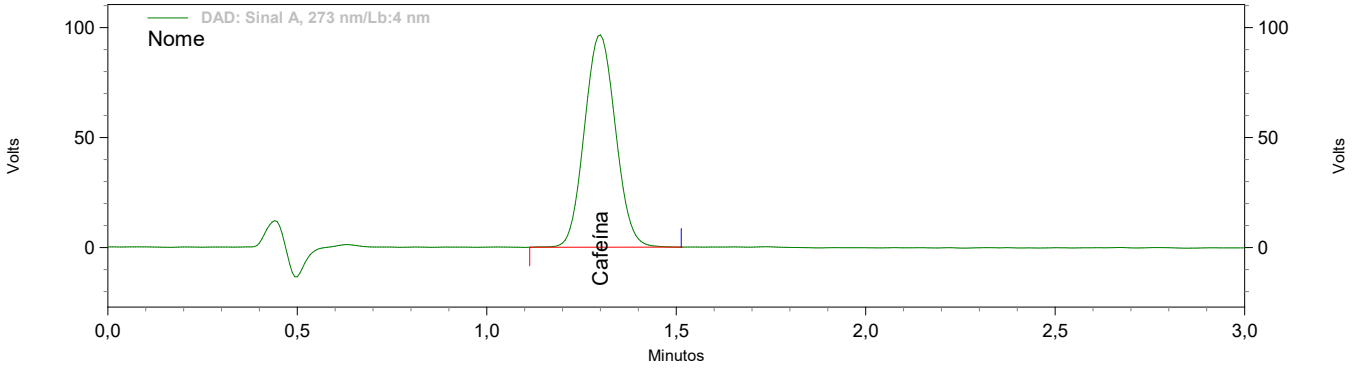


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,300	1155249	**0,000**
Totais			1155249	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/02/2023 11:43:31 (GMT -03:00)
Impresso: 23/02/2023 10:41:01 (GMT -03:00)

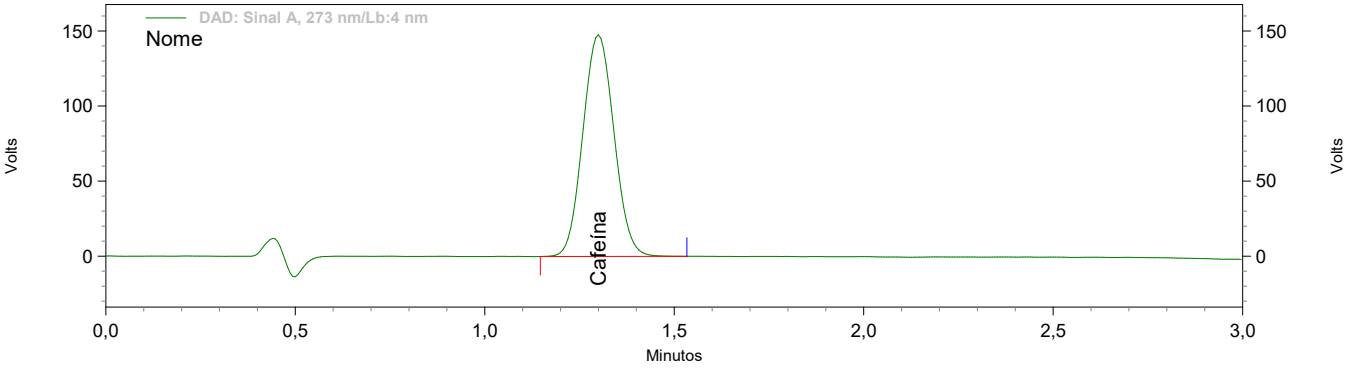


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,300	1766574	**0,000**
Totais			1766574	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Zoetis\Openlab\Result\Qualificação Detector.seq2023-02-10 11-26-31 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 10/02/2023 11:47:28 (GMT -03:00)
Impresso: 23/02/2023 10:41:12 (GMT -03:00)

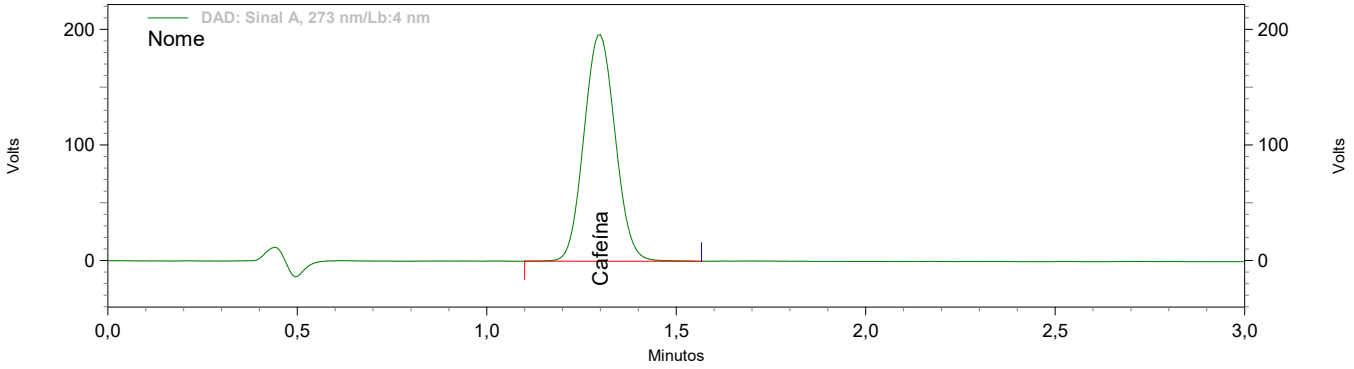

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,300	2362480	**0,000**
Totais			2362480	**0,000**