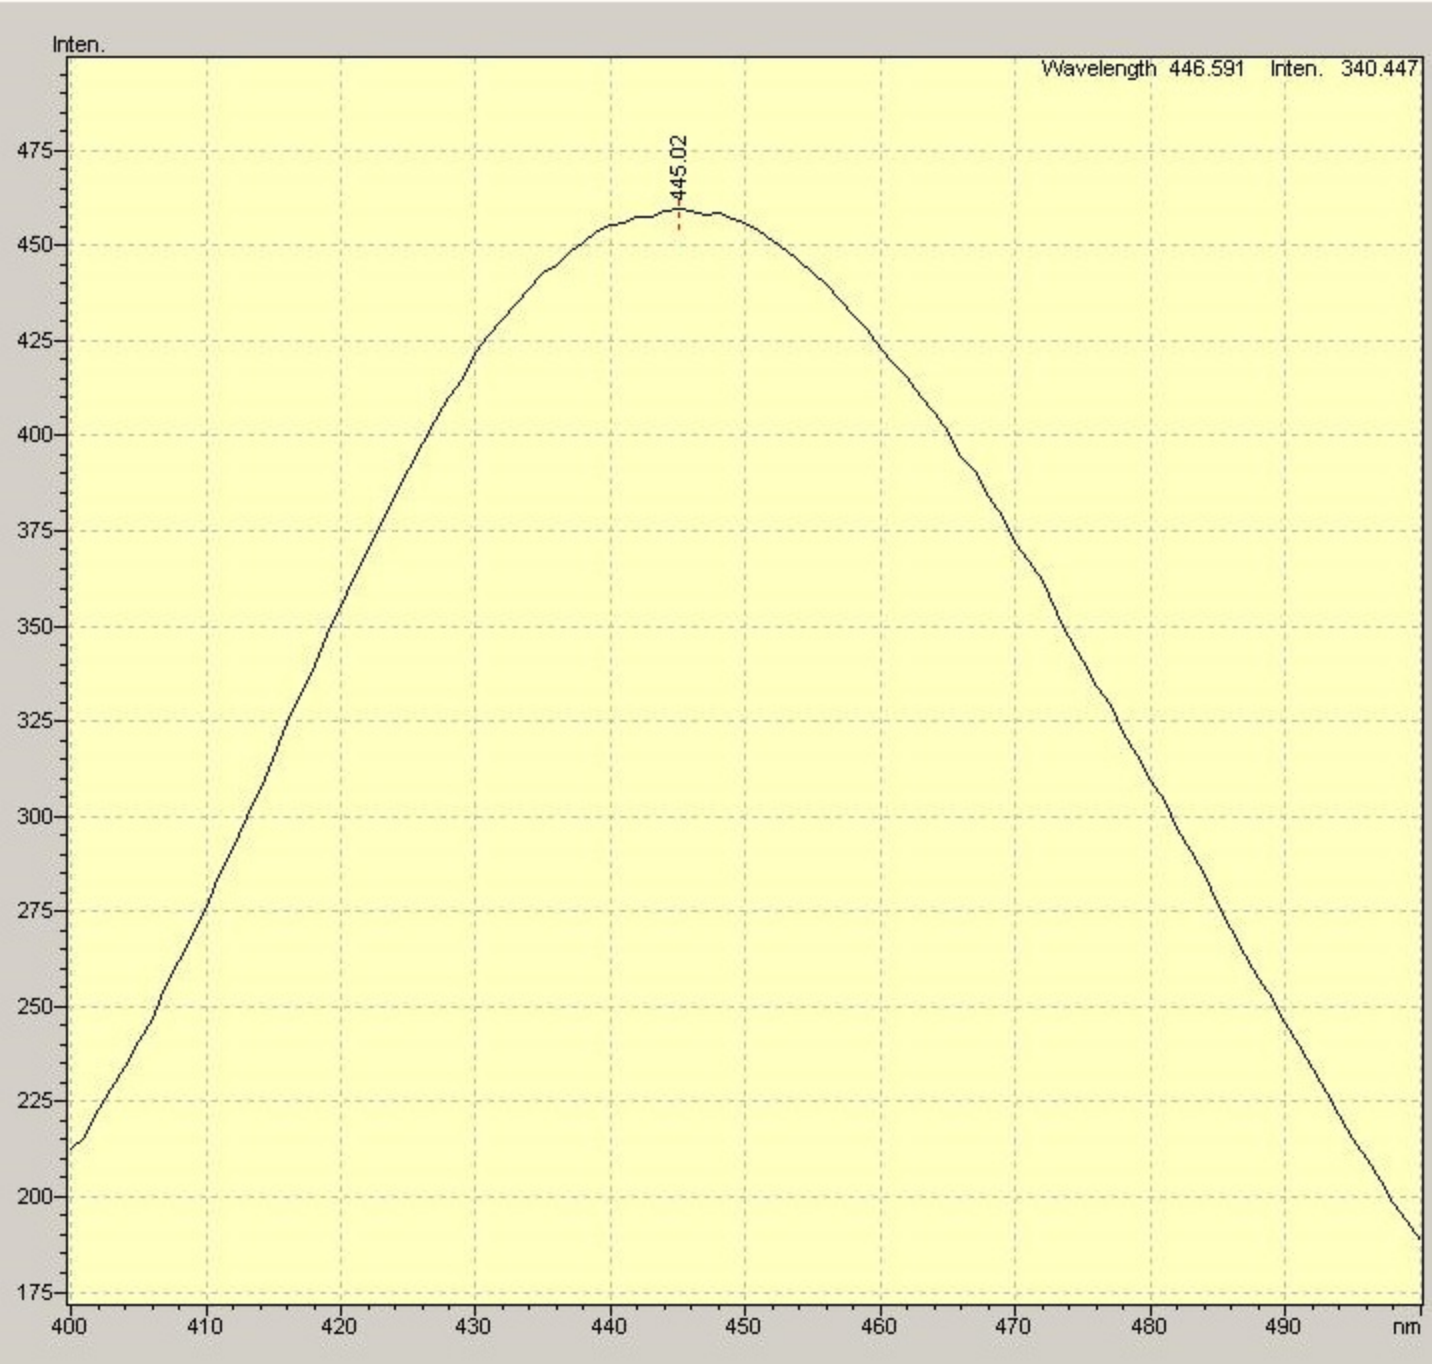

Inten.
Wavelength 446.591 Inten. 340.447
445.02
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
nm


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: LDFL 1.lcd**
Volume Injetado	**: 10 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação FL.lcm**
Batch Filename	**: LDFL.lcb**
Data da Analise	**: 25/5/2018 09:27:41**
Data do processamento	**:25/5/2018 09:27:41**

Chromatogram

LDFL 1 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDFL 1.lcd

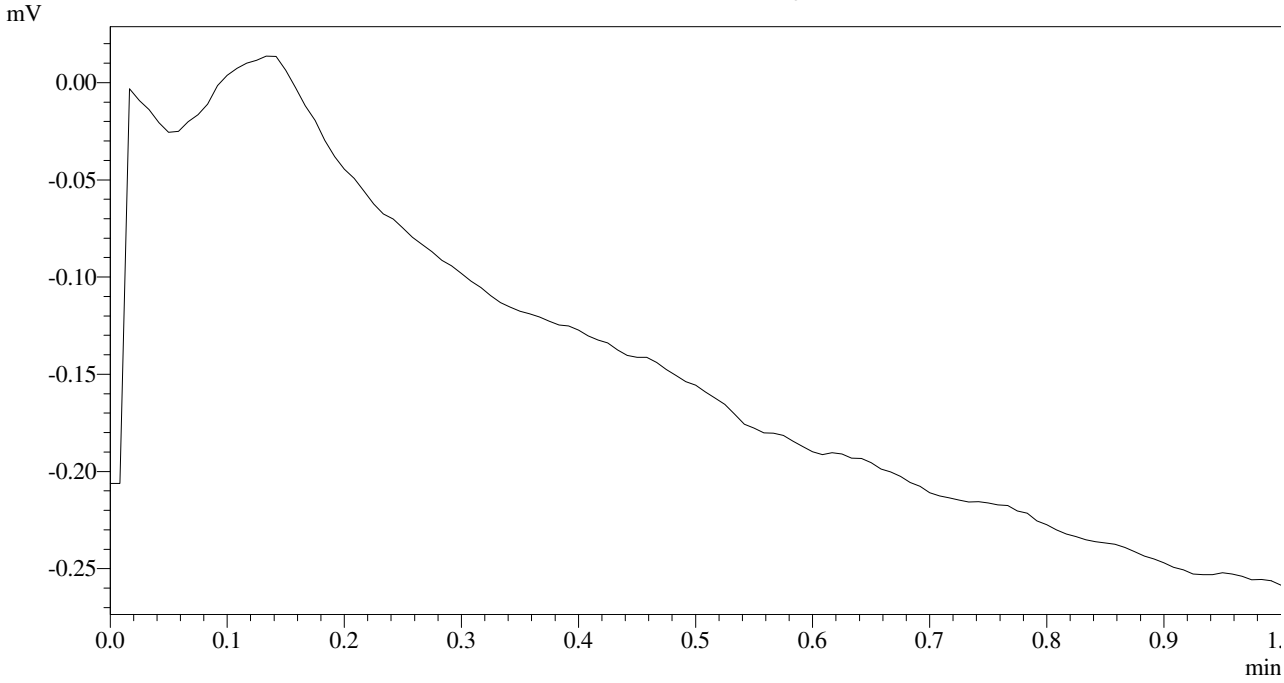

1 Det.A Ch1 / 350nm - 450nm

PeakTable

Detector A Ch1 350nm - 450nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDFL 2.lcd

Volume Injetado : 10 uL

Tray# : 1

Vail# : 2

Método Utilizado : Qualificação FL.lcm


Batch Filename : LDFL.lcb

Data da Analise : 25/5/2018 09:29:10

Data do processamento :25/5/2018 09:29:10

Chromatogram

LDFL 2 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDFL 2.lcd

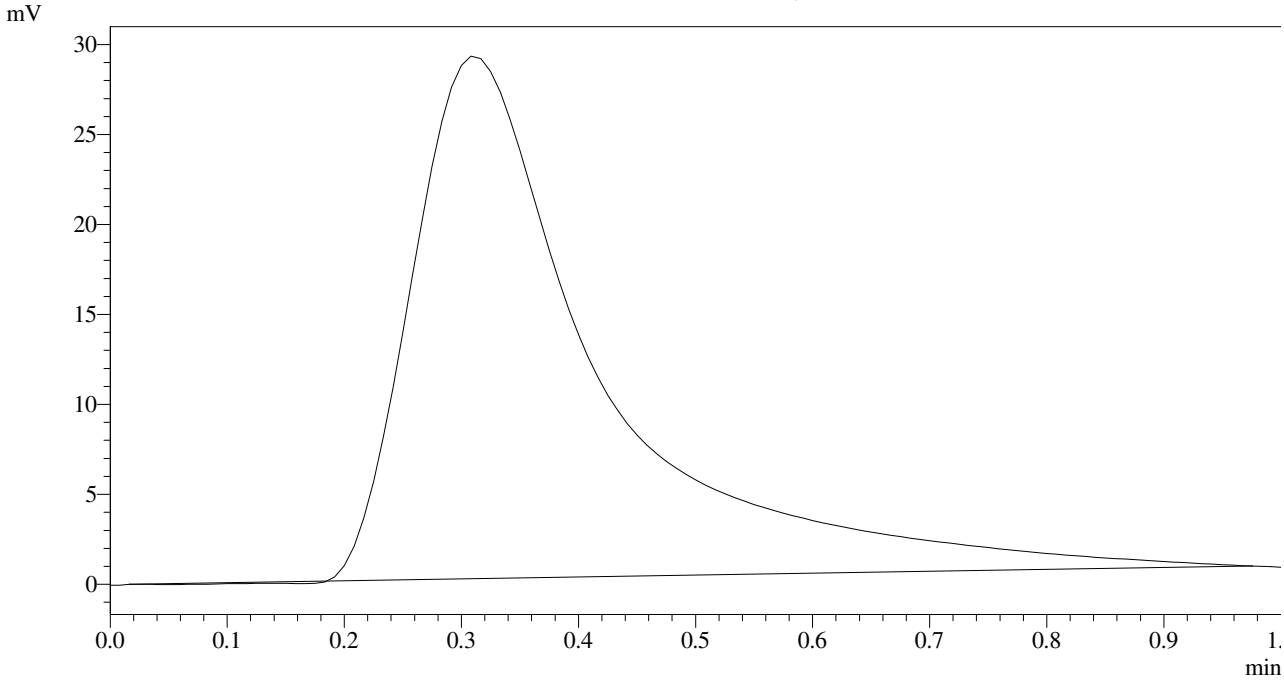

1 Det.A Ch1 / 350nm - 450nm

PeakTable

Detector A Ch1 350nm - 450nm

Peak#	Ret. Time	Height
1	0.307	31047
Total		31047

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDFL 3.lcd

Volume Injetado : 10 uL

Tray# : 1

Vail# : 3

Método Utilizado : Qualificação FL.lcm


Batch Filename : LDFL.lcb

Data da Analise : 25/5/2018 09:30:40

Data do processamento :25/5/2018 09:30:40

Chromatogram

LDFL 3 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDFL 3.lcd

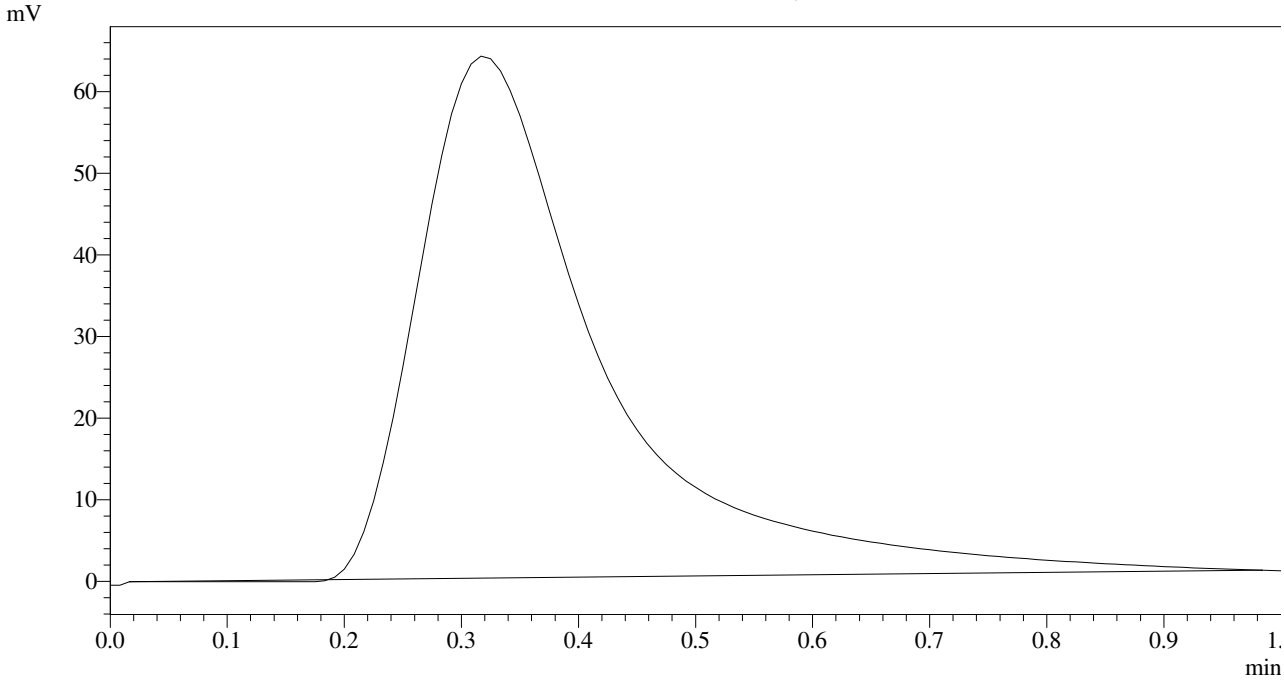

1 Det.A Ch1 / 350nm - 450nm

PeakTable

Detector A Ch1 350nm - 450nm

Peak#	Ret. Time	Height
1	0.315	63934
Total		63934

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDFL 4.lcd

Volume Injetado : 10 uL

Tray# : 1

Vail# : 4

Método Utilizado : Qualificação FL.lcm


Batch Filename : LDFL.lcb

Data da Analise : 25/5/2018 09:32:07

Data do processamento :25/5/2018 09:32:07

Chromatogram

LDFL 4 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDFL 4.lcd

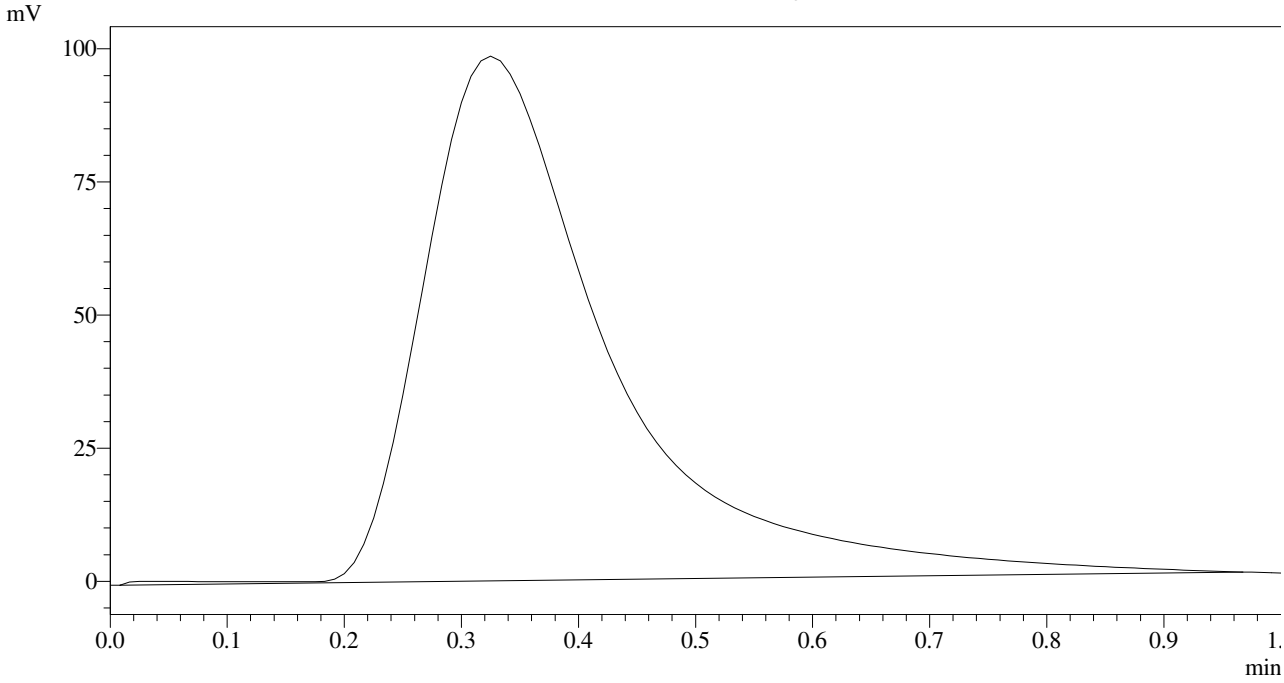

1 Det.A Ch1 / 350nm - 450nm

PeakTable

Detector A Ch1 350nm - 450nm

Peak#	Ret. Time	Height
1	0.321	98536
Total		98536

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDFL 5.lcd

Volume Injetado : 10 uL

Tray# : 1

Vail# : 5

Método Utilizado : Qualificação FL.lcm


Batch Filename : LDFL.lcb

Data da Analise : 25/5/2018 09:33:39

Data do processamento :25/5/2018 09:33:39

Chromatogram

LDFL 5 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDFL 5.lcd

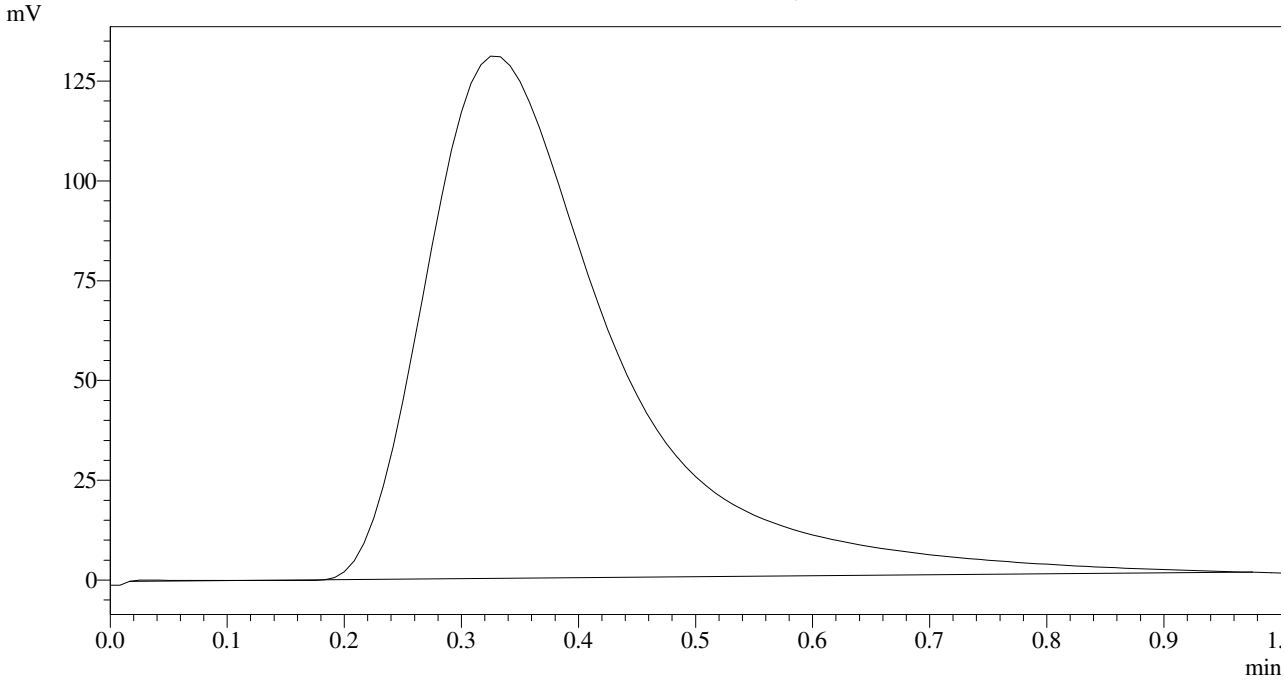

1 Det.A Ch1 / 350nm - 450nm

PeakTable

Detector A Ch1 350nm - 450nm

Peak#	Ret. Time	Height
1	0.324	130803
Total		130803