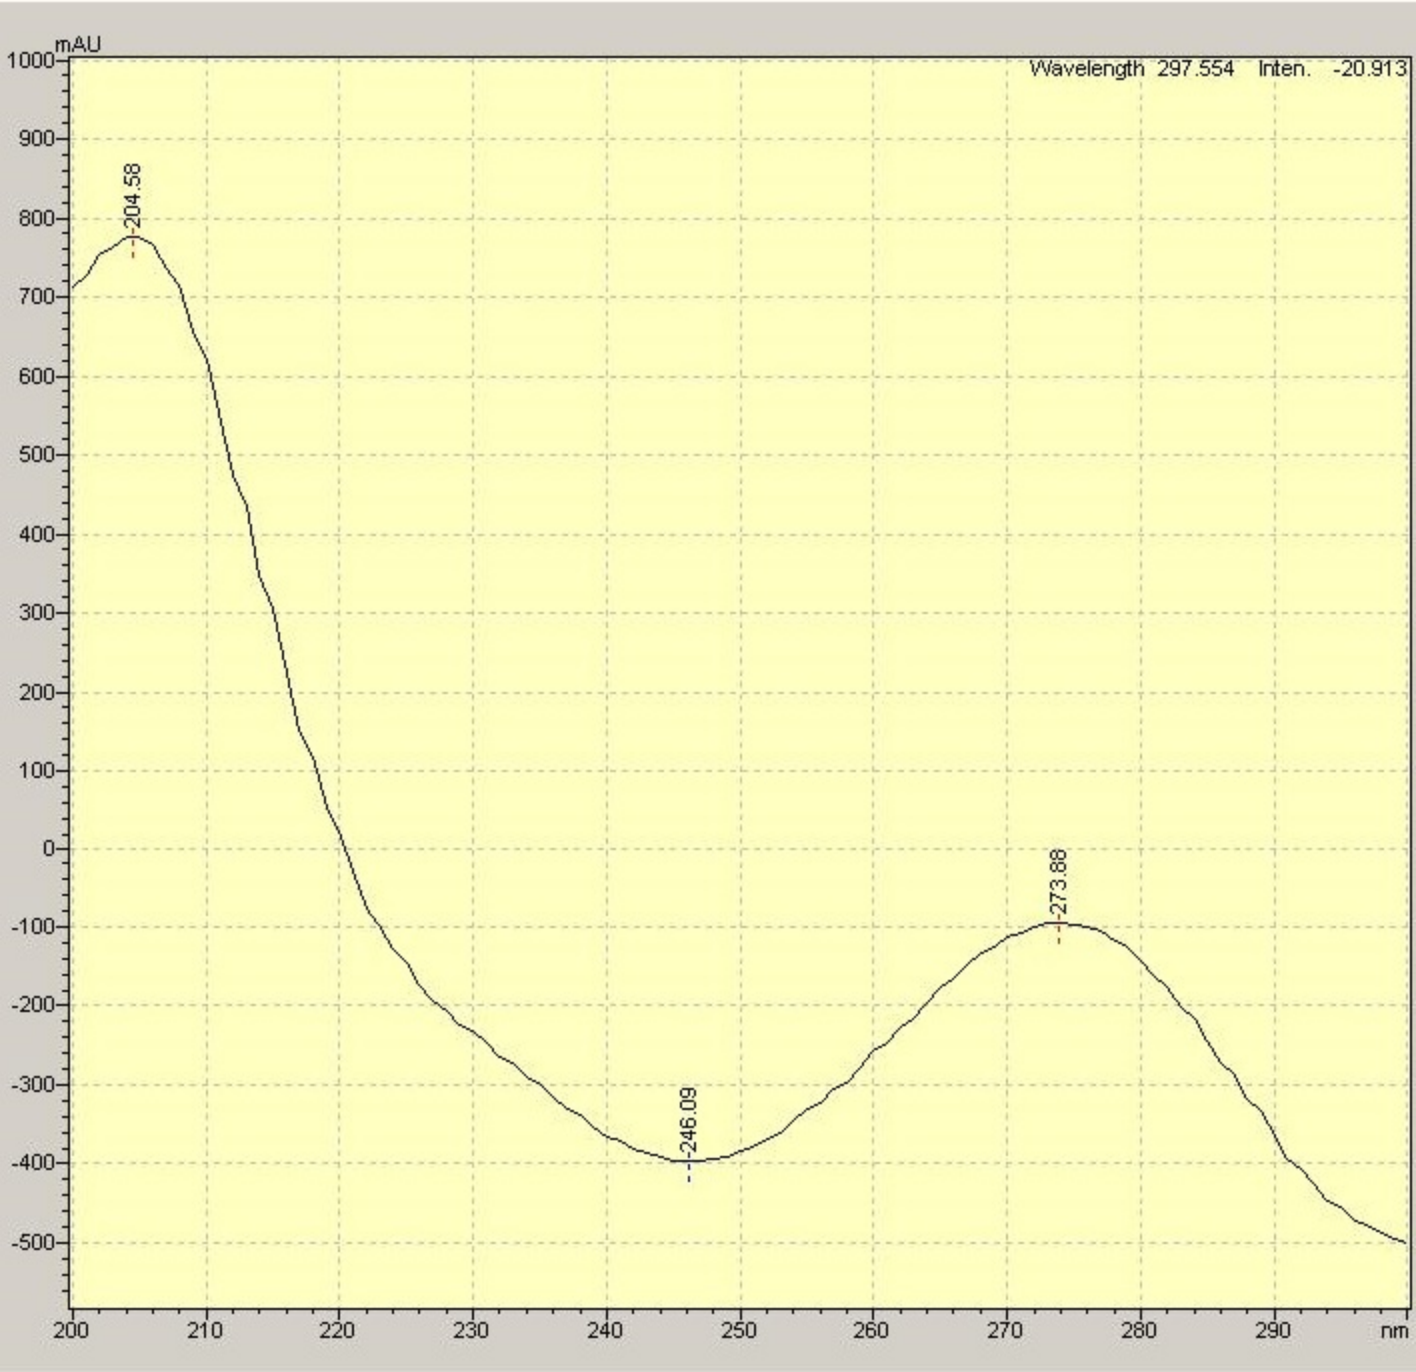

mAU
Wavelength 297.554 Inten. -20.913
204.58
246.09
273.88
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
nm


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: Branco 1.lcd**
Volume Injetado	**: 10 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação.lcm**
Batch Filename	**: PCIN.lcb**
Data da Analise	**: 24/5/2018 11:14:38**
Data do processamento	**:24/5/2018 11:14:38**

Chromatogram

Branco 1 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\Branco 1.lcd

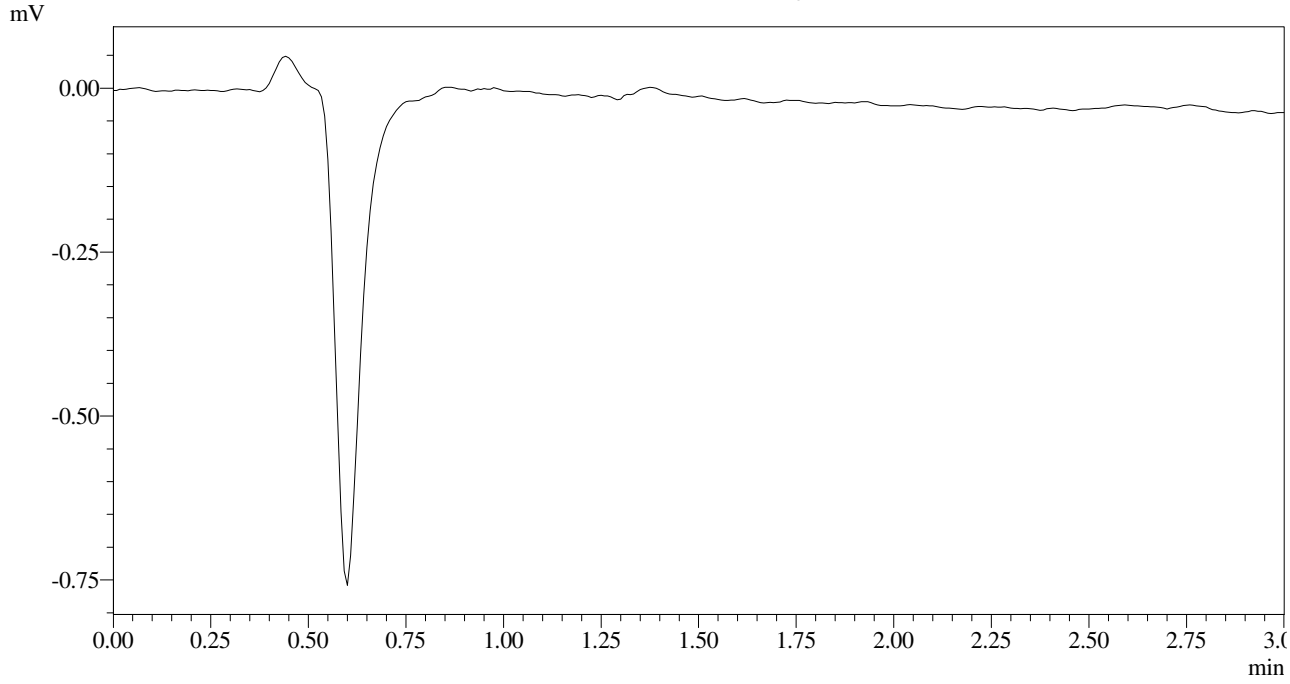

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable


Detector A Ch1 273nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 1.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:18:05
Data do processamento :24/5/2018 11:18:05

Chromatogram
PCIN 1 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 1.lcd

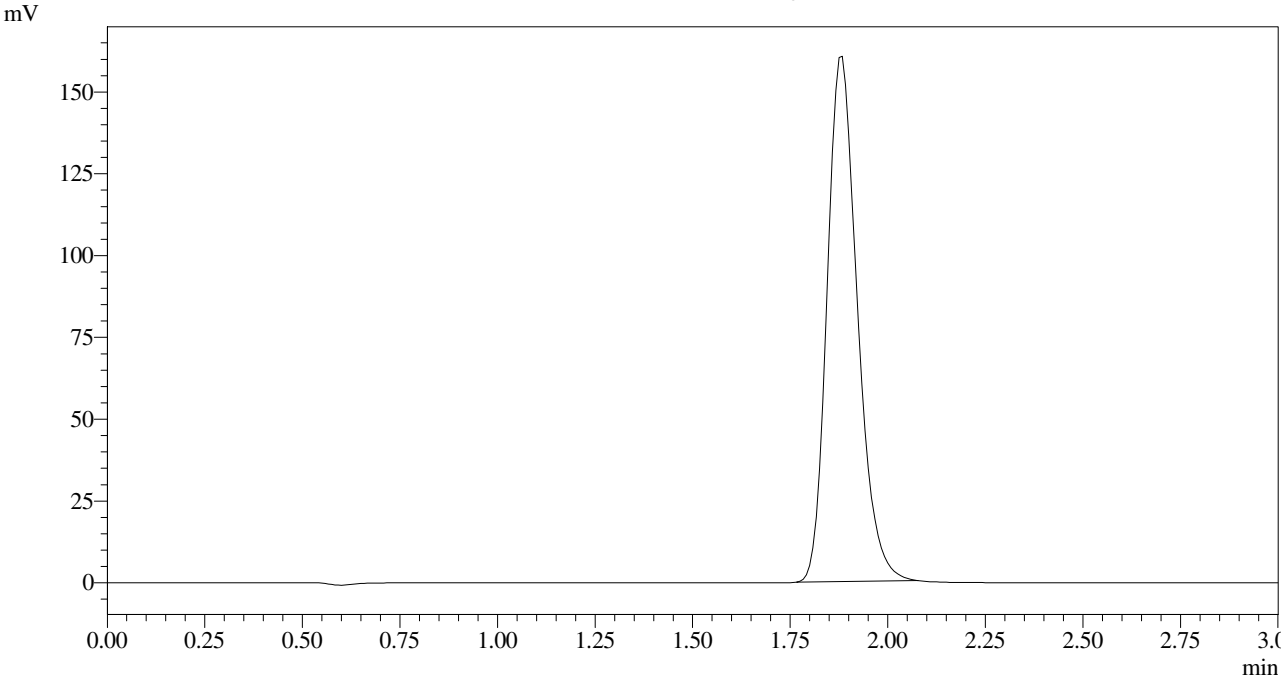

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.875	865884
Total		865884

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 2.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:21:33
Data do processamento :24/5/2018 11:21:33

Chromatogram
PCIN 2 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 2.lcd

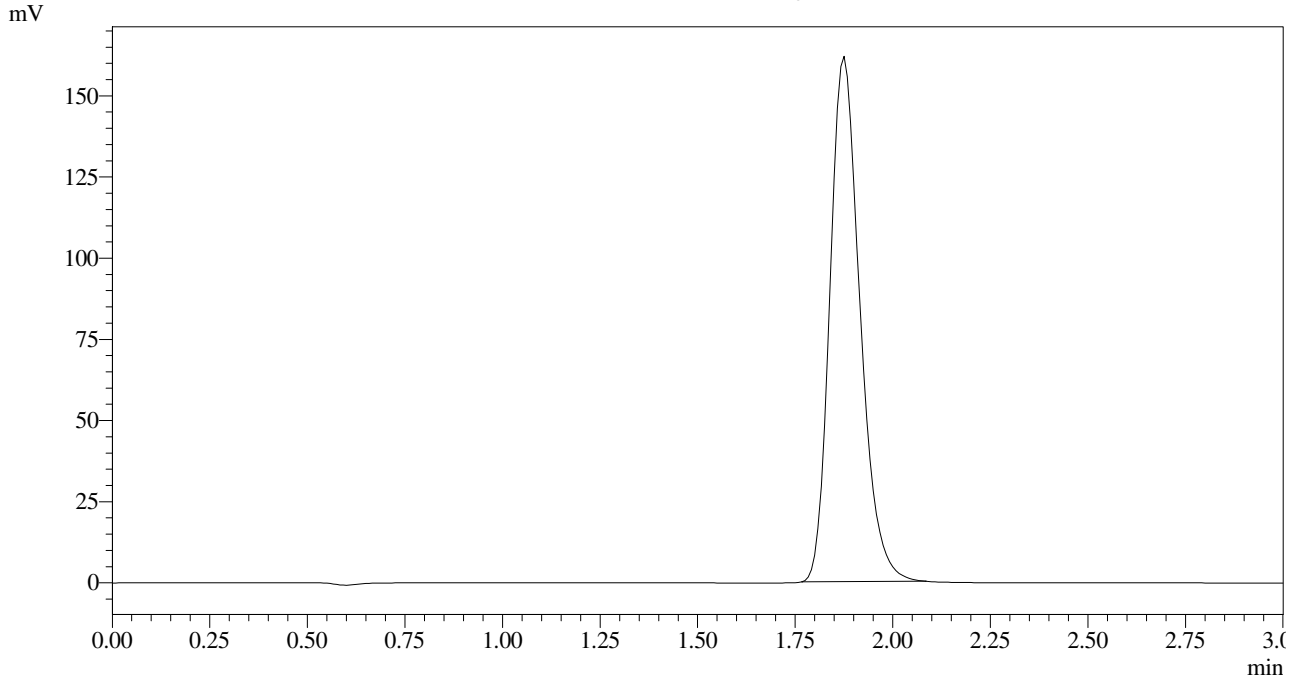

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.869	866485
Total		866485

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 3.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:25:02
Data do processamento :24/5/2018 11:25:02

Chromatogram
PCIN 3 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 3.lcd

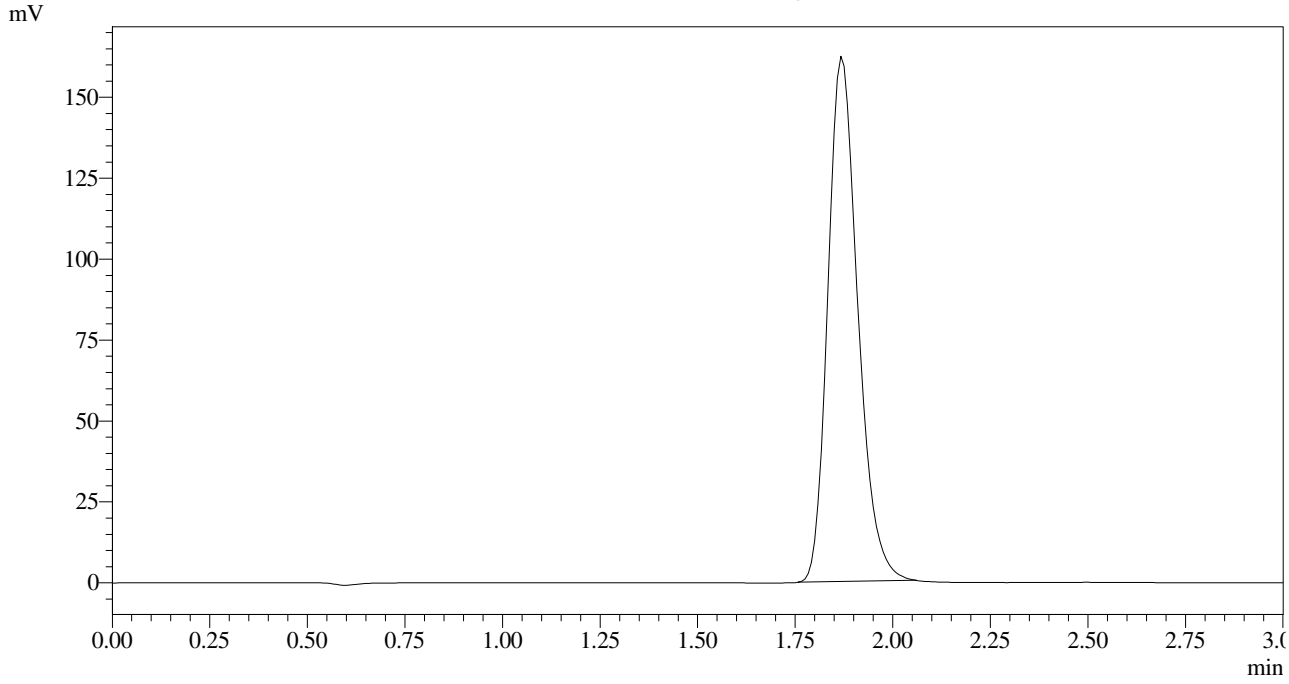

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm

Peak#	Ret. Time	Area
1	1.864	865224
Total		865224


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: Branco 2.lcd**
Volume Injetado	**: 10 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação.lcm**
Batch Filename	**: PCIN.lcb**
Data da Analise	**: 24/5/2018 11:28:32**
Data do processamento	**:24/5/2018 11:28:32**

Chromatogram

Branco 2 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\Branco 2.lcd

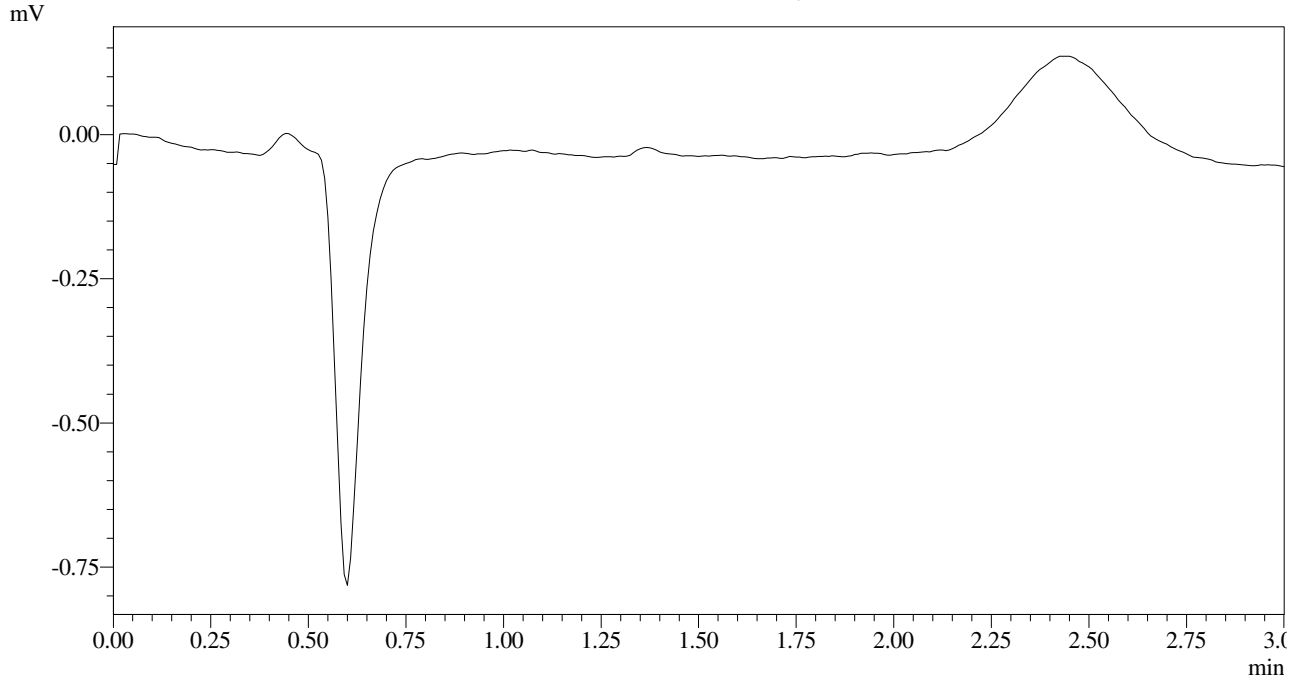

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable


Detector A Ch1 273nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 4.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:32:02
Data do processamento :24/5/2018 11:32:02

Chromatogram
PCIN 4 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 4.lcd

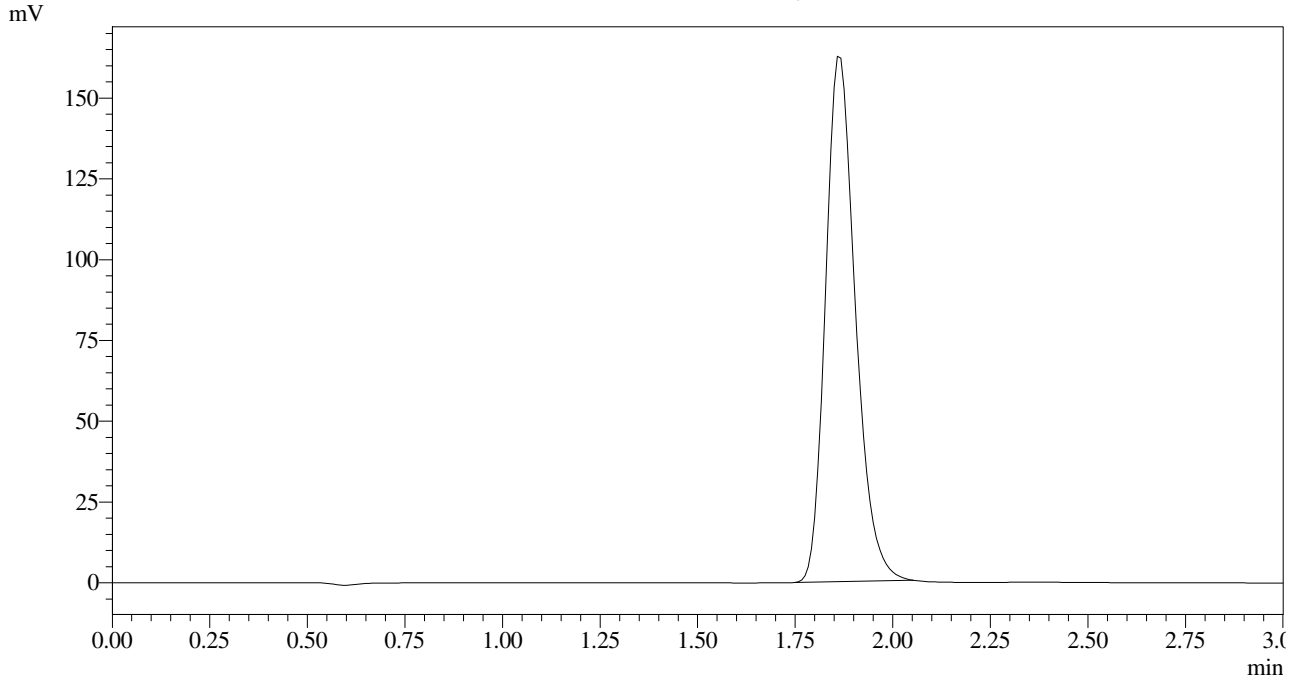

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.858	866056
Total		866056

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 5.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:35:30
Data do processamento :24/5/2018 11:35:30

Chromatogram
PCIN 5 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 5.lcd

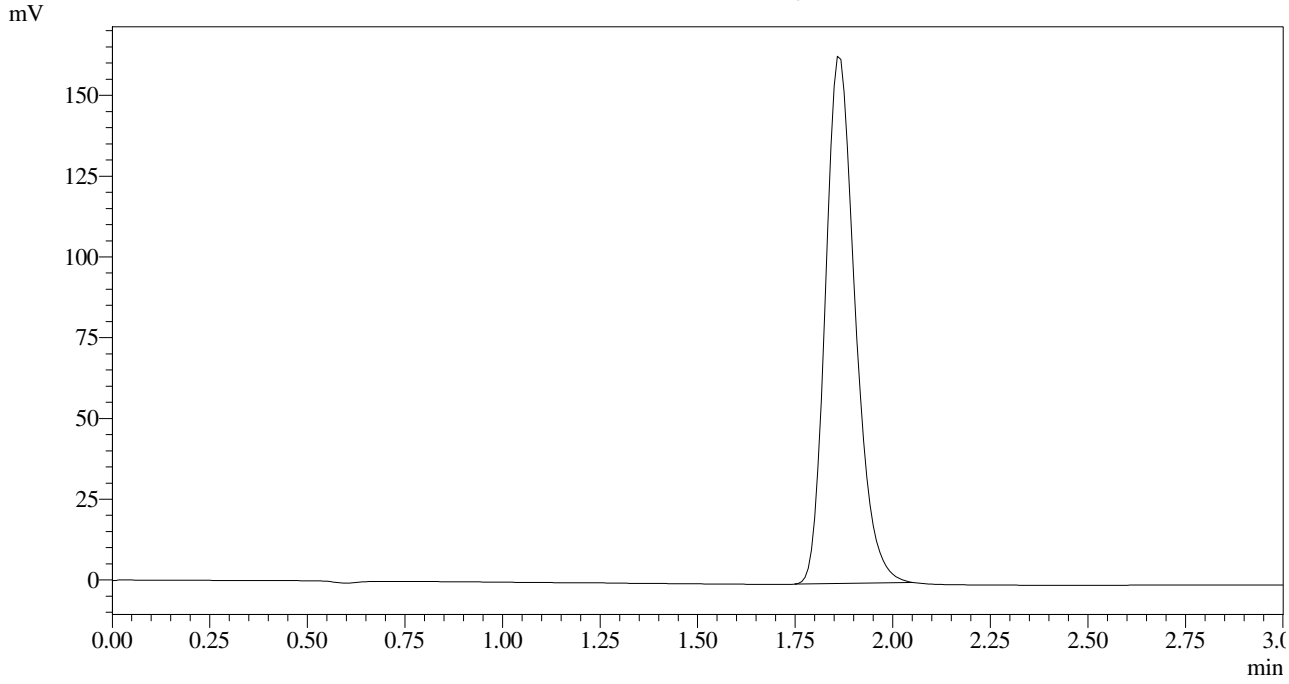

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.858	866549
Total		866549

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : PCIN 6.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : PCIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 11:39:00
Data do processamento :24/5/2018 11:39:00

Chromatogram
PCIN 6 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\PCIN 6.lcd

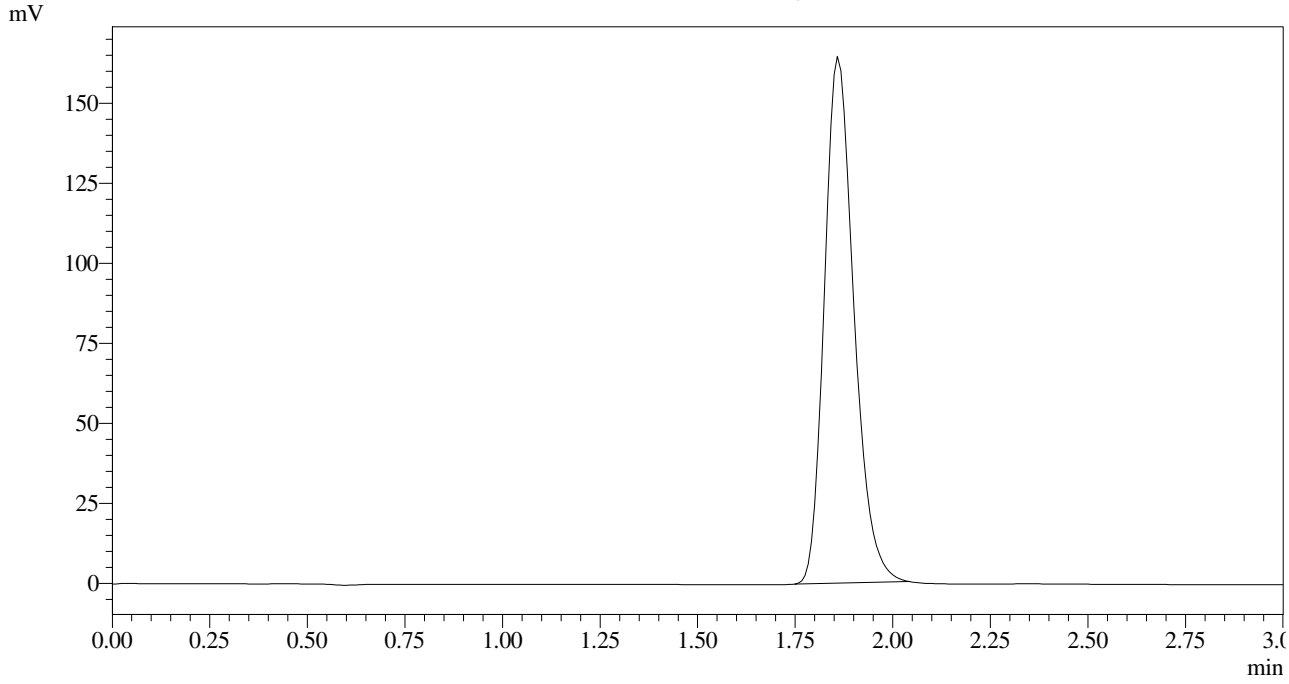

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm

Peak#	Ret. Time	Area
1	1.855	865423
Total		865423


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: Branco 3.lcd**
Volume Injetado	**: 10 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação.lcm**
Batch Filename	**: PCIN.lcb**
Data da Analise	**: 24/5/2018 11:42:30**
Data do processamento	**:24/5/2018 11:42:30**

Chromatogram

Branco 3 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\Branco 3.lcd

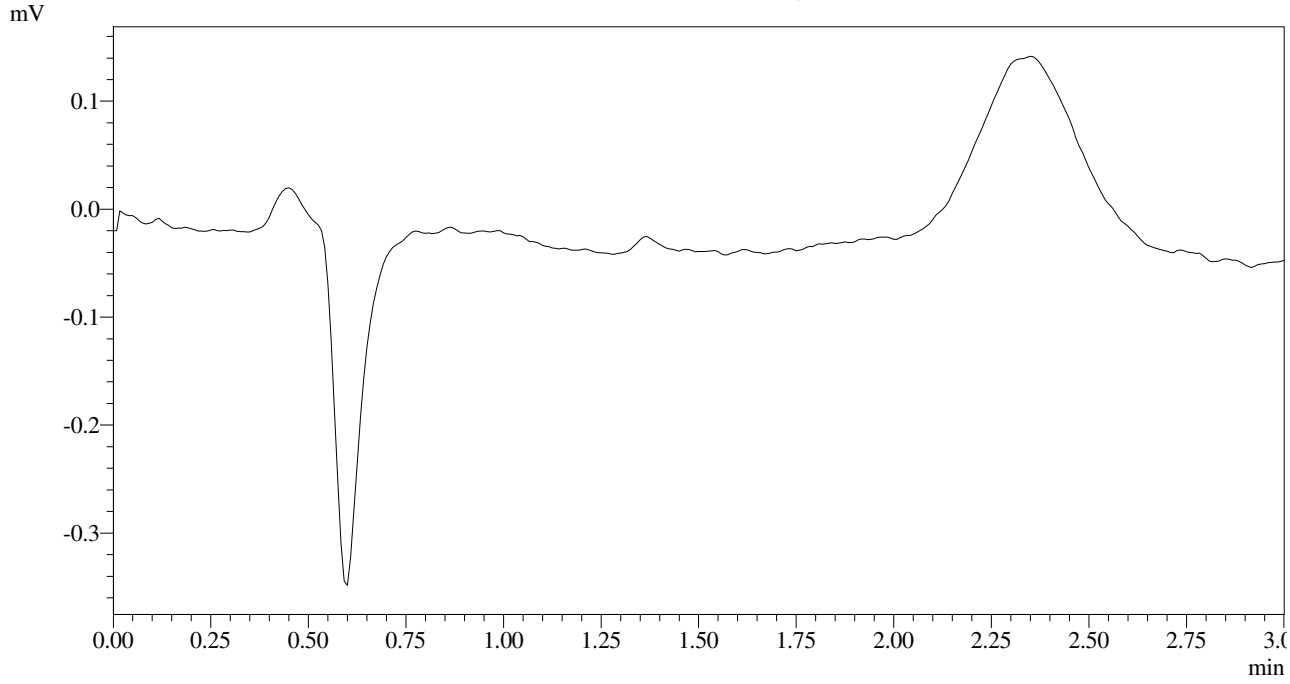

1 Det.A Ch1 / 273nm


PeakTable

Detector A Ch1 273nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: LDUV 1.lcd**
Volume Injetado	**: 10 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação.lcm**
Batch Filename	**: LDUV.lcb**
Data da Analise	**: 24/5/2018 11:56:58**
Data do processamento	**:24/5/2018 11:56:58**

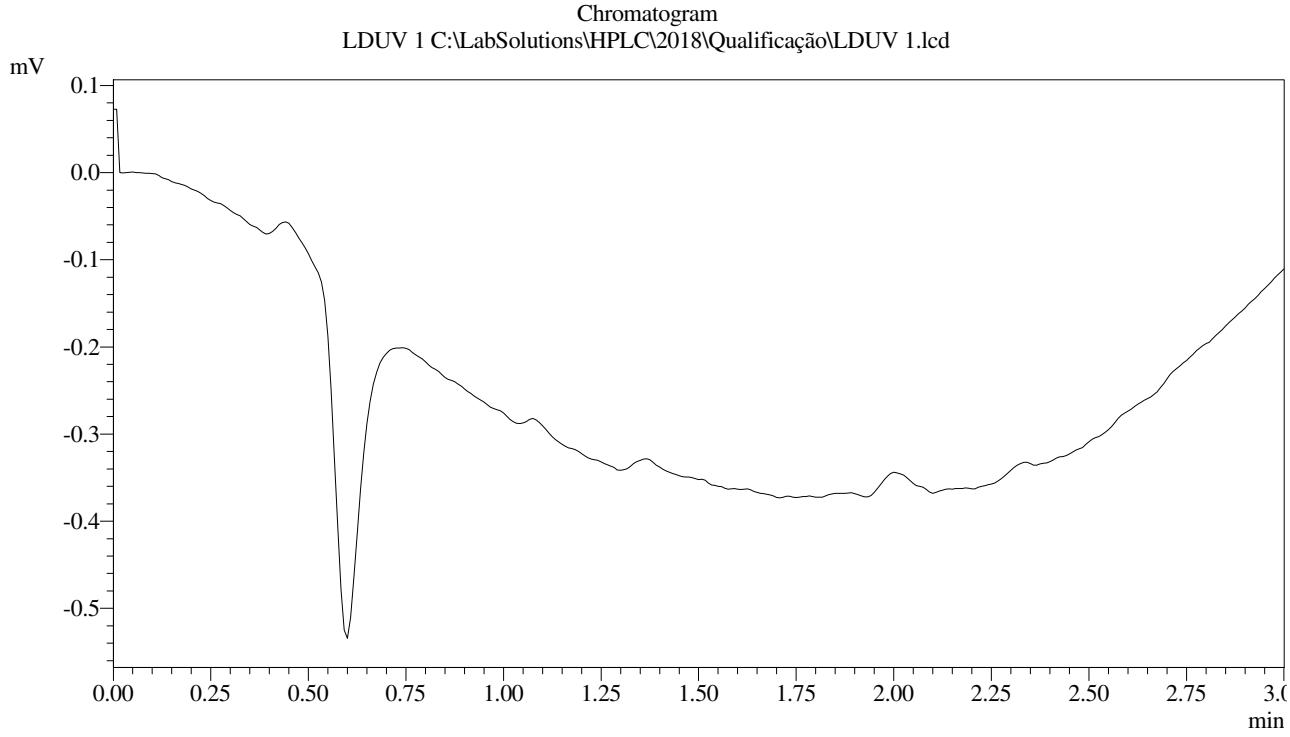

PeakTable


Detector A Ch1 273nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDUV 2.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 2
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LDUV.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 12:00:27
Data do processamento :24/5/2018 12:00:27

Chromatogram
LDUV 2 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDUV 2.lcd

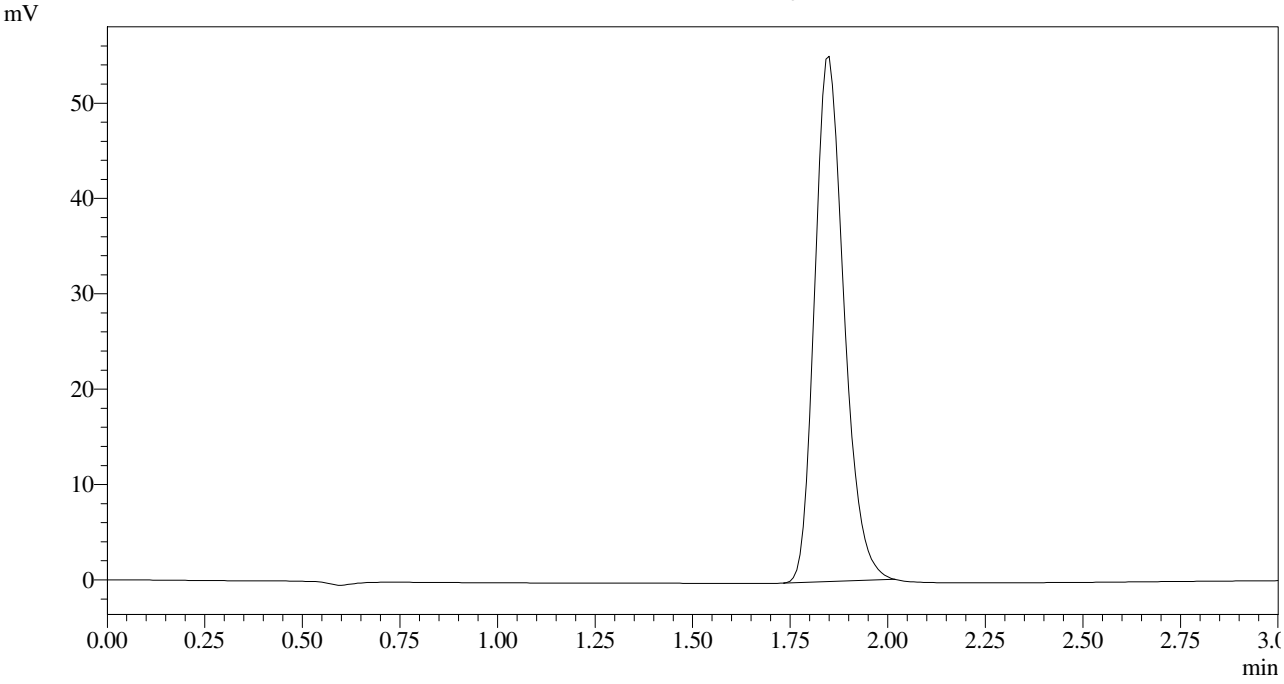

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.842	288125
Total		288125

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDUV 3.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 3
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LDUV.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 12:03:56
Data do processamento :24/5/2018 12:03:56

Chromatogram
LDUV 3 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDUV 3.lcd

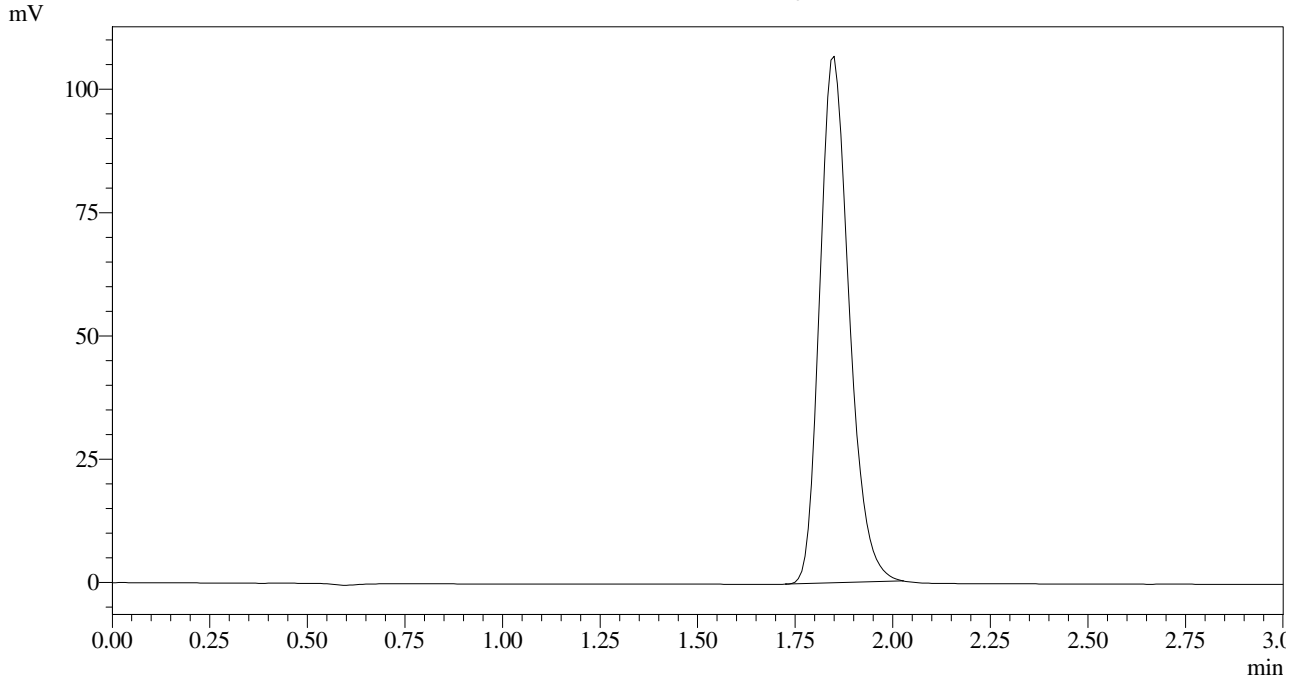

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.843	560876
Total		560876

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDUV 4.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 4
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LDUV.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 12:07:26
Data do processamento :24/5/2018 12:07:26

Chromatogram
LDUV 4 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDUV 4.lcd

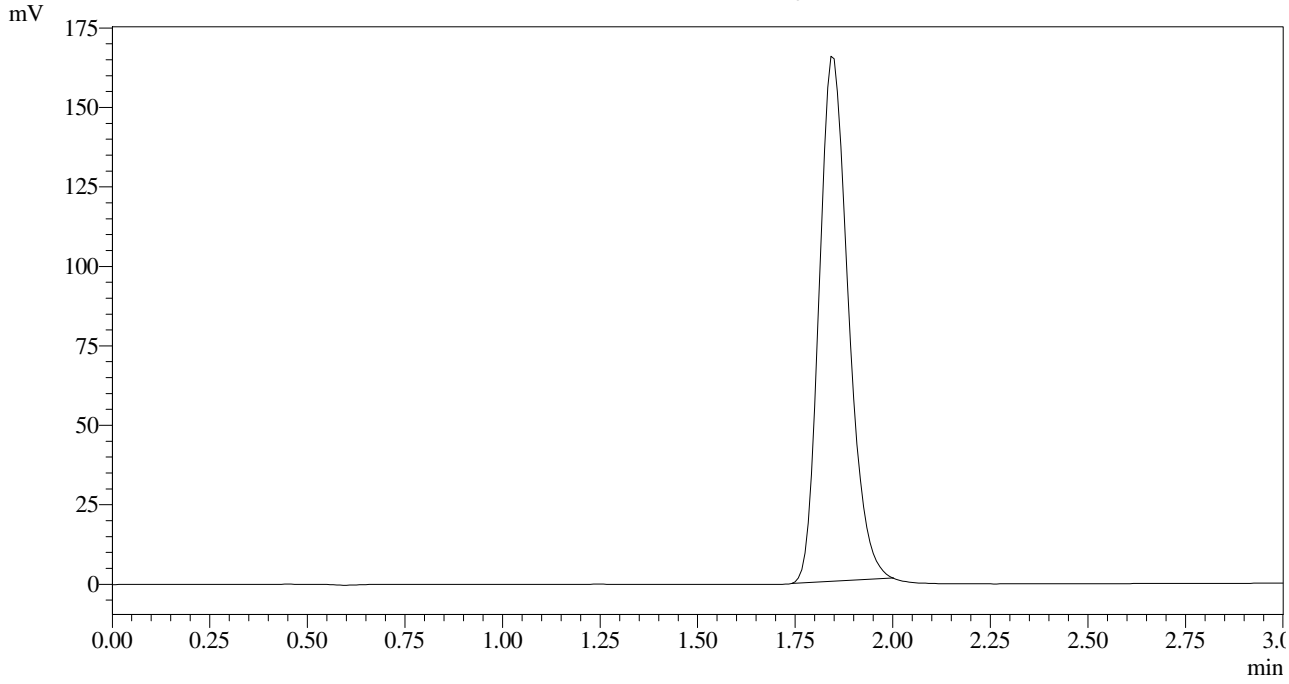

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.841	857418
Total		857418

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LDUV 5.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 5
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LDUV.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 12:10:56
Data do processamento :24/5/2018 12:10:56

Chromatogram
LDUV 5 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LDUV 5.lcd

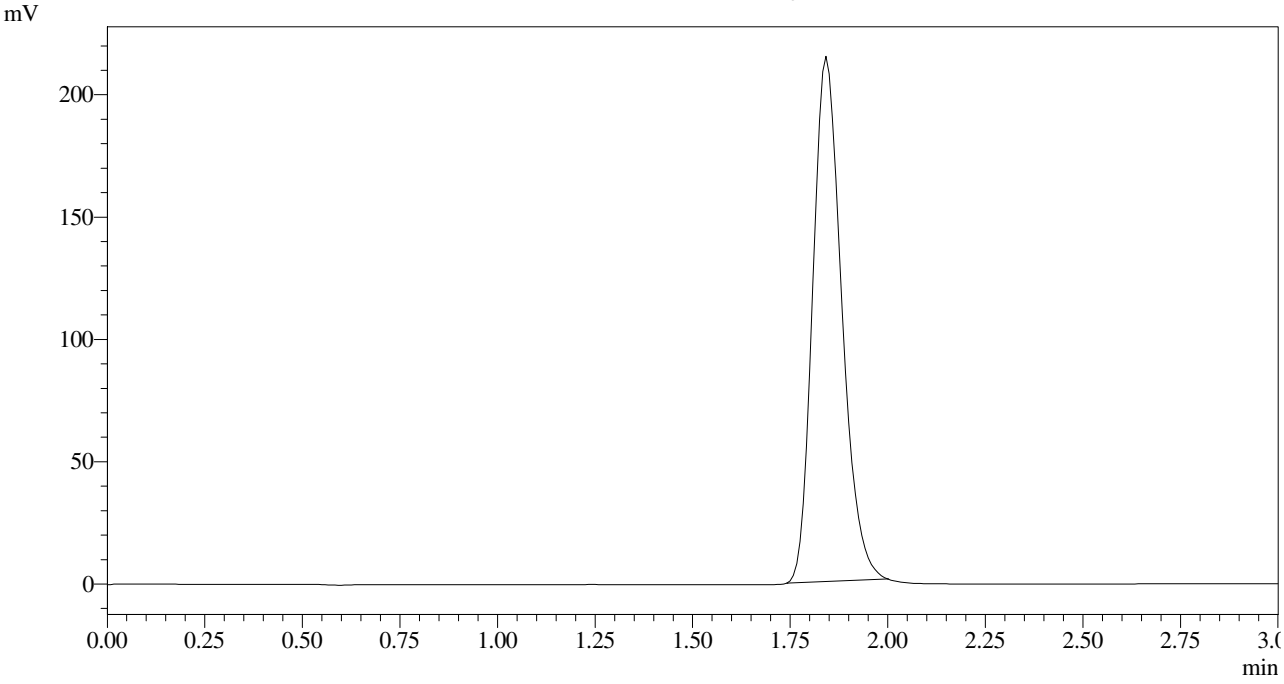

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm

Peak#	Ret. Time	Area
1	1.837	1108896
Total		1108896


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: LIIN 1.lcd**
Volume Injetado	**: 0.1 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Qualificação.lcm**
Batch Filename	**: LIIN.lcb**
Data da Analise	**: 24/5/2018 13:52:04**
Data do processamento	**:24/5/2018 13:52:04**

Chromatogram

LIIN 1 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LIIN 1.lcd

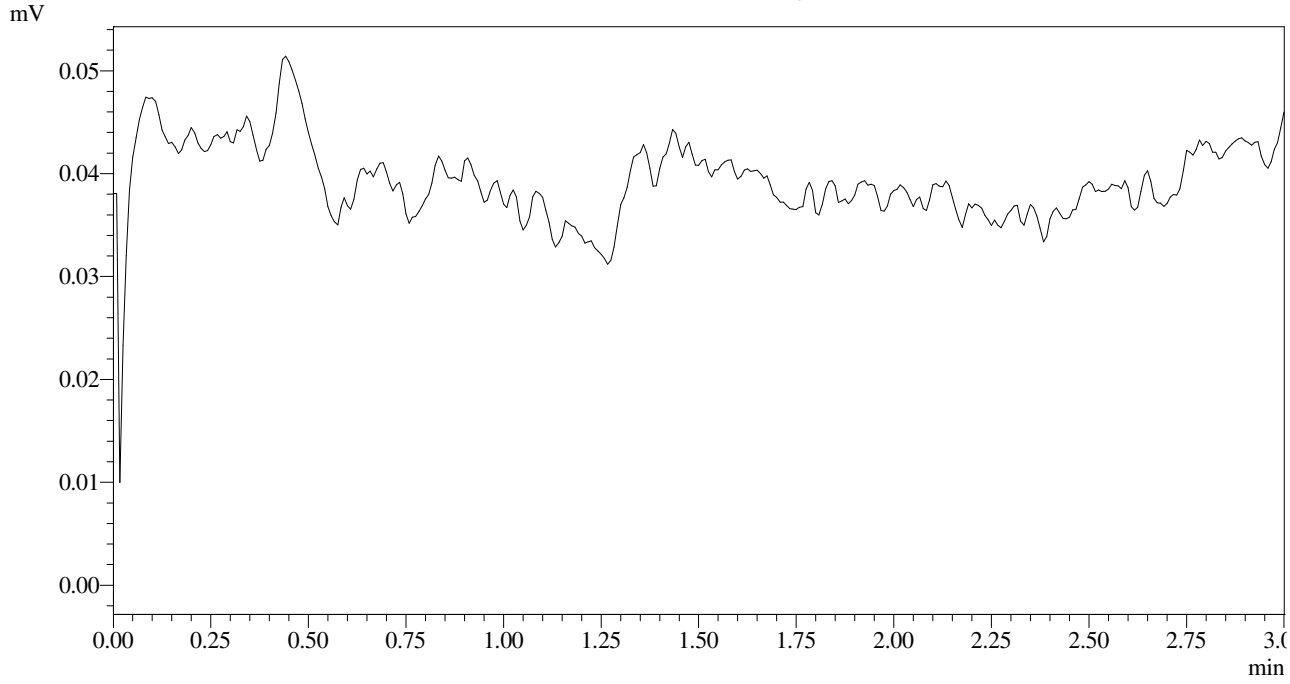

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable


Detector A Ch1 273nm

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LIIN 2.lcd
Volume Injetado : 5 uL
Tray# : 1
Vail# : 1
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LIIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 13:55:35
Data do processamento :24/5/2018 13:55:35

Chromatogram
LIIN 2 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LIIN 2.lcd

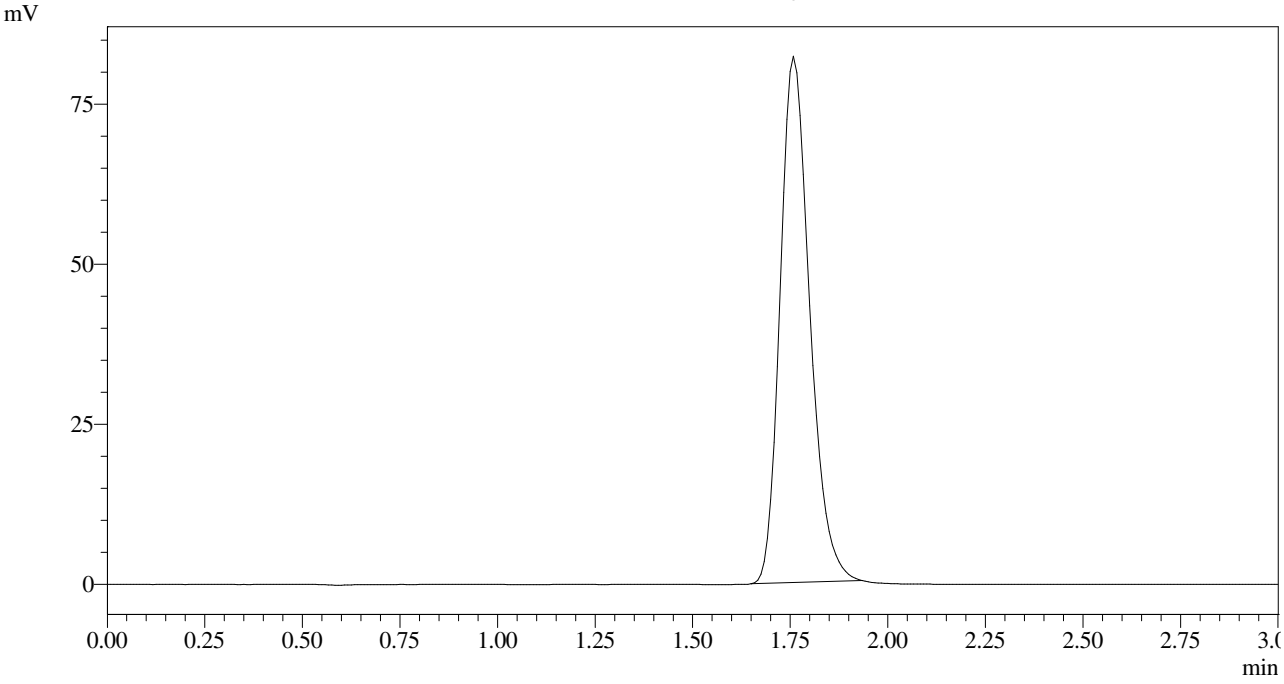

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.754	433997
Total		433997

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LIIN 3.lcd
Volume Injetado : 10 uL
Tray# : 1
Vail# : 1
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LIIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 13:59:05
Data do processamento :24/5/2018 13:59:05

Chromatogram
LIIN 3 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LIIN 3.lcd

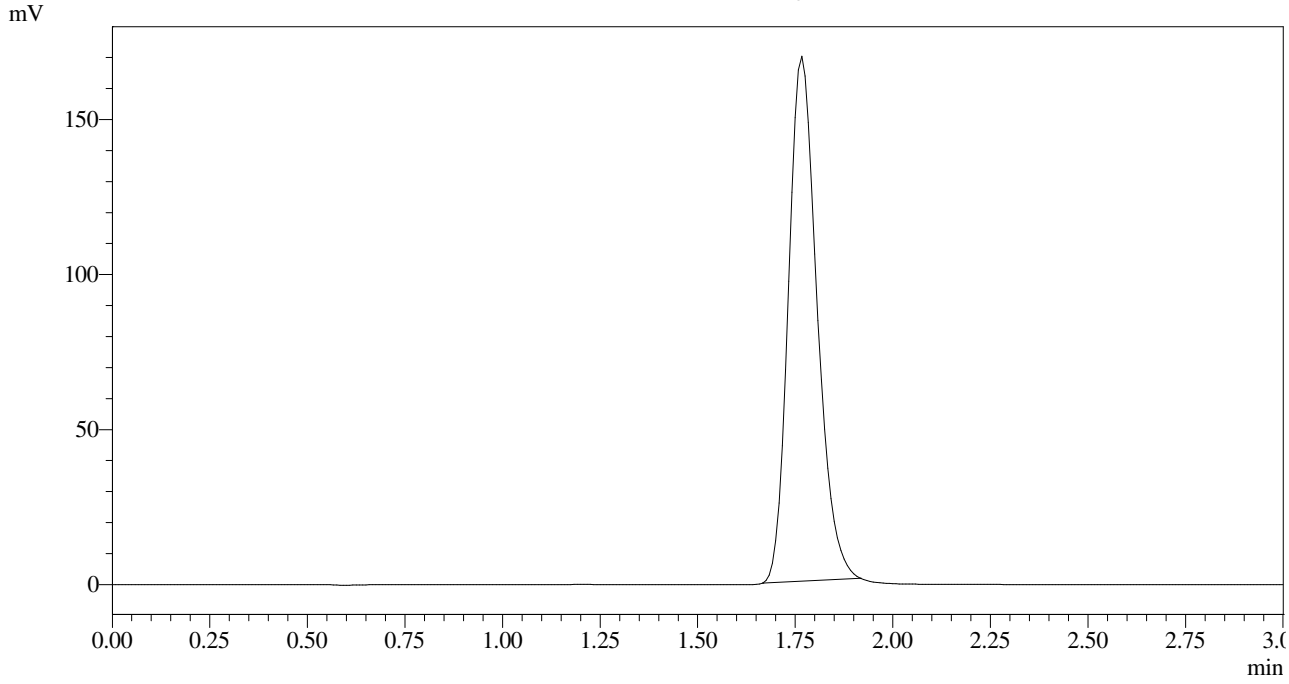

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.762	863520
Total		863520

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LIIN 4.lcd
Volume Injetado : 15 uL
Tray# : 1
Vail# : 1
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LIIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 14:02:36
Data do processamento :24/5/2018 14:02:36

Chromatogram
LIIN 4 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LIIN 4.lcd

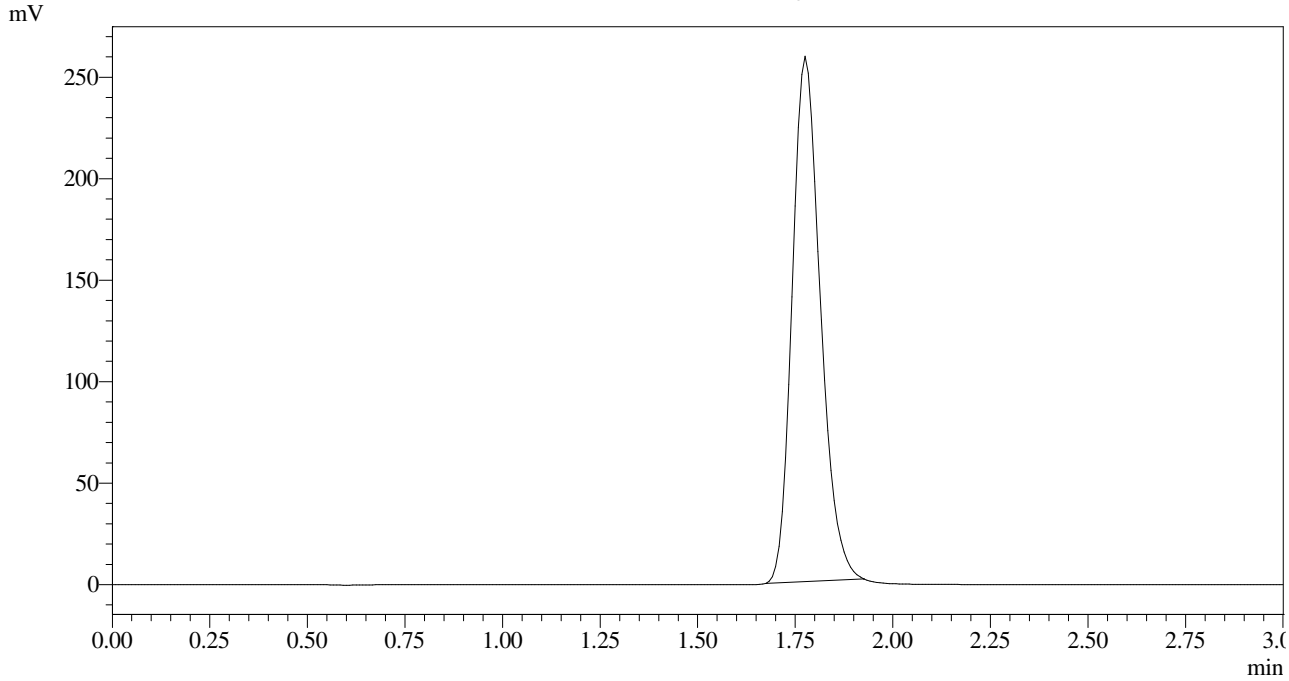

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm


Peak#	Ret. Time	Area
1	1.771	1299090
Total		1299090

Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename : LIIN 5.lcd
Volume Injetado : 20 uL
Tray# : 1
Vail# : 1
Método Utilizado : Qualificação.lcm
Batch Filename : LIIN.lcb
Data da Analise : 24/5/2018 14:06:07
Data do processamento :24/5/2018 14:06:07

Chromatogram
LIIN 5 C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\LIIN 5.lcd

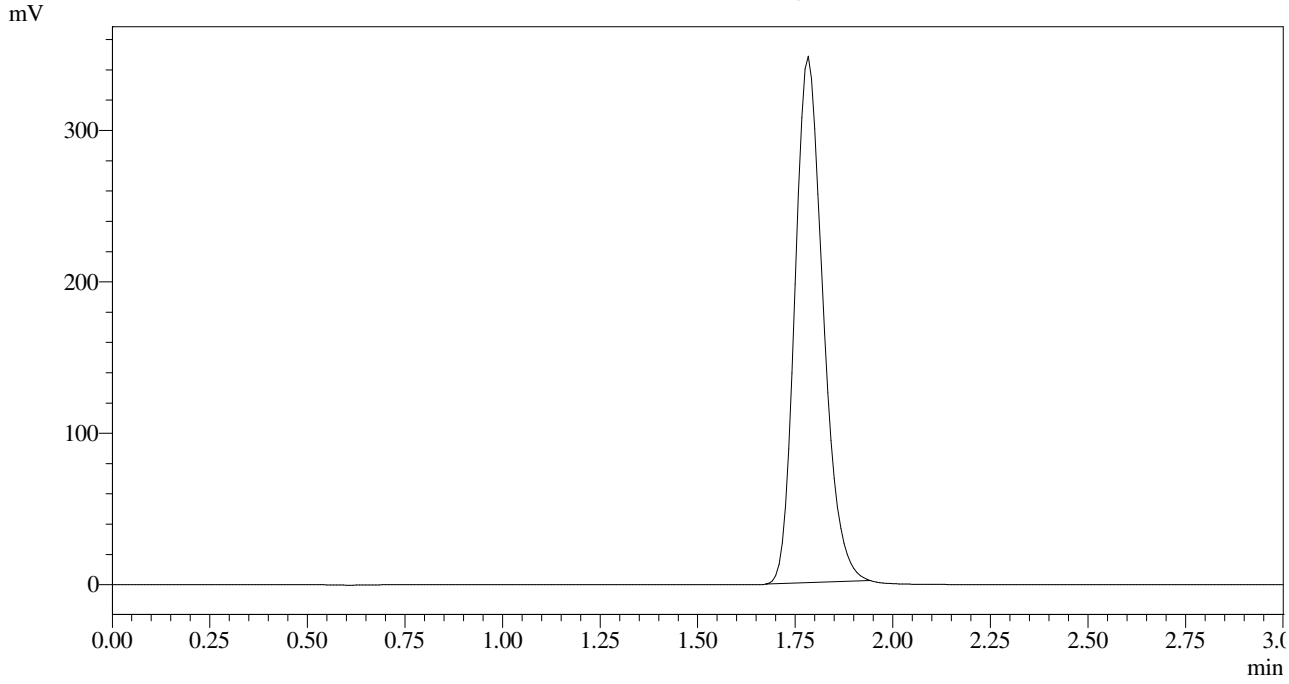

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm

Peak#	Ret. Time	Area
1	1.778	1743045
Total		1743045


Hidrolabor - Laboratório de Controle de Qualidade LTDA

Informações da Amostra

Data Filename	**: Grad AB1.lcd**
Volume Injetado	**: 0.1 uL**
Tray#	**: 1**
Vail#	**: 1**
Método Utilizado	**: Grad AB.lcm**
Batch Filename	**:**
Data da Analise	**: 24/5/2018 14:58:08**
Data do processamento	**:24/5/2018 14:58:08**

Chromatogram

Grad AB C:\LabSolutions\HPLC\2018\Qualificação\Grad AB1.lcd

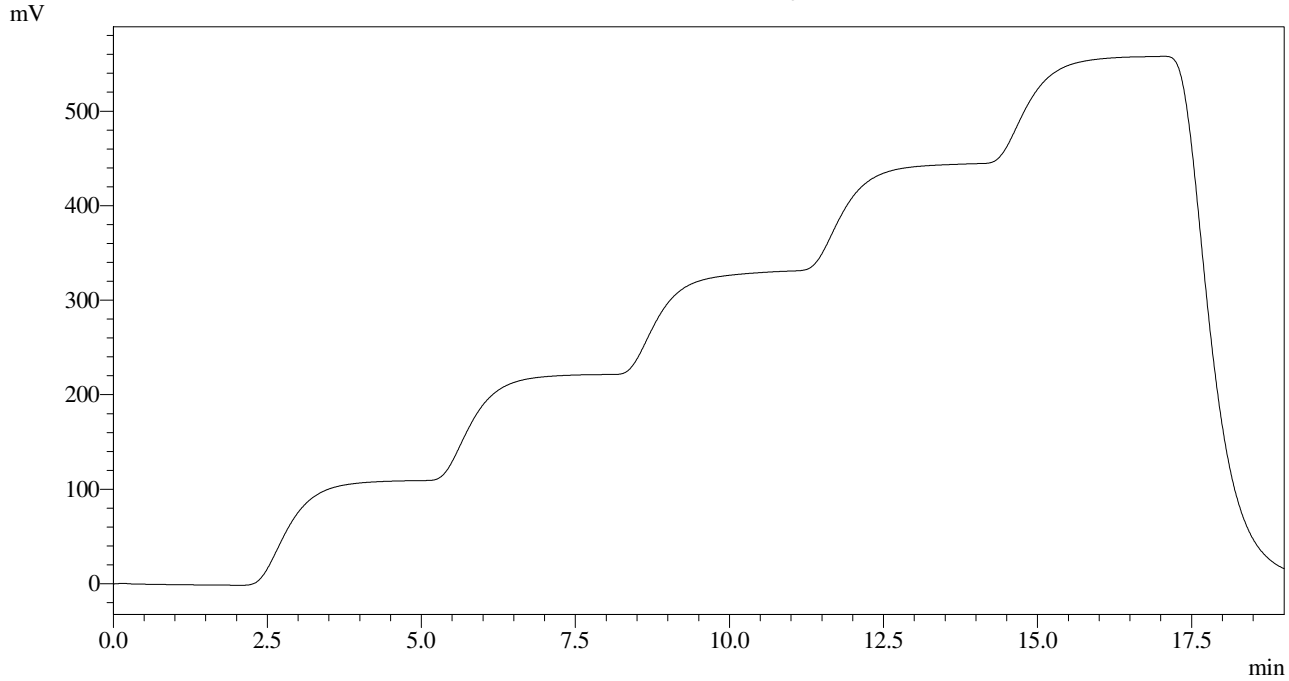

1 Det.A Ch1 / 273nm

PeakTable

Detector A Ch1 273nm