
Certificado Nº: 090/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	140,5700

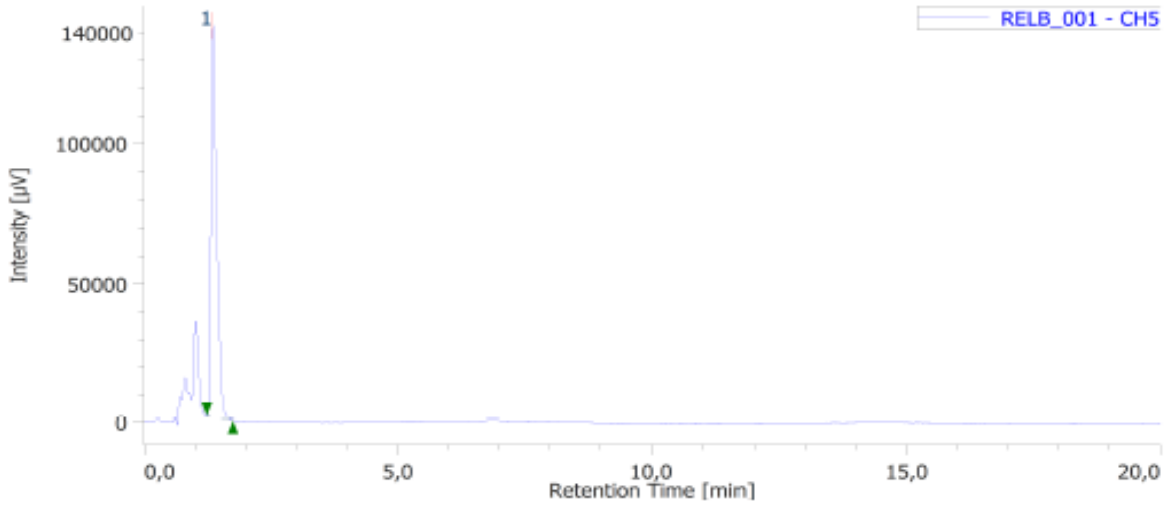

Chromatogram Information

User Name	QPackSA
Date Modified	20/02/2025 20:07:47
Description	
HPLC System Name	HP06
Injection Date	20/02/2025 19:44:19
Volume	20,0 [µL]
Sample #	9
Project Name	Qualificação
Acquisition Time	20,0 [min]
Acquisition Sequence	
Control Method	RELB
Peak ID Table	Cafeína
Calibration Method	
Additional Information	

Channel & Peak Information Table


Chromatogram Name	RELB_001-CH5
Sample Name	
Channel Name	250,0nm
Sampling Interval	100 [msec]
Peak Method	Cafeina (Manual)

#	Peak Name	CH	tR [min]	Area [µV·sec]	Height [µV]	Area%	Height%	Quantity	NTP	Resolution	Symmetry Factor	Warning	S/N
1	Cafeína	5	1,350	1076916	140570	100,000	100,000	N/A	810	N/A	1,708		N/A

Certificado Nº: 090/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,1600
VALOR MÍNIMO:	-0,2000
	Ruído
	0,0400

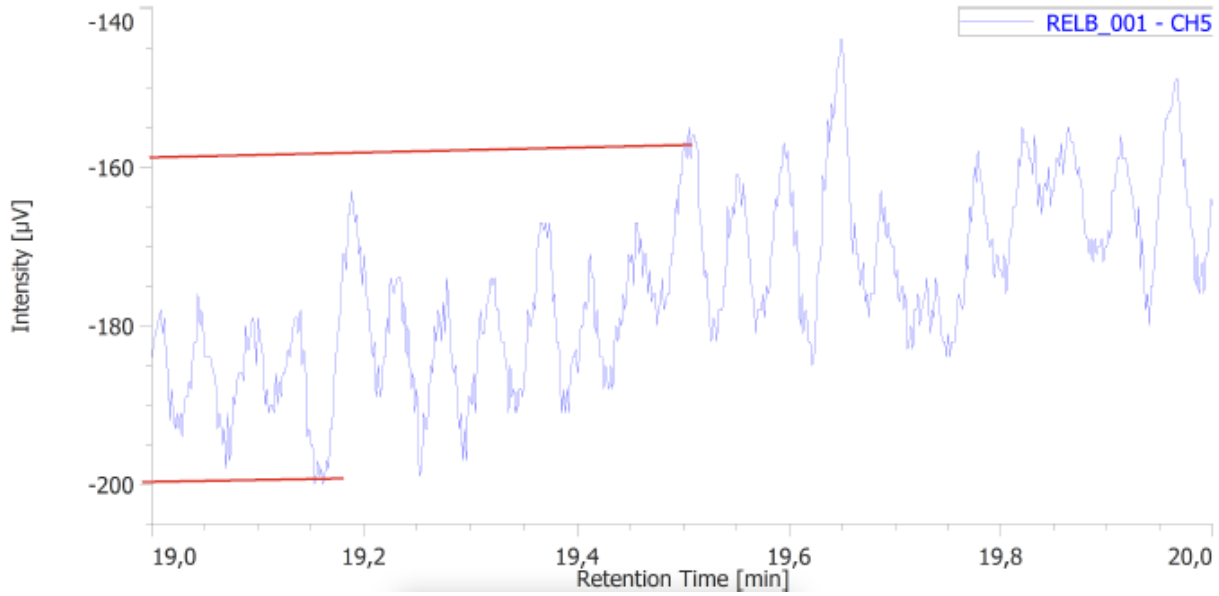

Certificado Nº: 090/25 -RELB	Início da Qualificação: 19/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,9000
VALOR MÍNIMO:	-0,3000	
Resultado:	0,3000	

