[nm]	[mAU]
200	2176.317
201	2269.944
202	2310.654
203	2341.056
204	***2352.766***
205	2345.609
206	2327.276
207	2287.819
208	2229.712
209	2154.659
210	2104.916
211	2017.467
212	1942.969
213	1882.208
214	1798.7
215	1724.346
216	1662.989
217	1585.498
218	1508.048
219	1453.851
220	1386.965
221	1319.2
222	1269.466
223	1236.167
224	1198.829
225	1165.768
226	1145.51
227	1120.812
228	1098.424
229	1084.064
230	1064.915
231	1047.141
232	1031.026
233	1011.837
234	994.393
235	974.404
236	962.839
237	945.68
238	929.382
239	919.476
240	904.712
241	891.778
242	884.016
243	874.945
244	867.197
245	862.111
246	***858.23***
247	859.577
248	861.562
249	864.855
250	869.772
251	876.84
252	884.614
253	891.538
254	902.407
255	914.519
256	923.108
257	938.378
258	954.042
259	965.023
260	981.197
261	996.488
262	1014.03
263	1025.095
264	1039.858
265	1052.889
266	1063.554
267	1076.91
268	1088.586
269	1099.737
270	1105.76
271	1111.636
272	1115.279
273	***1115.6***
274	1113.238
275	1109.164
276	1100.834
277	1092.207
278	1076.999
279	1057.702
280	1040.39
281	1014.536
282	985.258
283	955.843
284	933.255
285	903.581
286	871.004
287	839.884
288	816.836
289	783.417
290	753.258
291	731.364
292	703.01
293	678.318
294	656.675
295	644.443
296	629.245
297	617.591
298	610.562
299	603.657
300	597.585

HPLC0002 - Agilent Lab Advisor

Agilent Lab Advisor

Service & Diagnostics

Basic Version

Tasks

Spectral Scan

HPLC0002 » HPLC0002 » G1314B:DE63056963

Lab Advisor

- System Overview
- Configuration
- Apps
- Firmware Update
- Logs & Results

HPLC0002

- Service & Diagnostics
- Instrument Control
- EMFs
- Firmware Update Report
- System Report


Help

- Context Help (F1)
- Help Topics
- What's New?

Spectral Scan - VWD [DE63056963]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

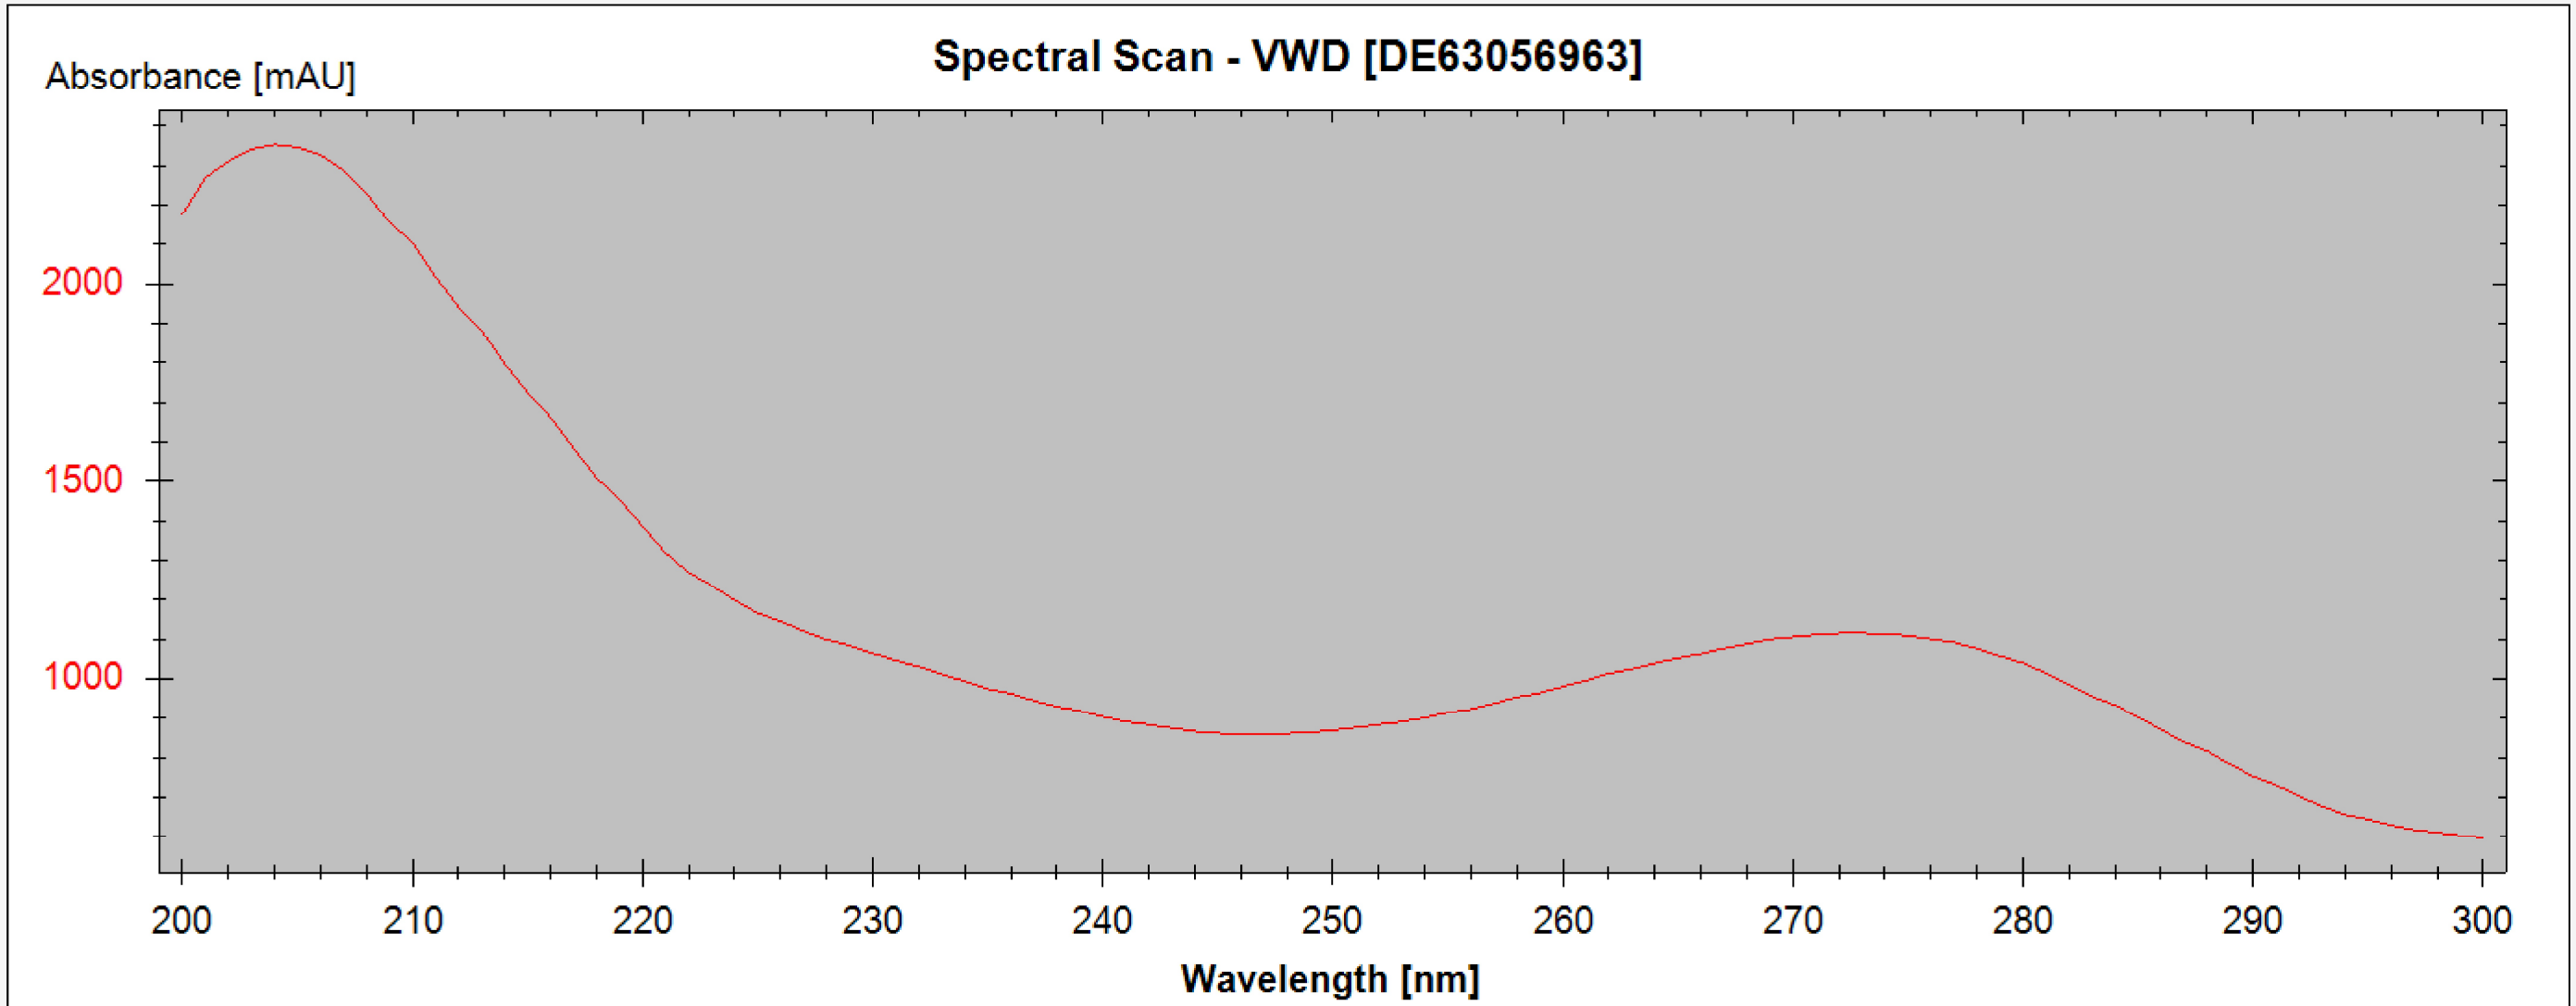


more... | Print Result | Back

Connection Address: 192.168.254.12

Version 2.18.479 - Basic | Licenses 9/20

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:30:48 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 9:23:50 AM (GMT -03:00)

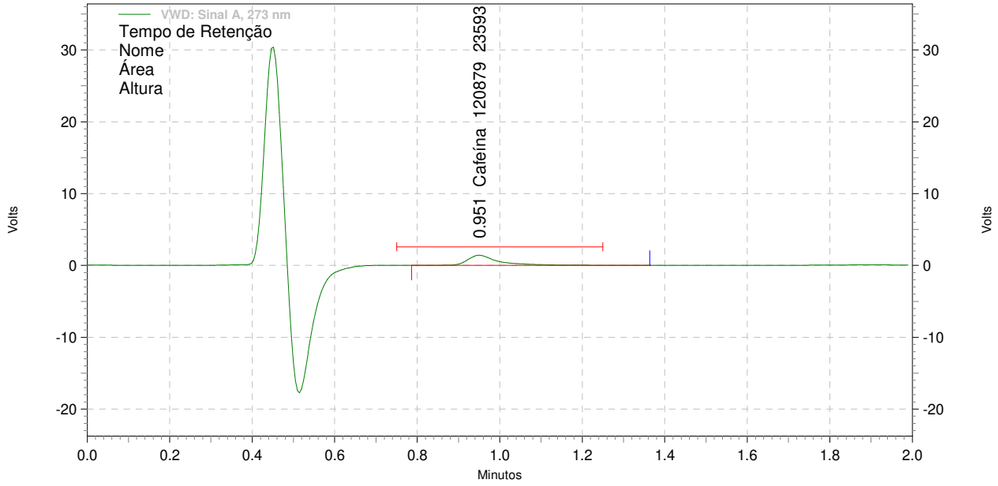


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	120879	23593
Totais	120879	23593

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:33:34 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:24:41 AM (GMT -03-00)

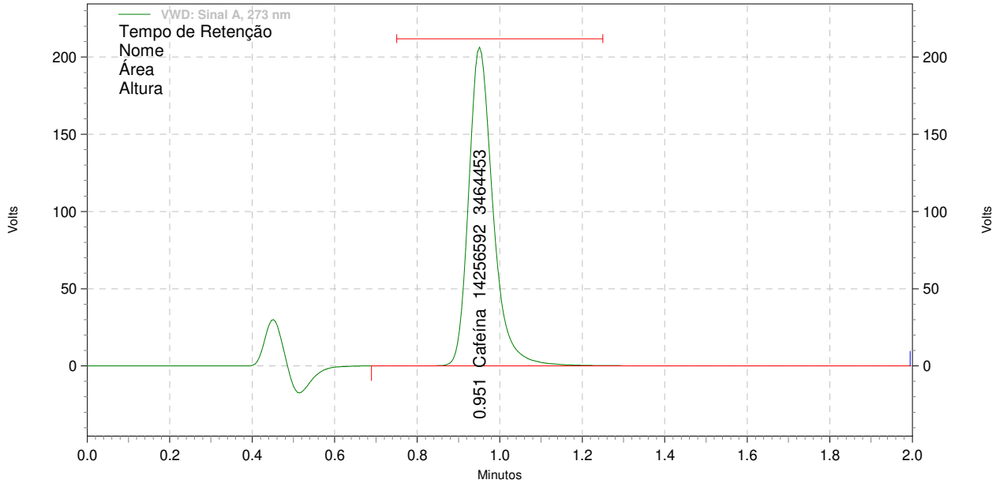


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14256592	3464453
Totais	14256592	3464453

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:36:19 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:25:02 AM (GMT -03-00)

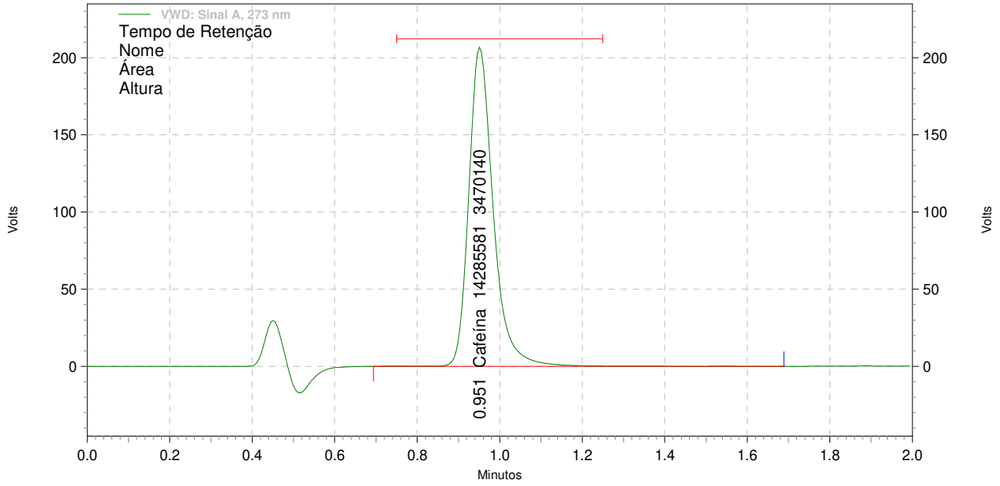


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14285581	3470140
Totais	14285581	3470140

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:39:04 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:25:22 AM (GMT -03-00)

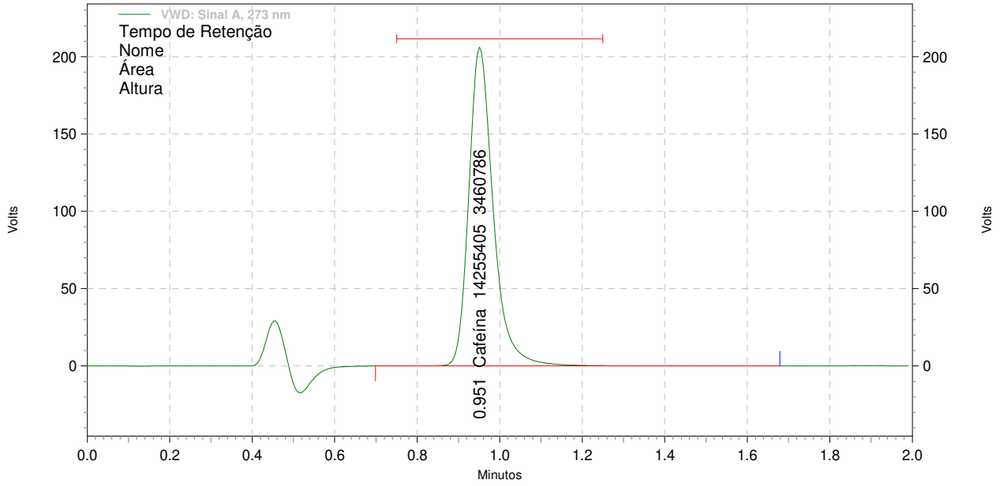


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14255405	3460786
Totais	14255405	3460786

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:41:48 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 9:25:39 AM (GMT -03:00)

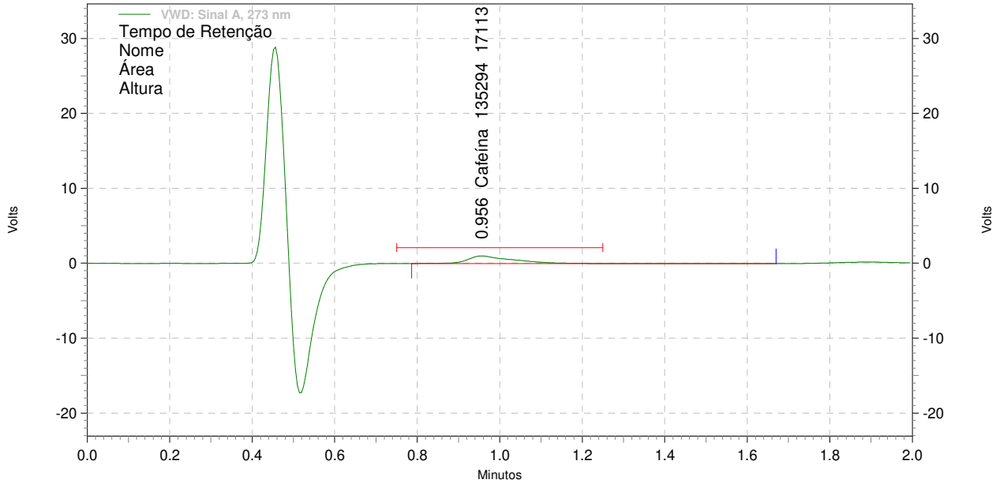


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	135294	17113
Totais	135294	17113

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:44:34 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:25:57 AM (GMT -03-00)

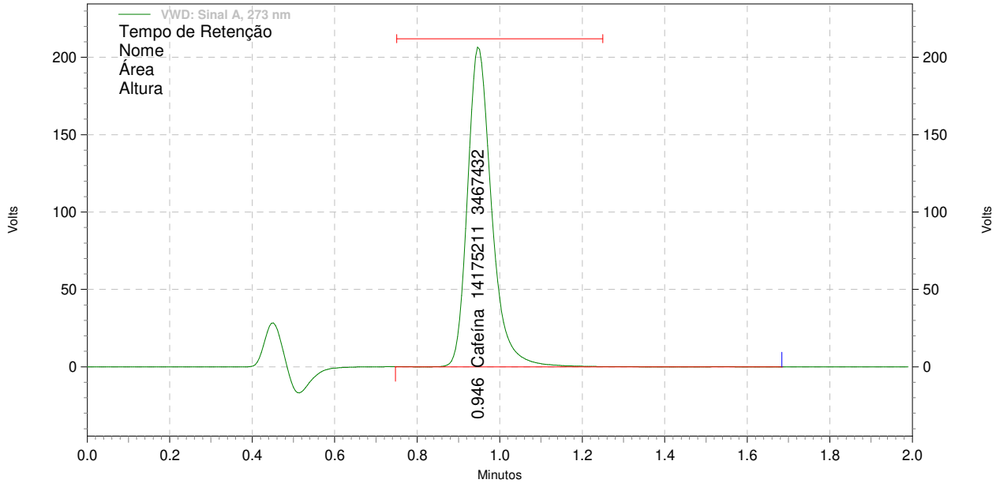


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14175211	3467432
Totais	14175211	3467432

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:47:17 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:26:33 AM (GMT -03-00)

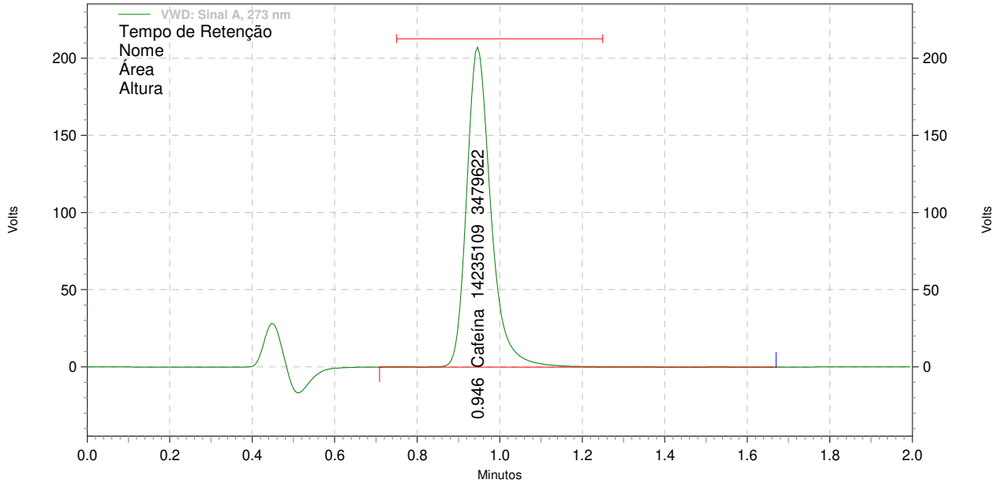


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14235109	3479622
Totais	14235109	3479622

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:50:01 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 9:26:49 AM (GMT -03:00)

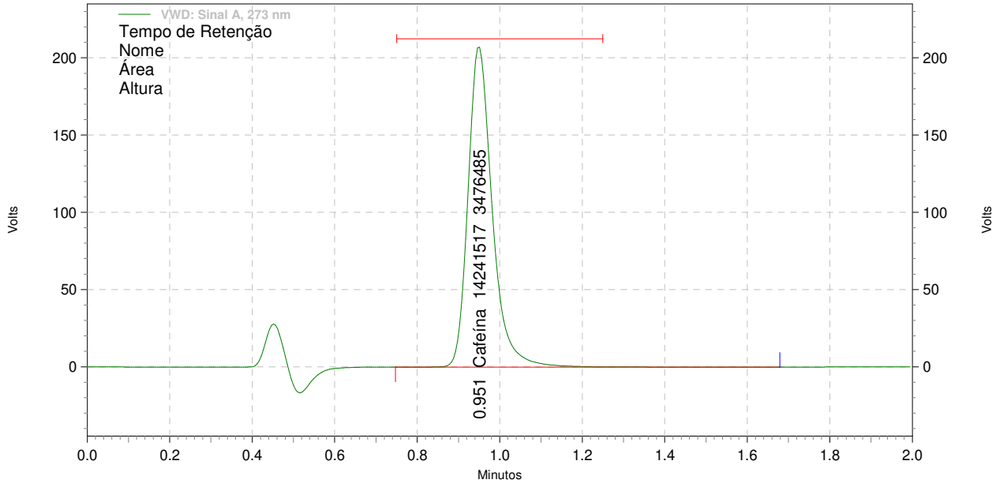


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14241517	3476485
Totais	14241517	3476485

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:52:45 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 9:27:13 AM (GMT -03:00)

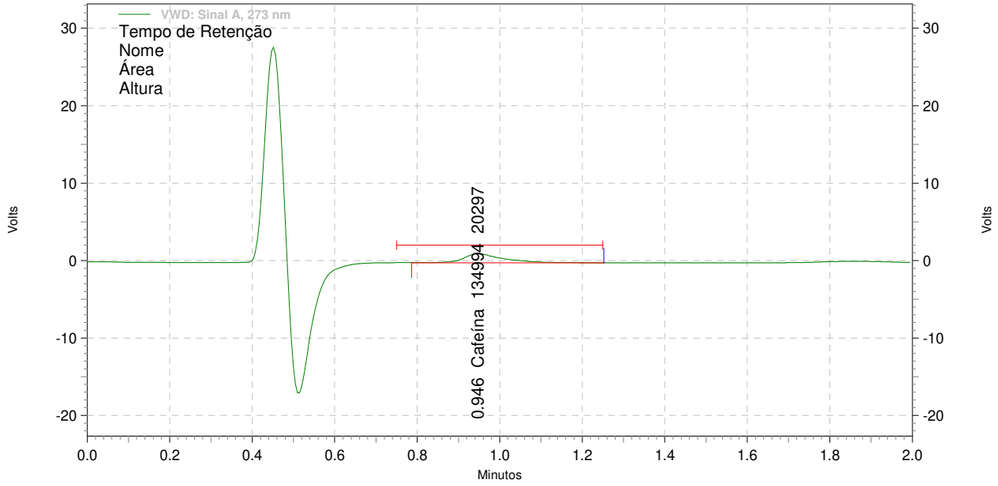


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	134994	20297
Totais	134994	20297

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:55:30 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 9:47:52 AM (GMT -03:00)

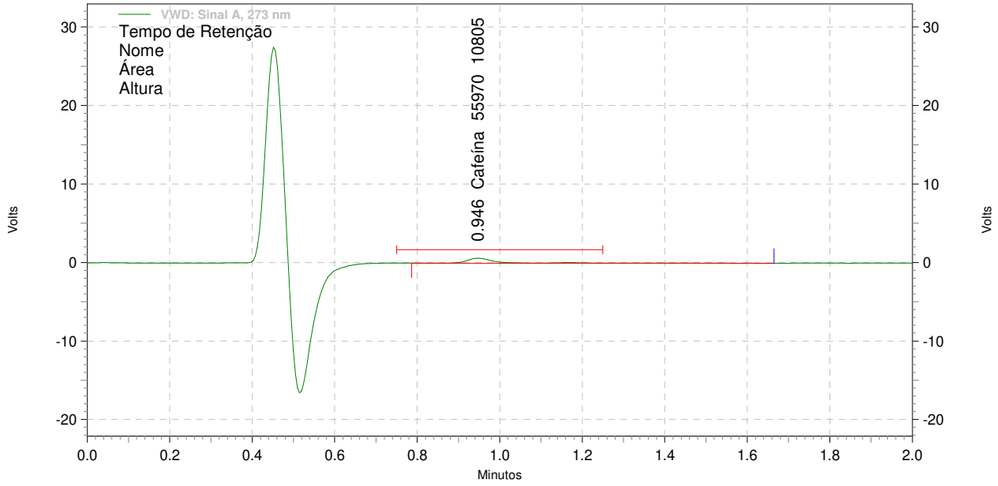


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	55970	10805
Totais	55970	10805

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 5:58:13 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:48:30 AM (GMT -03-00)

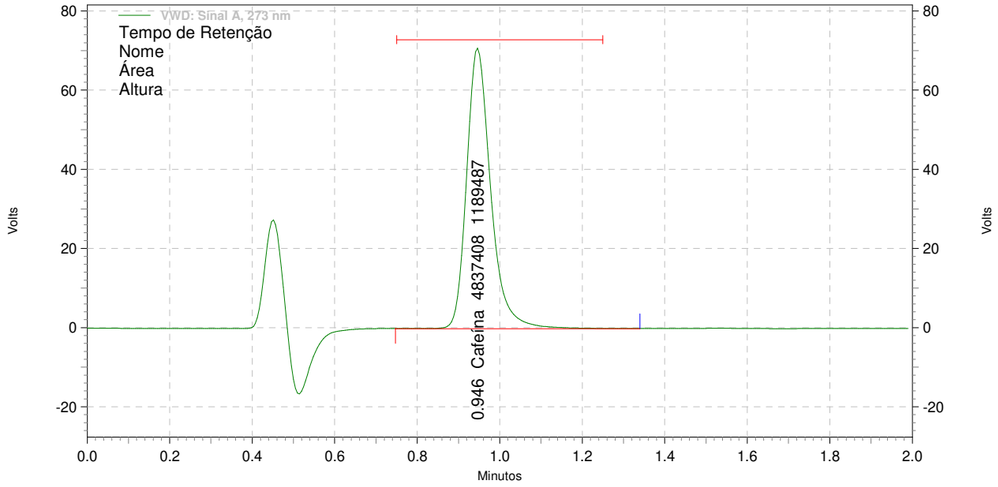


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	4837408	1189487
Totais	4837408	1189487

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:00:55 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:49:02 AM (GMT -03-00)

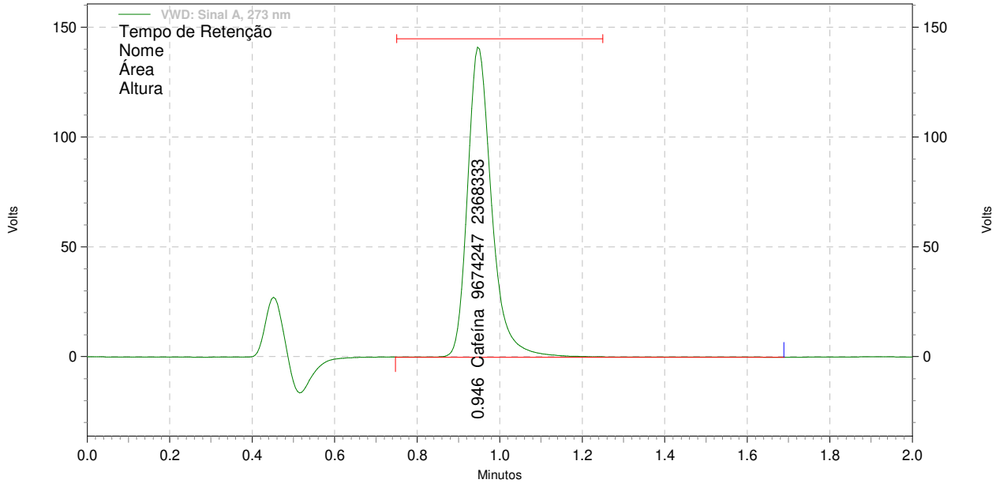


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	9674247	2368333
Totais	9674247	2368333

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:03:40 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:49:48 AM (GMT -03-00)

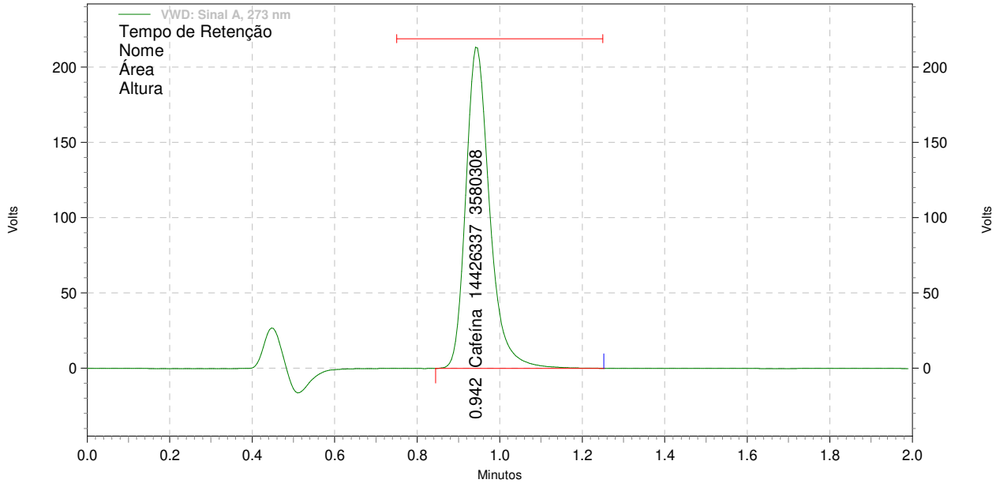


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14426337	3580308
Totais	14426337	3580308

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:06:24 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:50:11 AM (GMT -03-00)

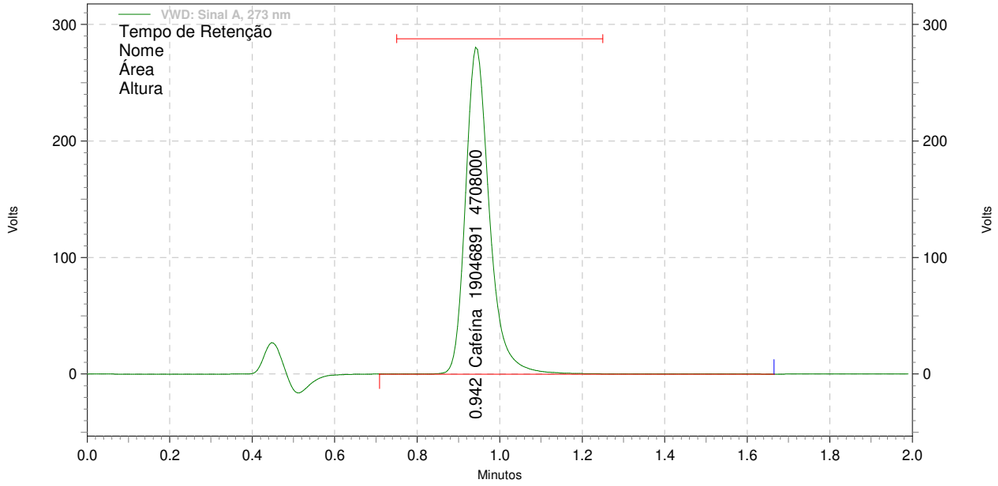


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	19046891	4708000
Totais	19046891	4708000

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:09:05 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:50:28 AM (GMT -03-00)

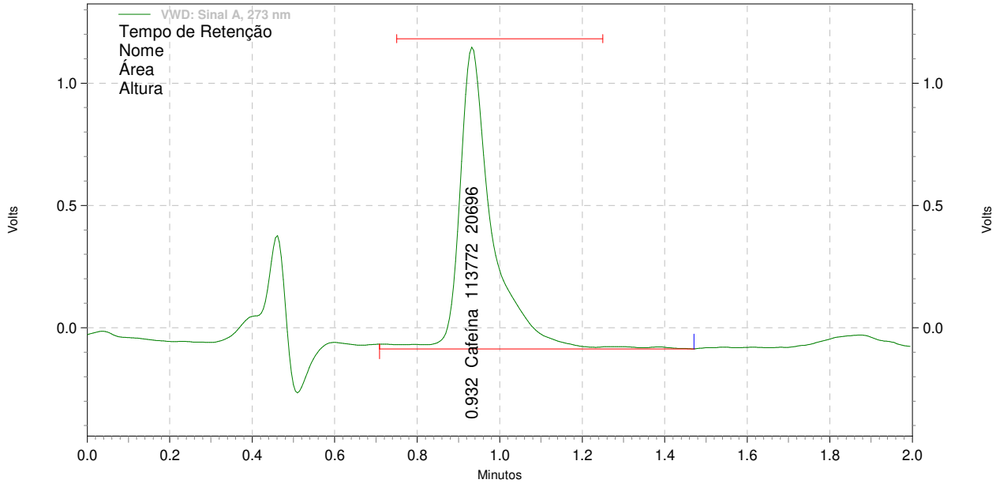


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	113772	20696
Totais	113772	20696

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:11:44 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:50:44 AM (GMT -03-00)

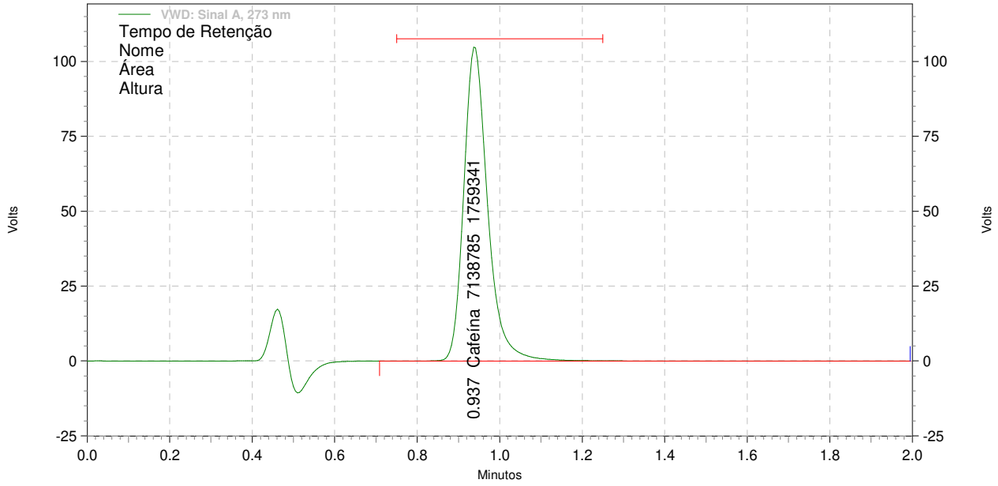


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	7138785	1759341
Totais	7138785	1759341

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:14:28 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:51:09 AM (GMT -03-00)

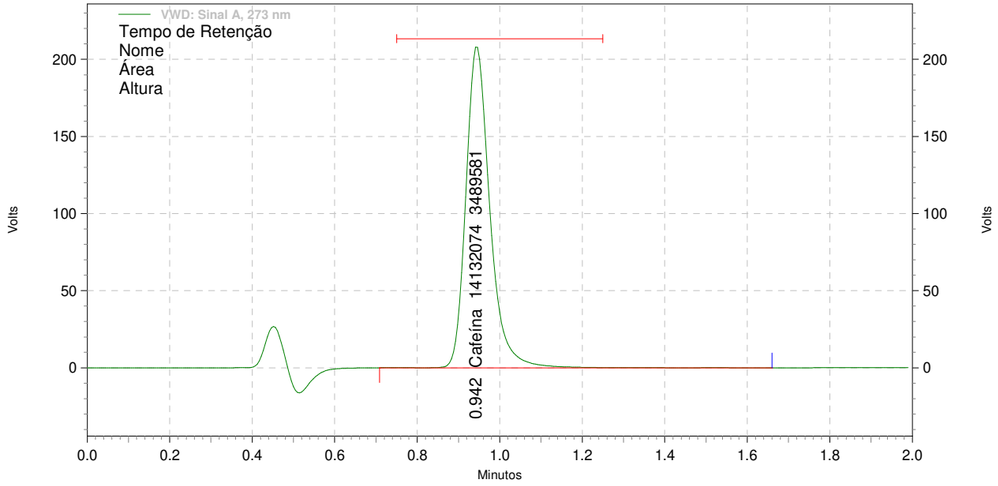


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	14132074	3489581
Totais	14132074	3489581

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:17:13 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:51:27 AM (GMT -03-00)

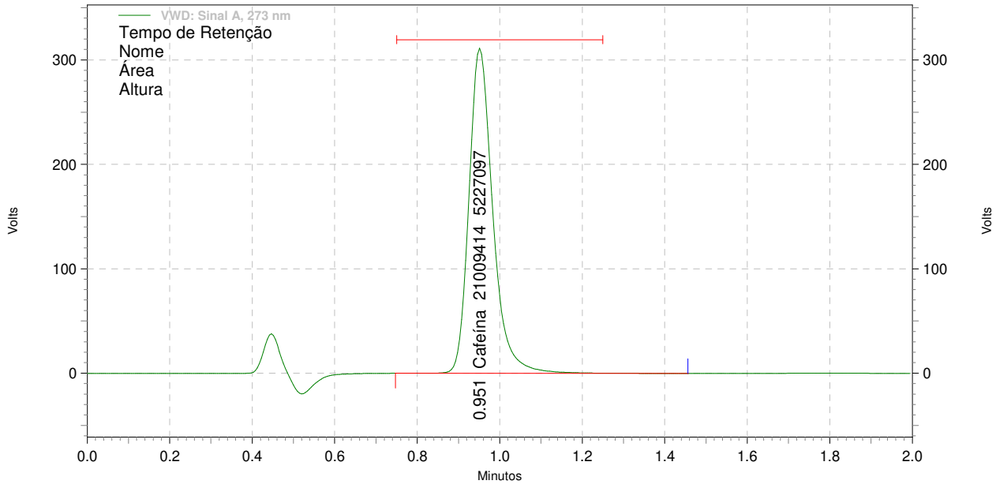


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	21009414	5227097
Totais	21009414	5227097

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 08-48-54 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\Qualificação 2025_VWD.met
Adquirido: 2/19/2025 6:20:04 PM (GMT -03-00)
Impresso: 2/20/2025 9:51:56 AM (GMT -03-00)

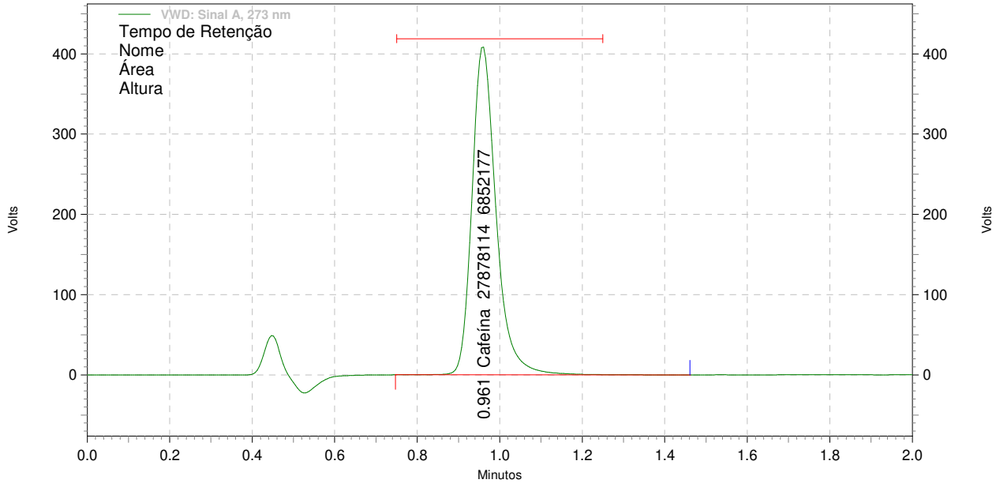

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	27878114	6852177
Totais	27878114	6852177

Relatório de Adequação do Sistema

Nome da Sequência : C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\2025-02-20 15-01-01 (GMT -03-00).rslt\2025-02-20 15-01-01 (GMT -03-00).rst
Usuário : Sistema (Jean)
Impresso : 2/20/2025 3:04:46 PM (GMT -03:00)


ID Amostra	Nome Arquivo Dados
RELB	RELB.dat

O sistema é Compatível

VWD: Sinal A, 250 nm	ID Amostra	Teste	Iniciar(Min)	Parar(Min)	Threshold	Resultado	Status
	RELB	Desvio	5.000	20.000	5.00000000	0.00129541	Aprovado
	RELB	Ruído ASTM curto (com escala)	5.000	20.000	0.50000000	0.01235908	Aprovado

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 11-12-42 (GMT -03-00).rslt\RELB.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\RELB VWD.met
Adquirido: 2/20/2025 10:38:45 AM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 11:17:39 AM (GMT -03:00)

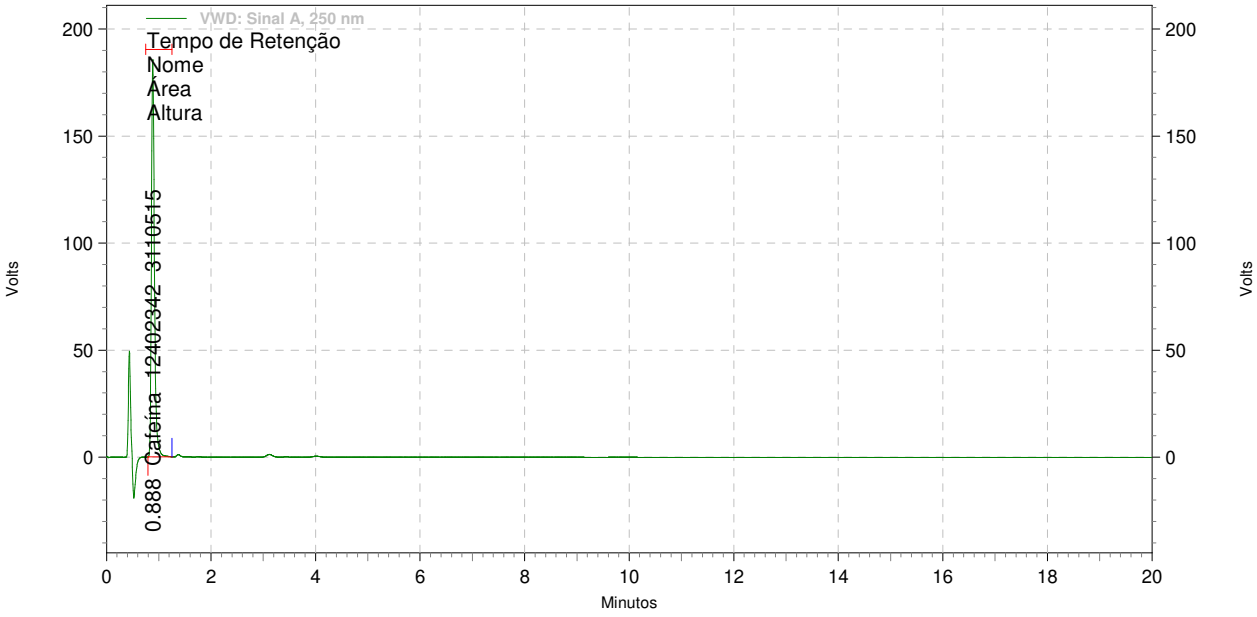


Resultados VWD: Sinal A, 250 nm

Nome	Área	Altura
Cafeína	12402342	3110515
Totais	12402342	3110515

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 14-26-26 (GMT -03-00).rslt\GRABO AB-Rep3.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\GRABO AB VWD.met
Adquirido: 2/20/2025 12:23:41 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 2:27:21 PM (GMT -03:00)

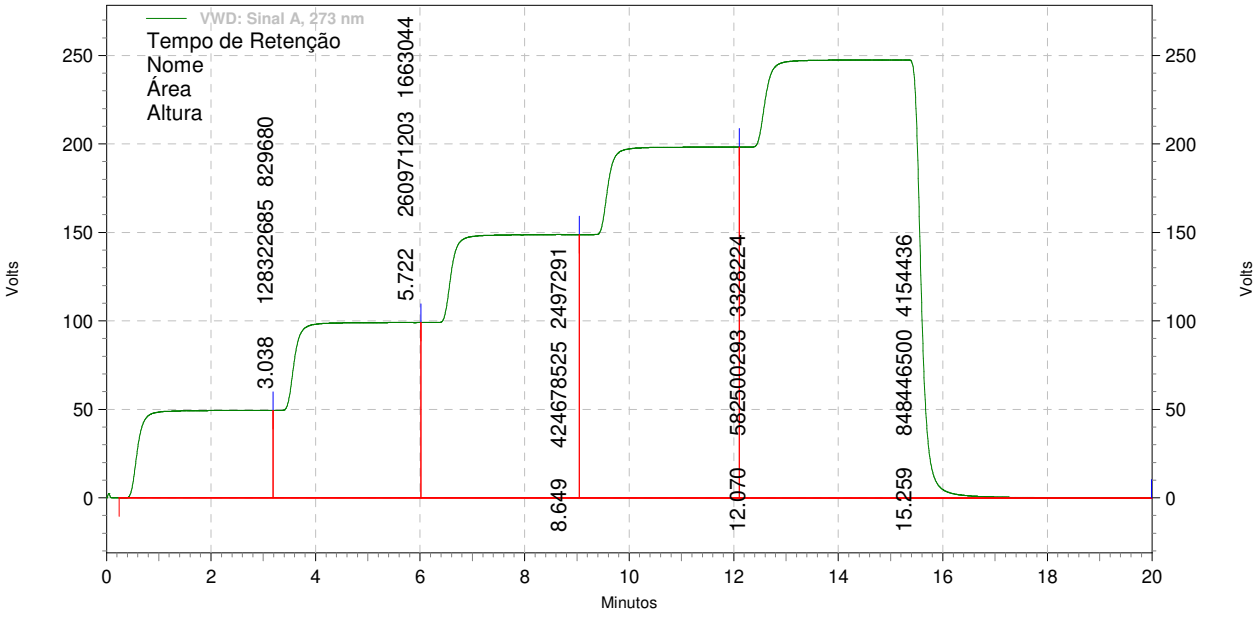


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
	128322685	829680
	260971203	1663044
	424678525	2497291
	582500293	3328224
	848446500	4154436

Totais	2244919206	12472675

Qualificação

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Result\HPLC0002 VWD.43 2025-02-20 15-38-42 (GMT -03-00).rslt\GRABO AB-Rep3.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qulaificação\Method\GRABO AB VWD.met
Adquirido: 2/20/2025 12:23:41 PM (GMT -03:00)
Impresso: 2/20/2025 3:39:42 PM (GMT -03:00)

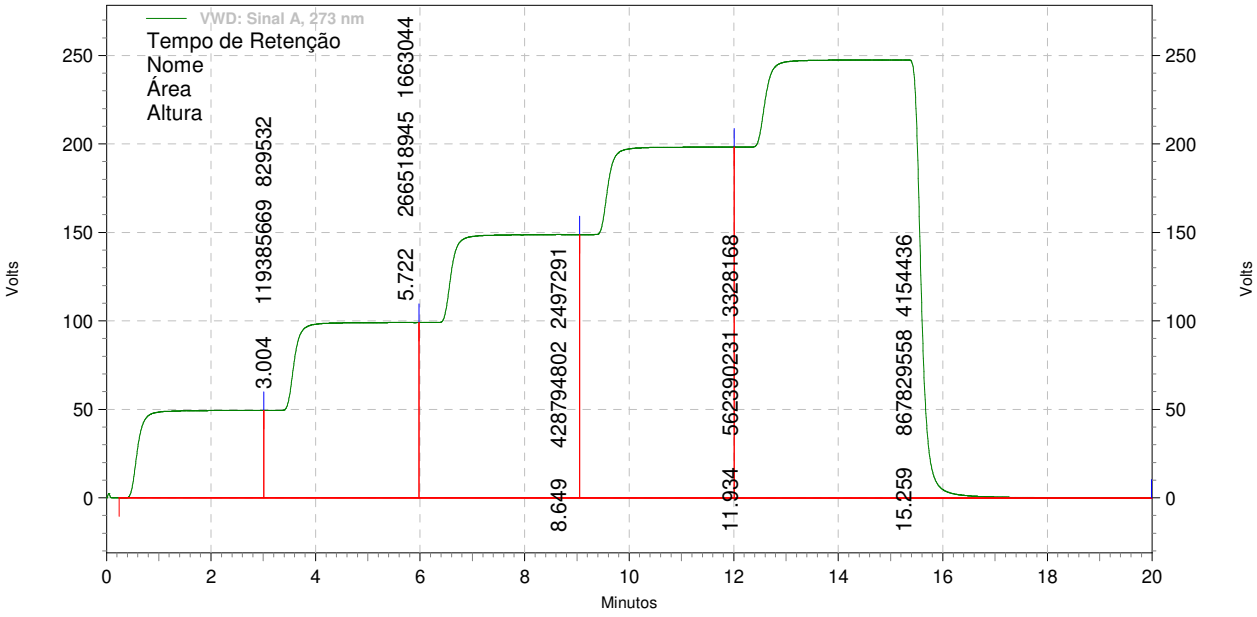

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Nome	Área	Altura
	119385669	829532
	266518945	1663044
	428794802	2497291
	562390231	3328168
	867829558	4154436

Totais	2244919205	12472471