Tasks

Lab Advisor

System Overview

Configuration

Apps

Firmware Update

Logs & Results

teste 3

Service & Diagnostics

Instrument Control

EMFs

Firmware Update Report

System Report

Help

Context Help (F1)


Help Topics

What's New?

Spectral Scan - VWD [JP72003679]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

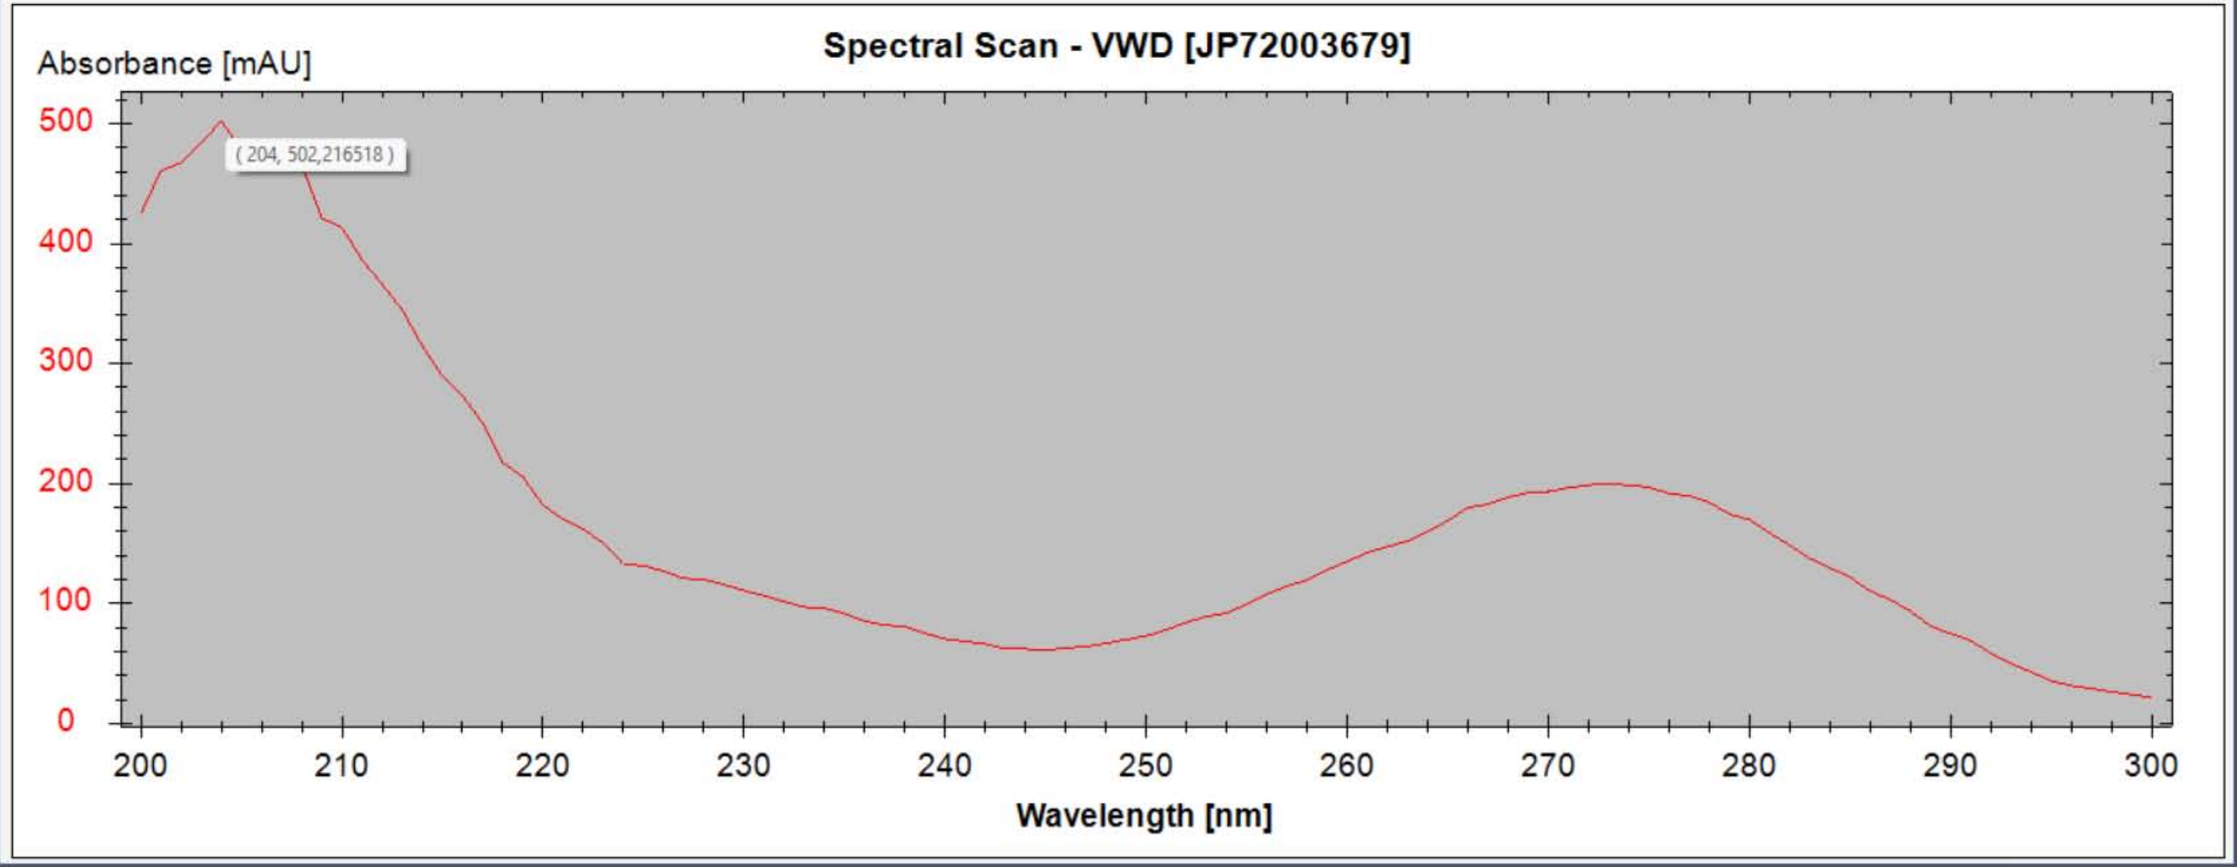

more... | Print Result | Back

Tasks

Lab Advisor

System Overview

Configuration

Apps

Firmware Update

Logs & Results

teste 3

Service & Diagnostics

Instrument Control

EMFs

Firmware Update Report

System Report

Help

Context Help (F1)


Help Topics

What's New?

Spectral Scan - VWD [JP72003679]

UV Lamp On | Blank Scan

Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

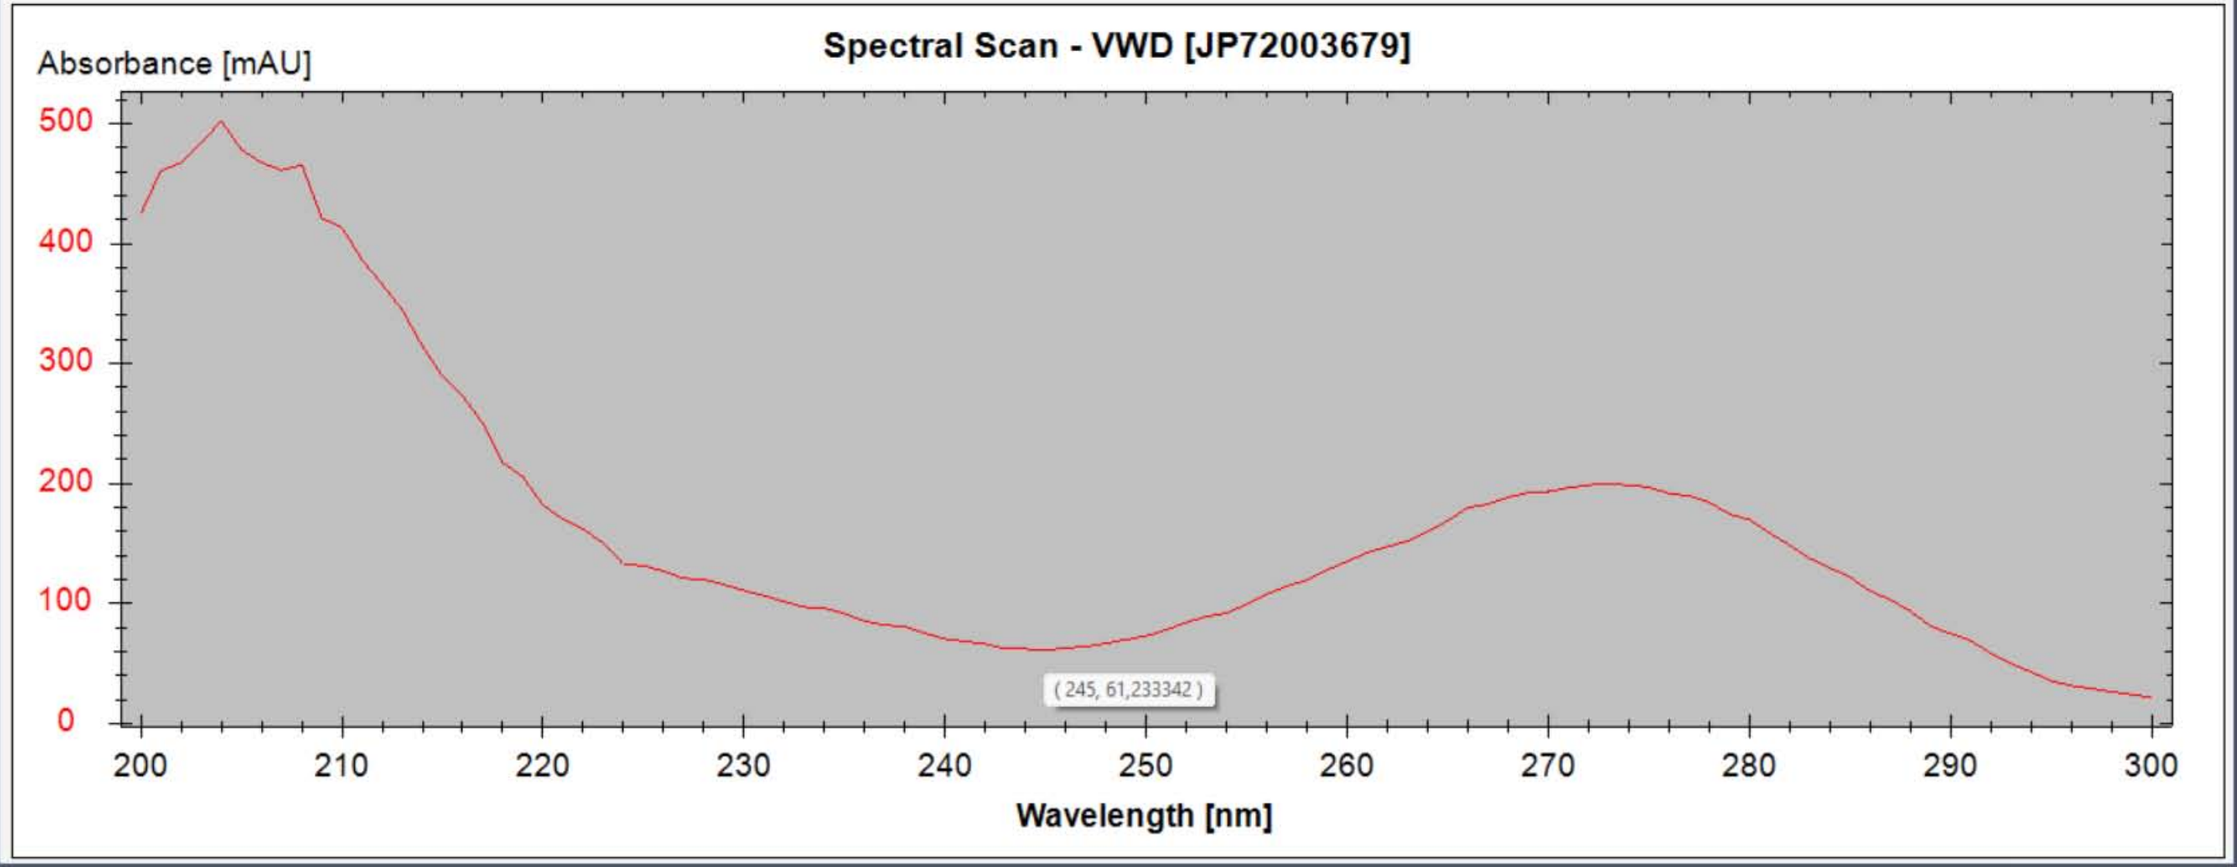

more... | Print Result | Back

Tasks

Lab Advisor

System Overview

Configuration

Apps

Firmware Update

Logs & Results

teste 3

Service & Diagnostics

Instrument Control

EMFs

Firmware Update Report

System Report

Help

Context Help (F1)


Help Topics

What's New?


Spectral Scan - VWD [JP72003679]


UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

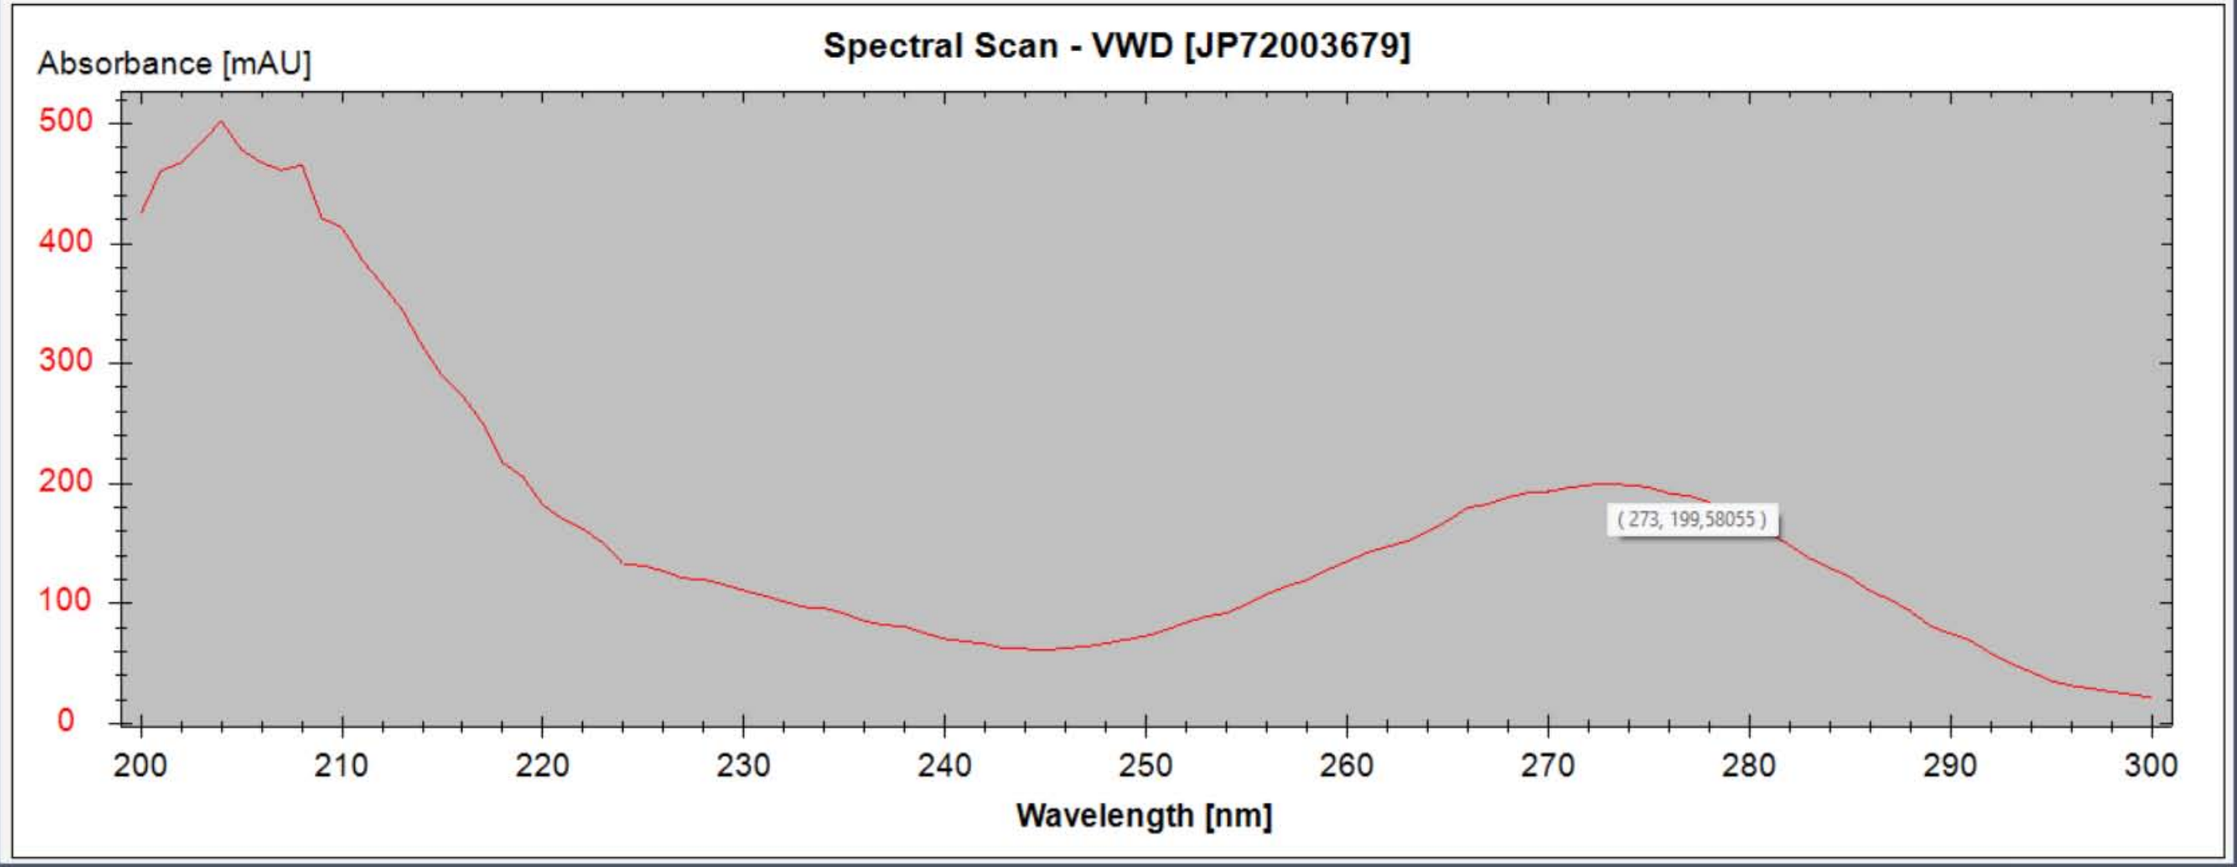

more... | Print Result | Back

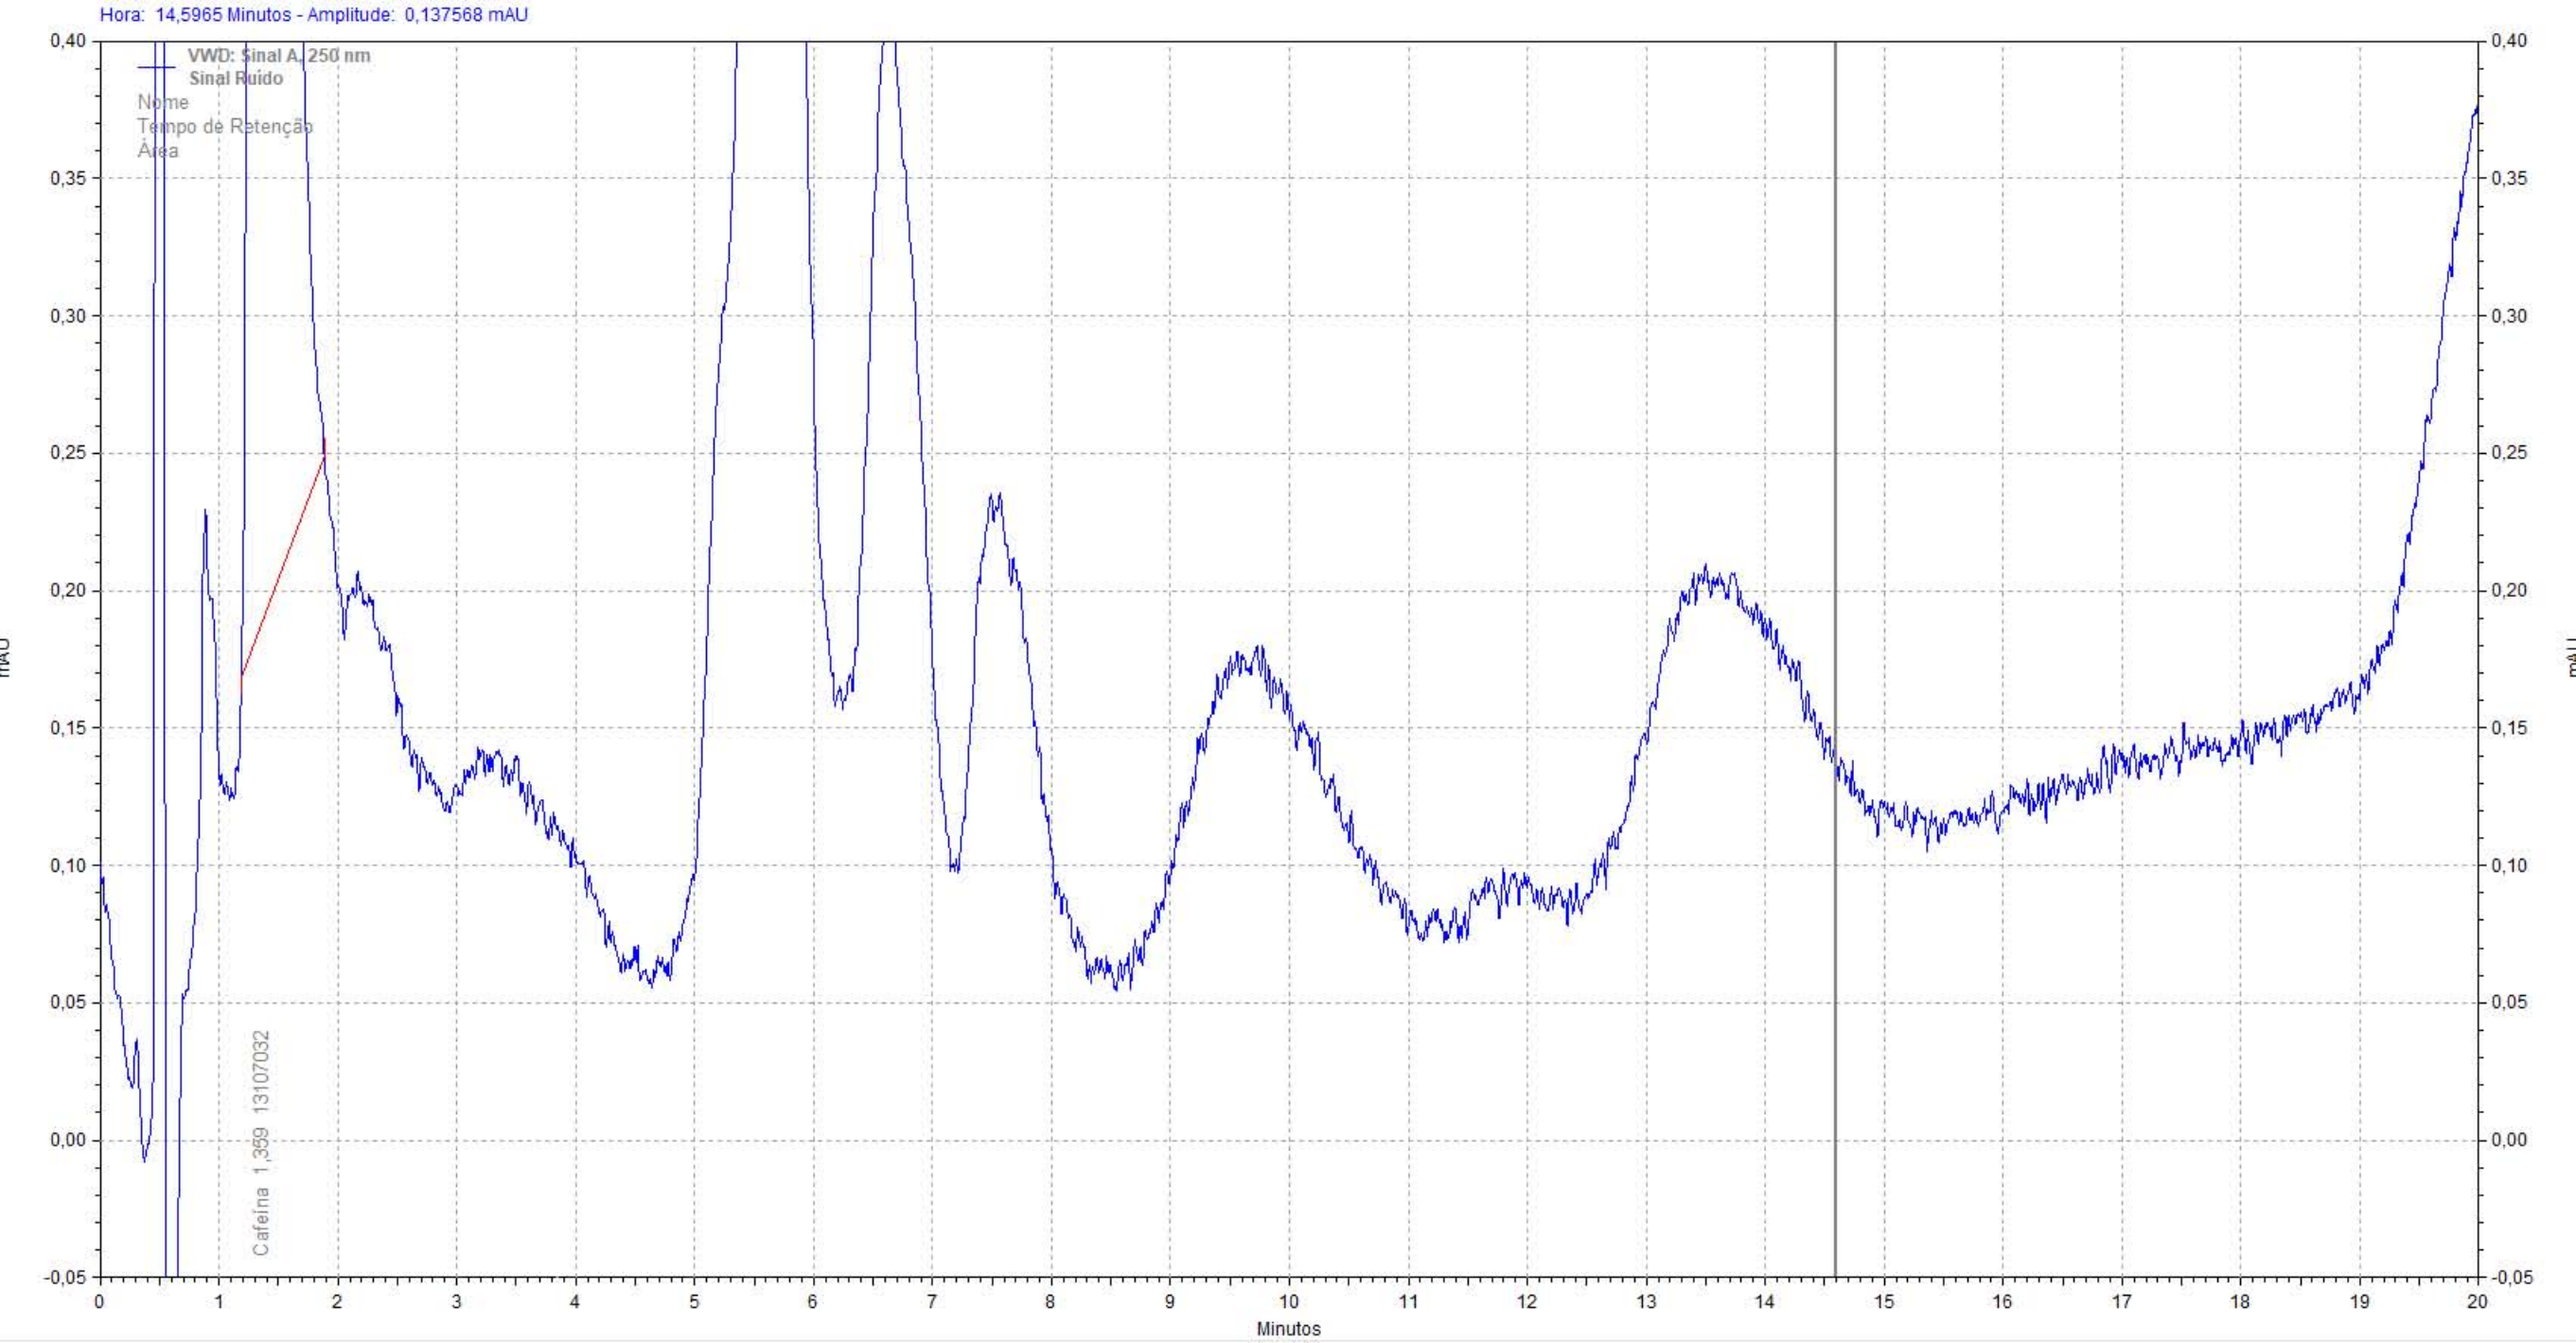

Hora: 14,5965 Minutos - Amplitude: 0,137568 mAU
VWD: Sinal A, 250 nm
Sinal Ruído
Nome
Tempo de Retenção
Área
Cafeína 1,359 13107032
mAU
Minutos
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,05
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

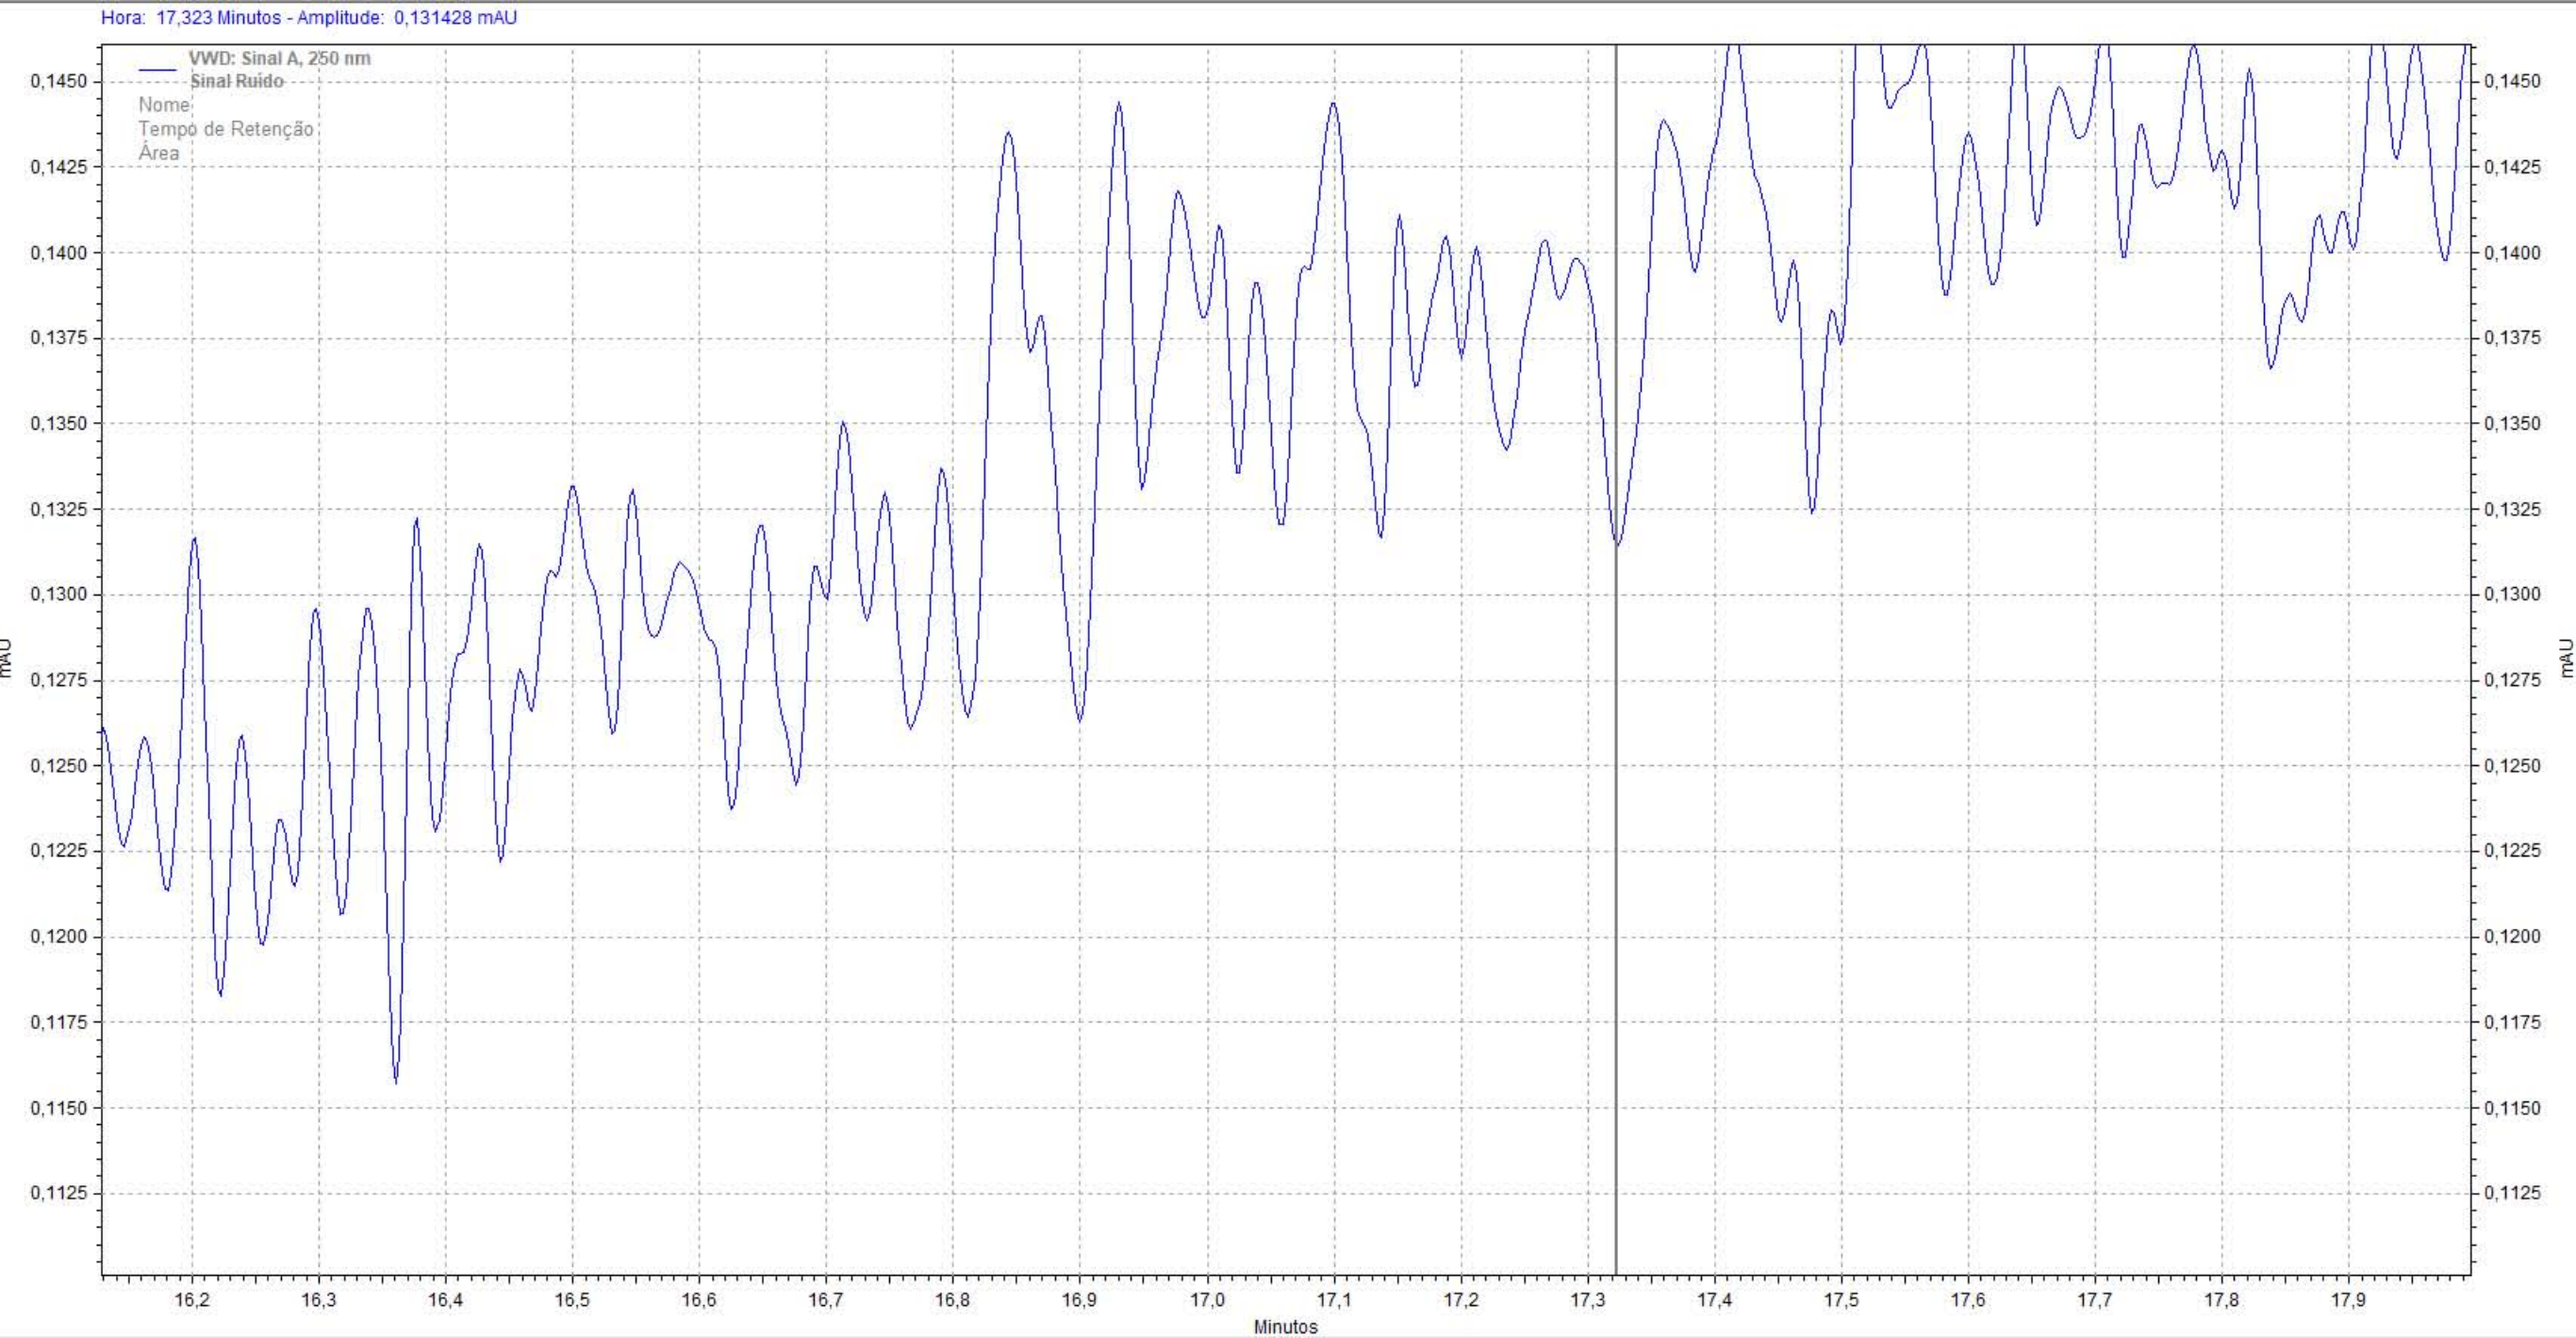
Hora: 17,323 Minutos - Amplitude: 0,131428 mAU
VWD: Sinal A, 250 nm
Sinal Ruído
Nome
Tempo de Retenção
Área
mAU
0,1450
0,1425
0,1400
0,1375
0,1350
0,1325
0,1300
0,1275
0,1250
0,1225
0,1200
0,1175
0,1150
0,1125
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
Minutos

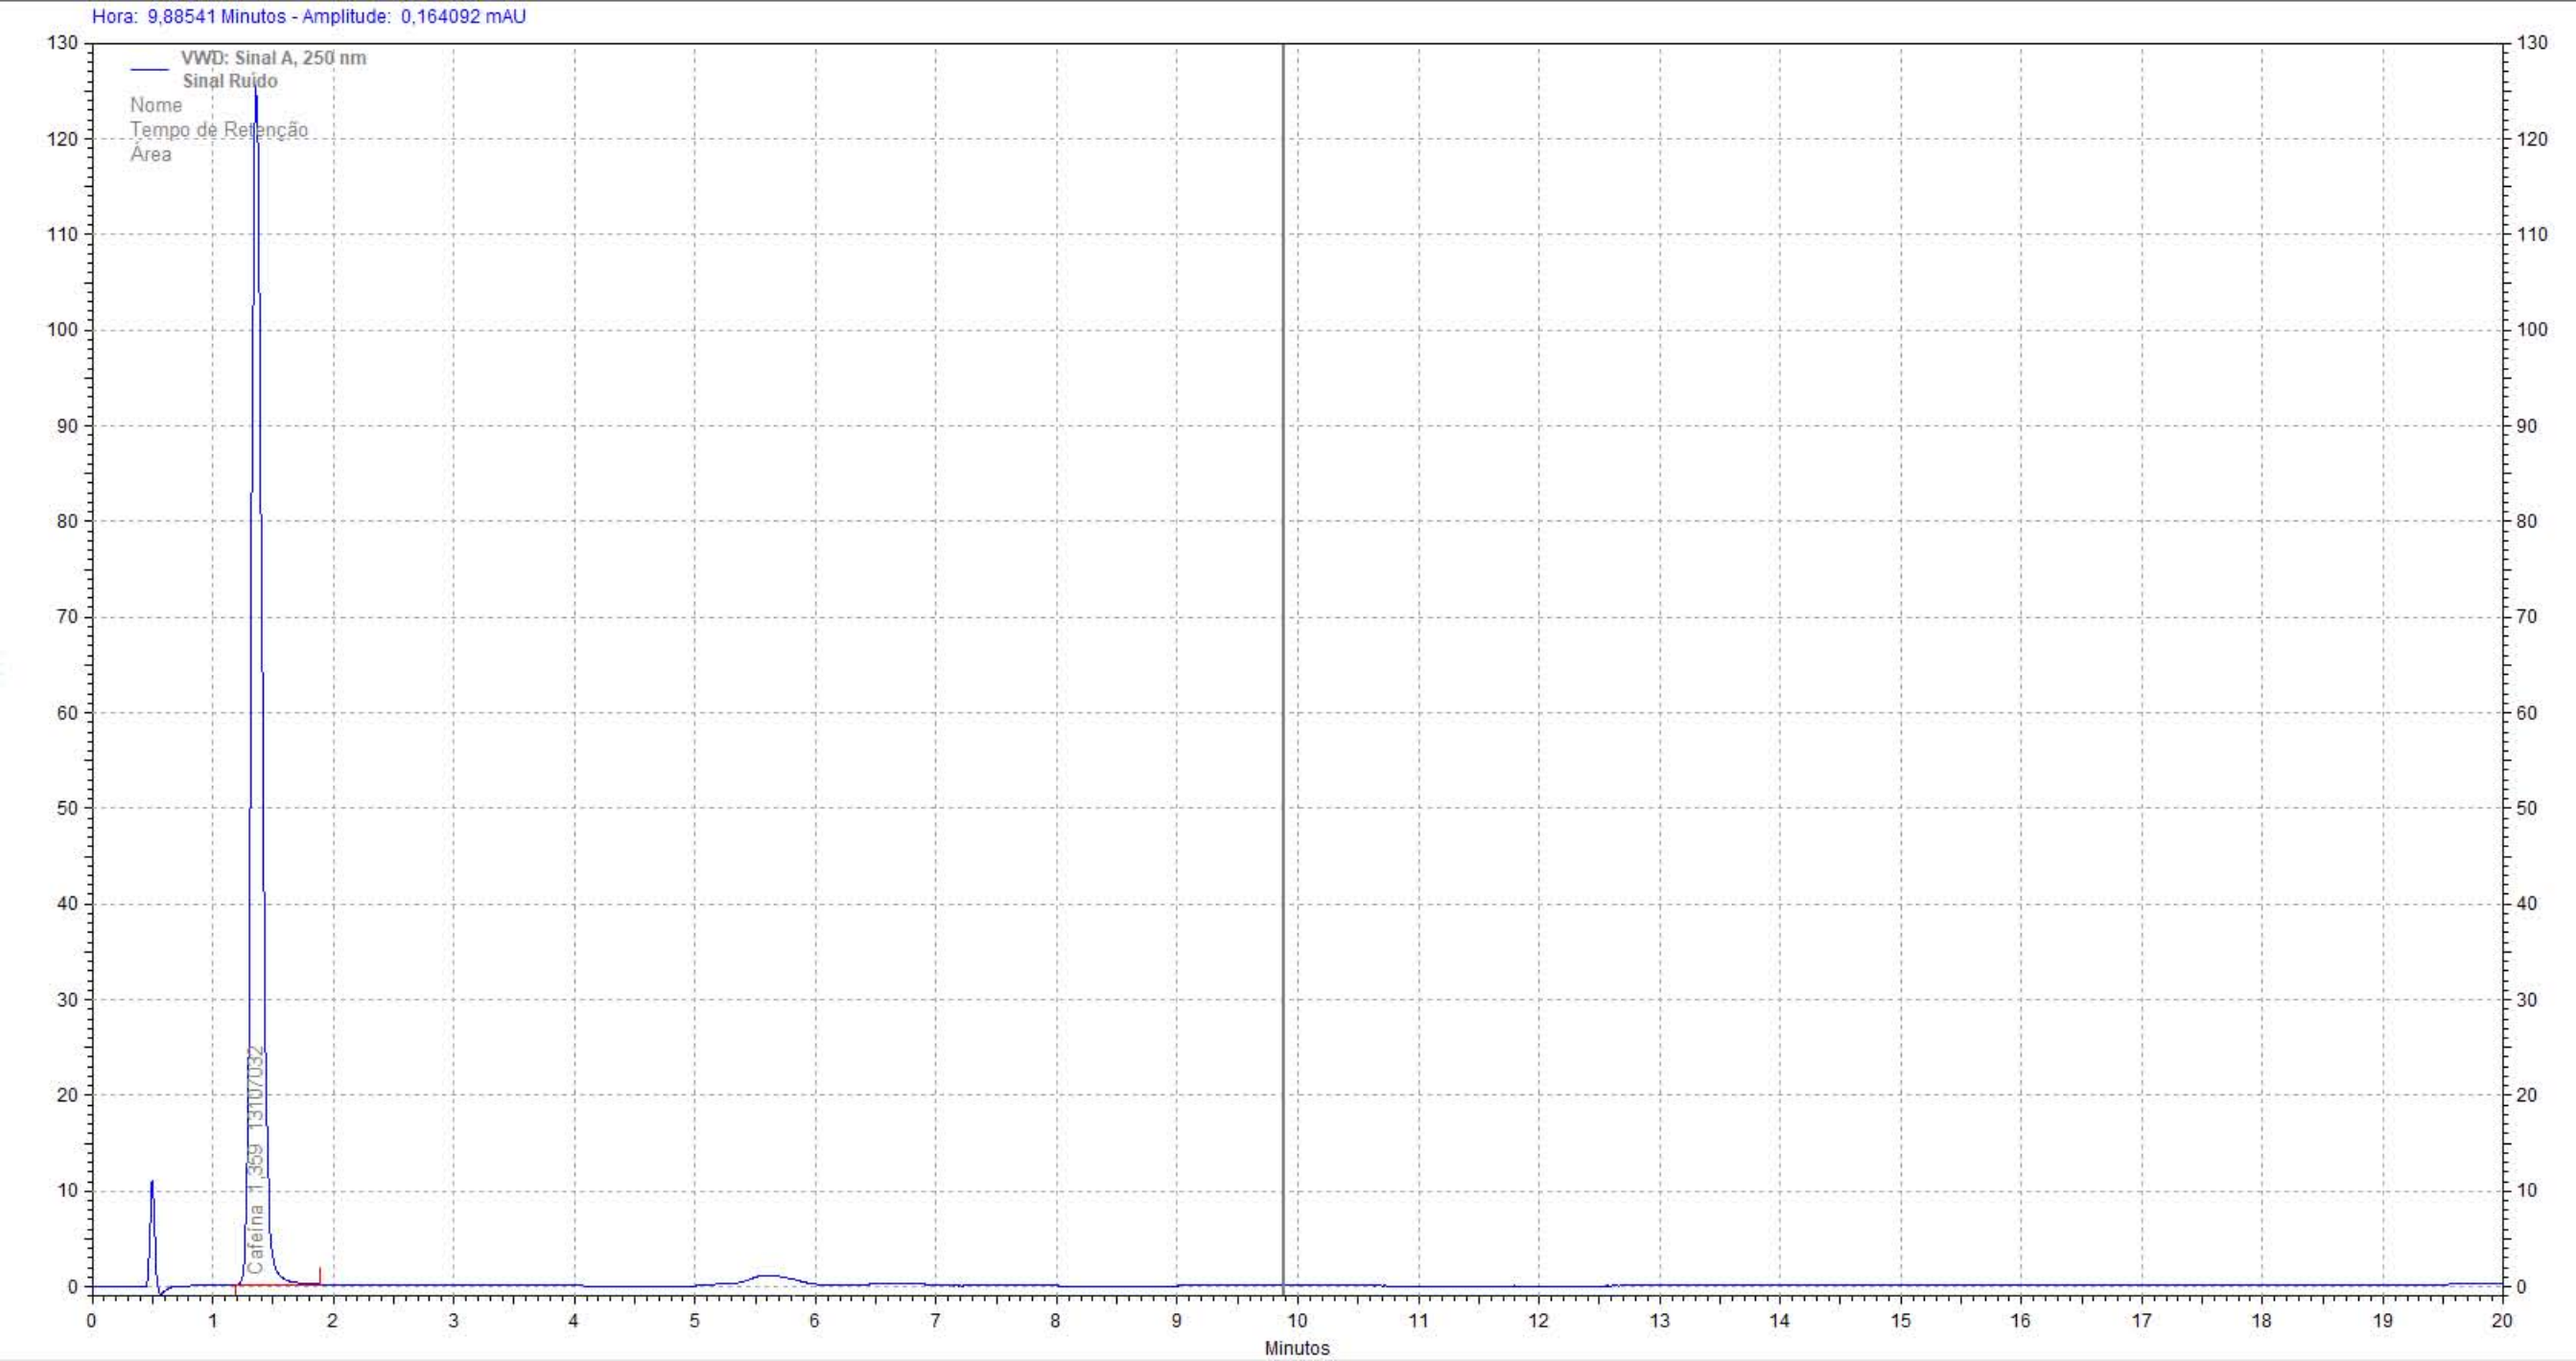
Hora: 9,88541 Minutos - Amplitude: 0,164092 mAU
VWD: Sinal A, 250 nm
Sinal Ruído
Nome
Tempo de Retenção
Área
Cafeína 1,359 1310/032
Minutos

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Result\LDUV.seq2023-03-02 09-26-44 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01.dat
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/03/2023 09:28:17 (GMT -03:00)
Impresso: 13/03/2023 09:34:45 (GMT -03:00)

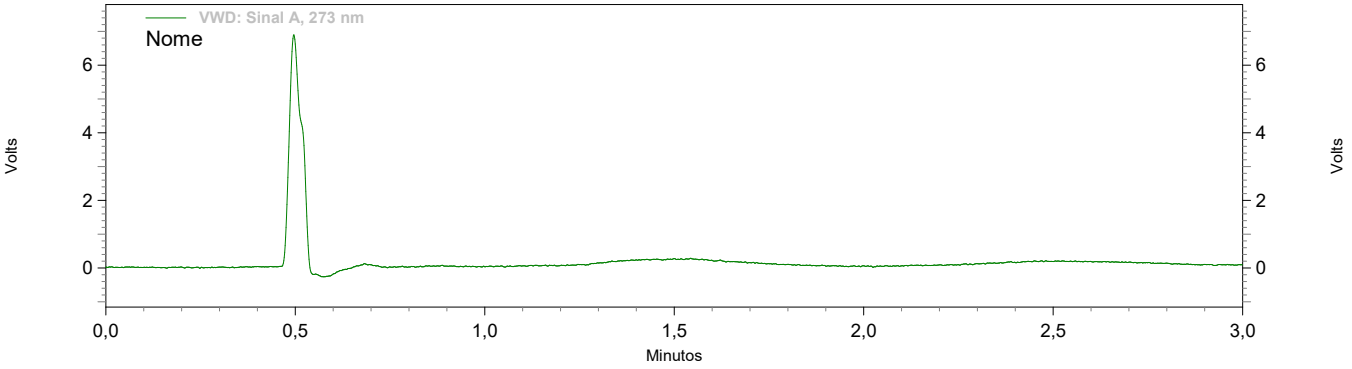


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Result\LDUV.seq2023-03-02 09-26-44 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/03/2023 09:32:18 (GMT -03:00)
Impresso: 13/03/2023 09:35:55 (GMT -03:00)

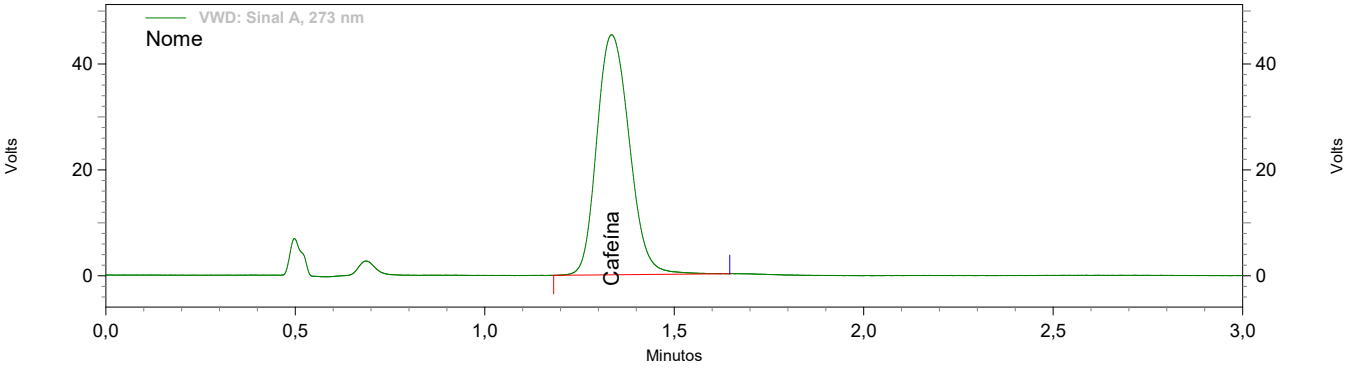


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,335	4543607	**0,000**
Totais			4543607	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Result\LDUV.seq2023-03-02 09-26-44 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/03/2023 09:36:14 (GMT -03:00)
Impresso: 13/03/2023 09:36:20 (GMT -03:00)

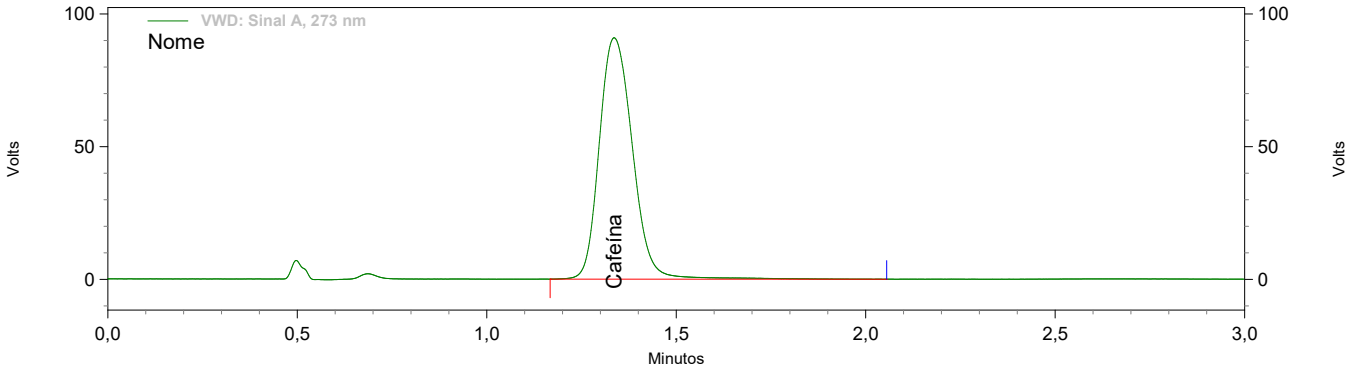


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,336	9310270	**0,000**
Totais			9310270	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Result\LDUV.seq2023-03-02 09-26-44 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/03/2023 09:40:10 (GMT -03:00)
Impresso: 13/03/2023 09:36:49 (GMT -03:00)

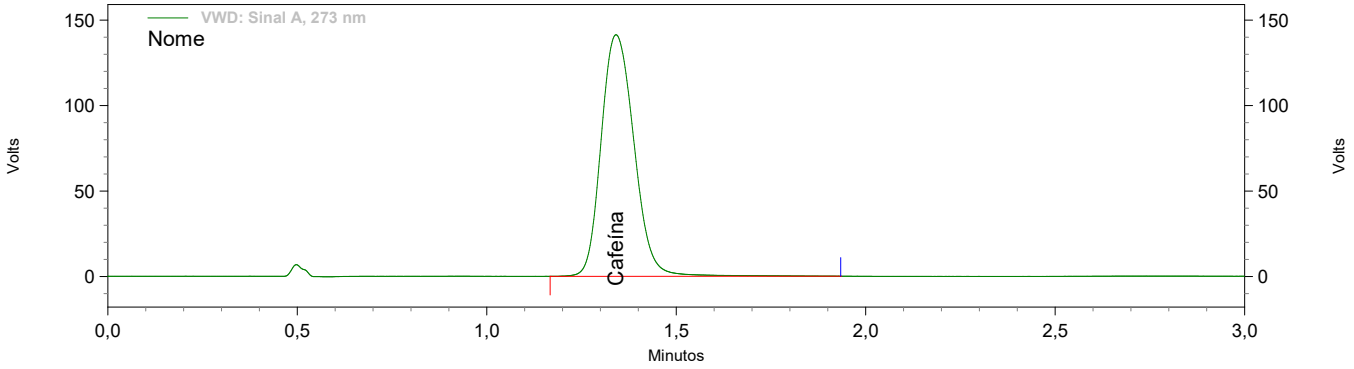


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,341	14341915	**0,000**

Totais			14341915	**0,000**

Relatório de Normalização

Método: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Method\Qualificação.met
Arquivo de dados: C:\Users\Mateus\Desktop\Atendimentos\Alltech\Openlab\Result\LDUV.seq2023-03-02 09-26-44 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05
Usuário: SISTEMA (SISTEMA)
Adquirido: 02/03/2023 09:44:06 (GMT -03:00)
Impresso: 13/03/2023 09:37:24 (GMT -03:00)

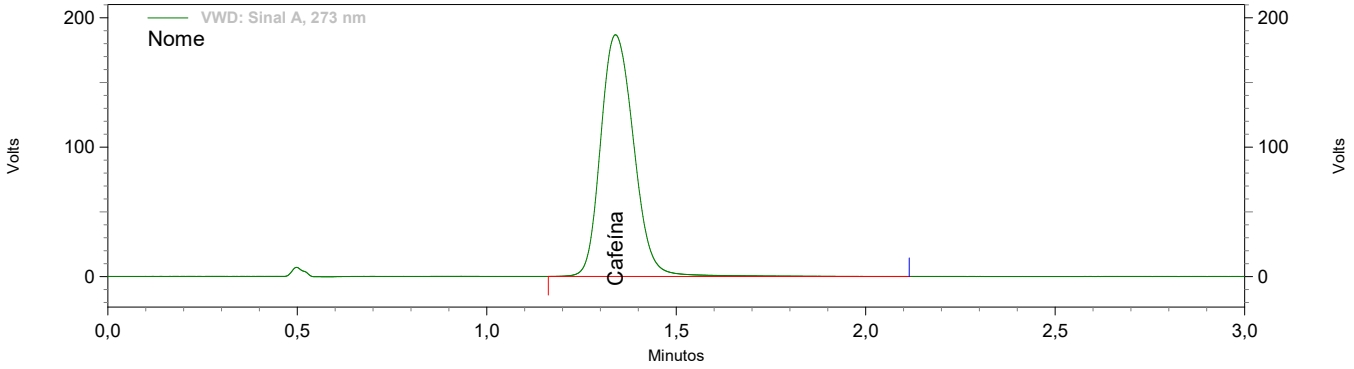

Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeína	1,340	19054106	**0,000**

Totais			19054106	**0,000**