

Teste de Precisão do Injetor - EDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\EDUVHPL34_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:04:50 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:01:01 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL34 (Off-line)	Amostra:	EDUV
Vial:	1	Volume:	10 µL

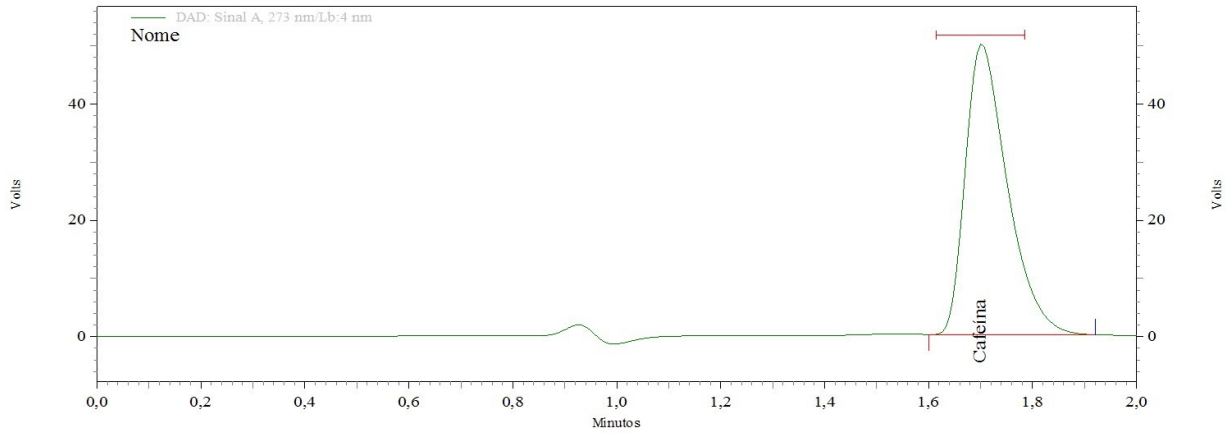

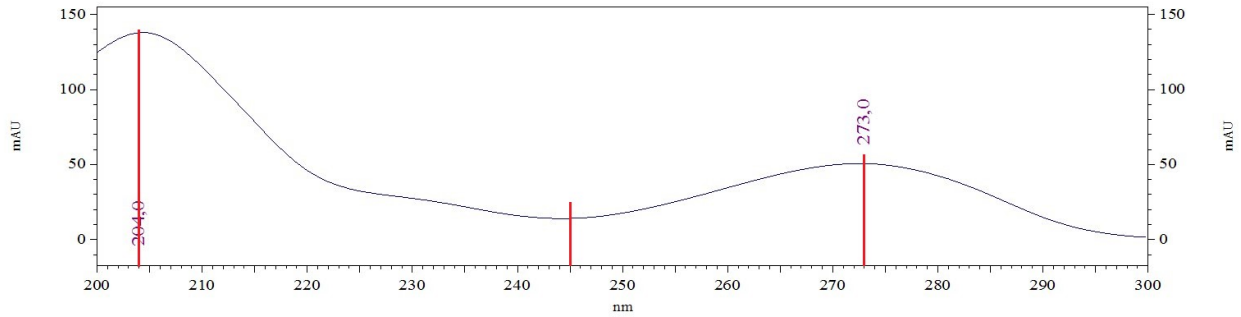


Channel A

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\BRANCO_01HPL34_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:07:58 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:02:12 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL34 (Off-line)	Amostra:	BRANCO_01
Vial:	2	Volume:	10 µL

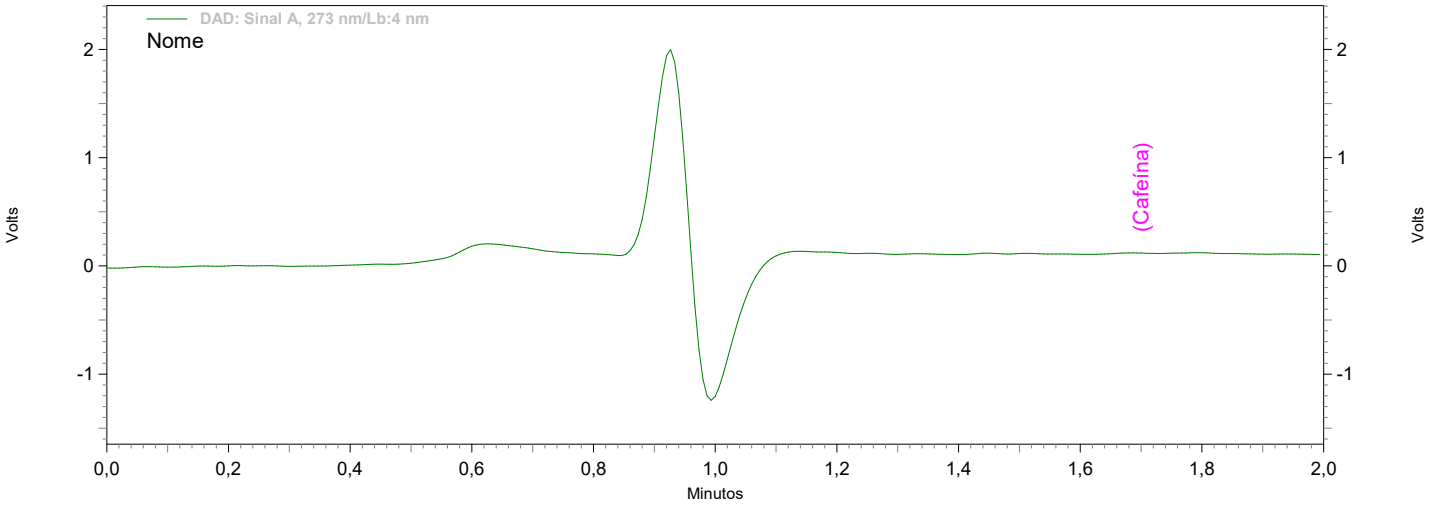

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL

Totais			

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_01HPL34_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:11:07 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:52:29 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_01
Vial: 3 Volume: 10 µL

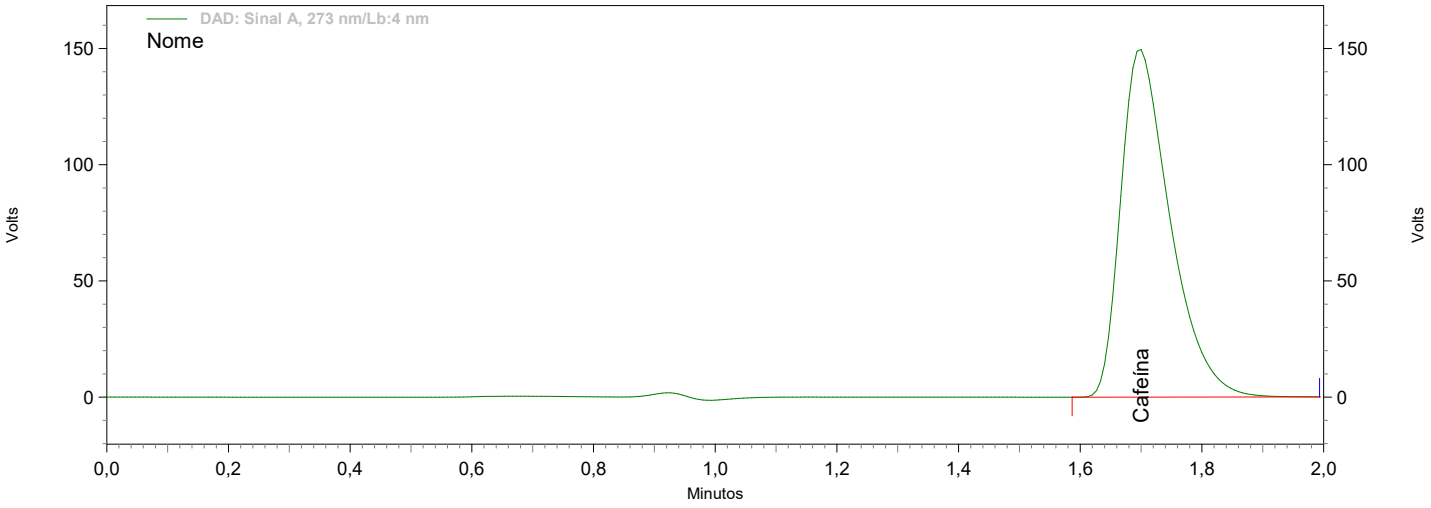

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1769524	0,000
Totais		1769524	0,000

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_02HPL34_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:14:13 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:52:45 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_02
Vial: 3 Volume: 10 µL

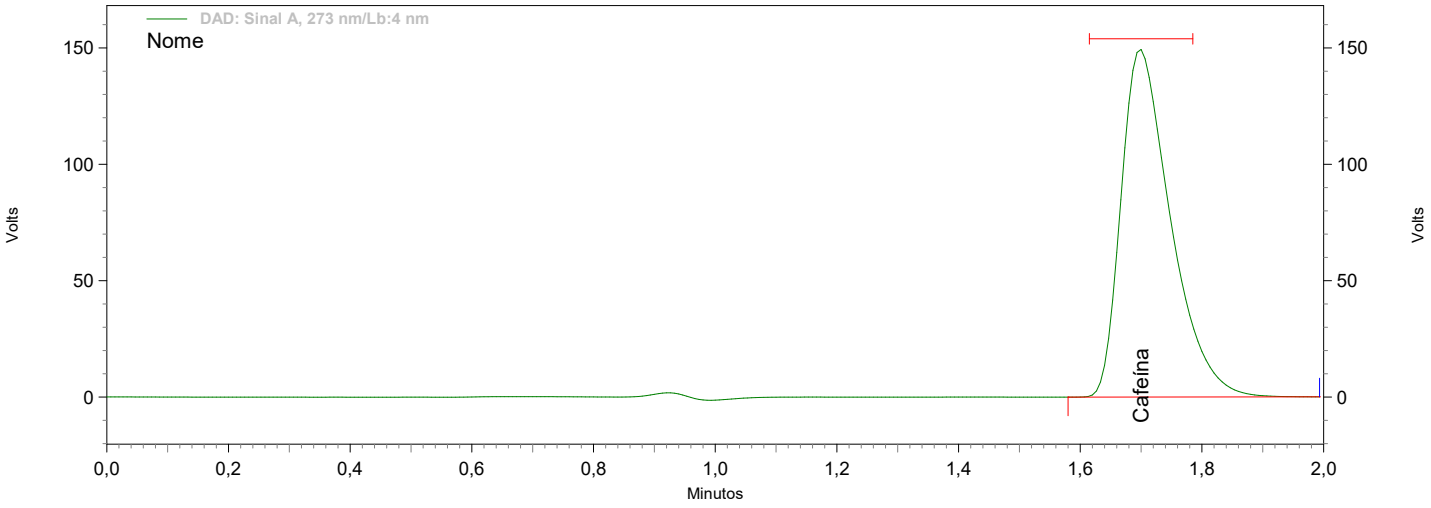

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1770210	0,000
Totais		1770210	0,000

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_03HPL34_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:17:22 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:53:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_03
Vial: 3 Volume: 10 µL

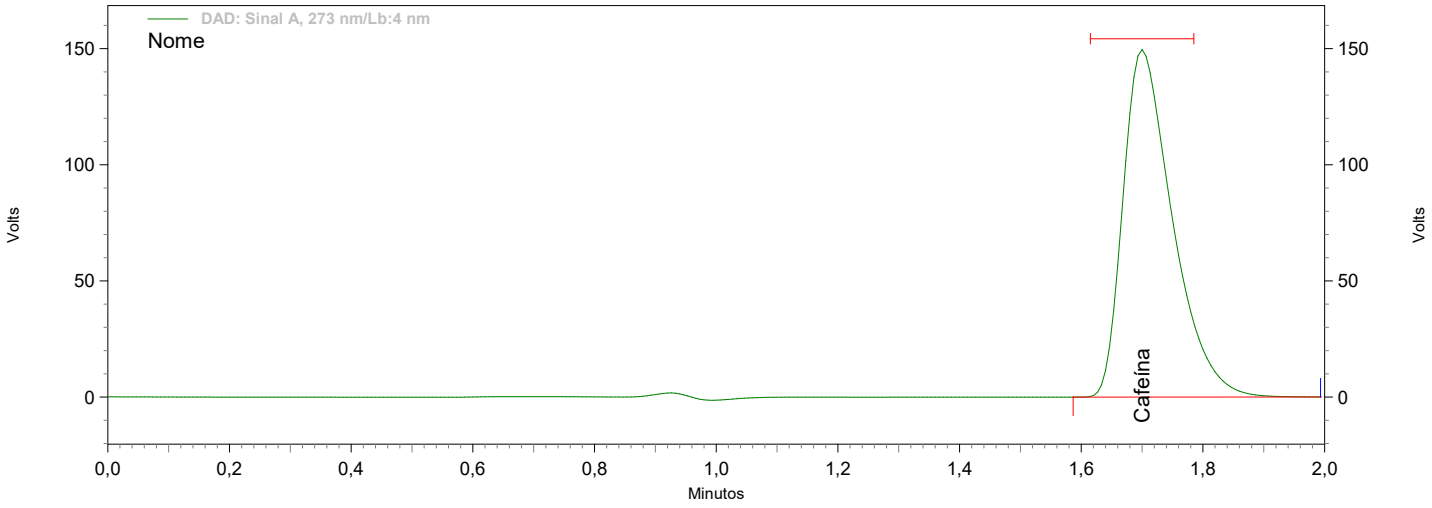

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1770771	0,000
Totais		1770771	0,000

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\BRANCO_02HPL34_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:20:32 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:53:15 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: BRANCO_02
Vial: 2 Volume: 10 µL

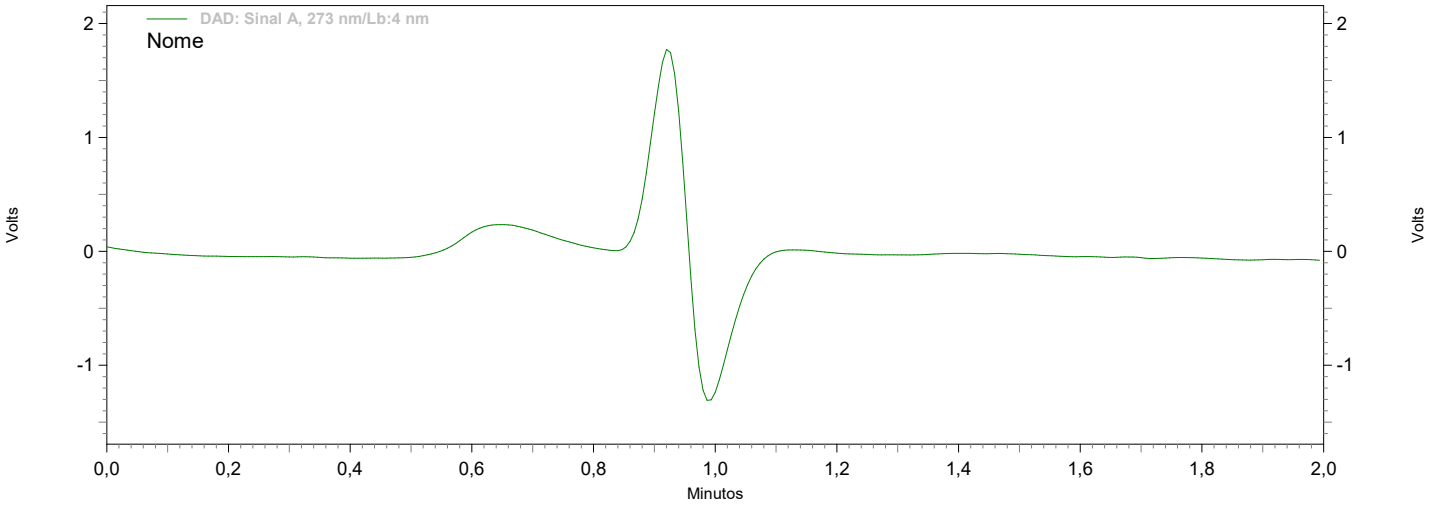

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL

Totais			

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_04HPL34_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:23:40 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:53:30 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_04
Vial: 3 Volume: 10 µL

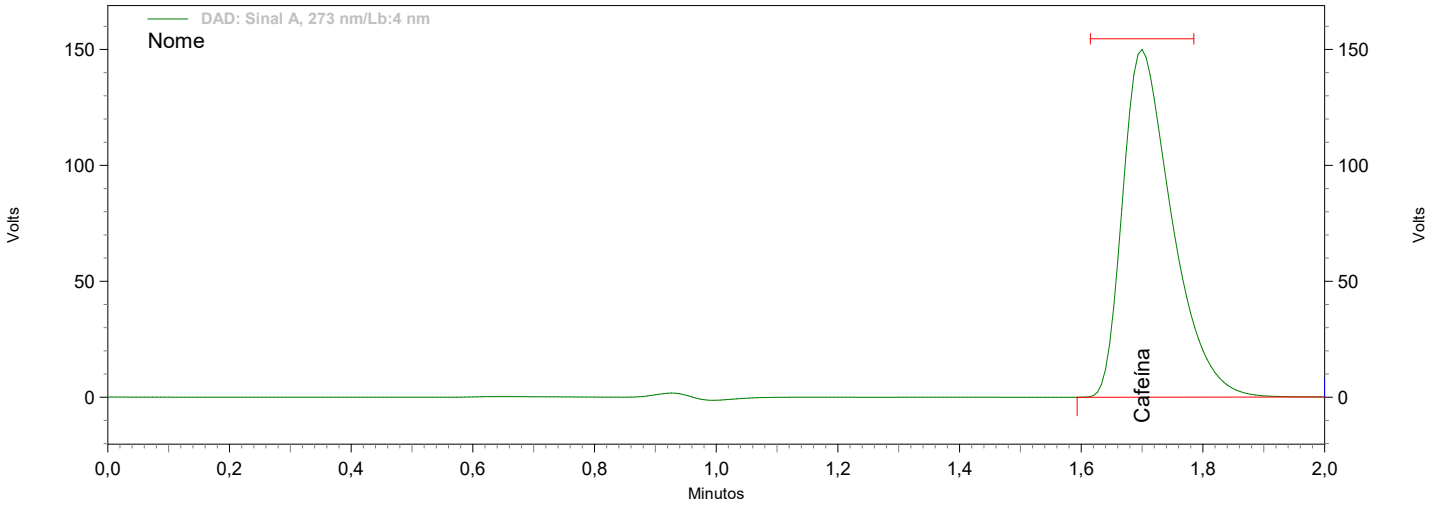

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1771093	0,000
Totais		1771093	0,000

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_05HPL34_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:26:49 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:53:41 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_05
Vial: 3 Volume: 10 µL

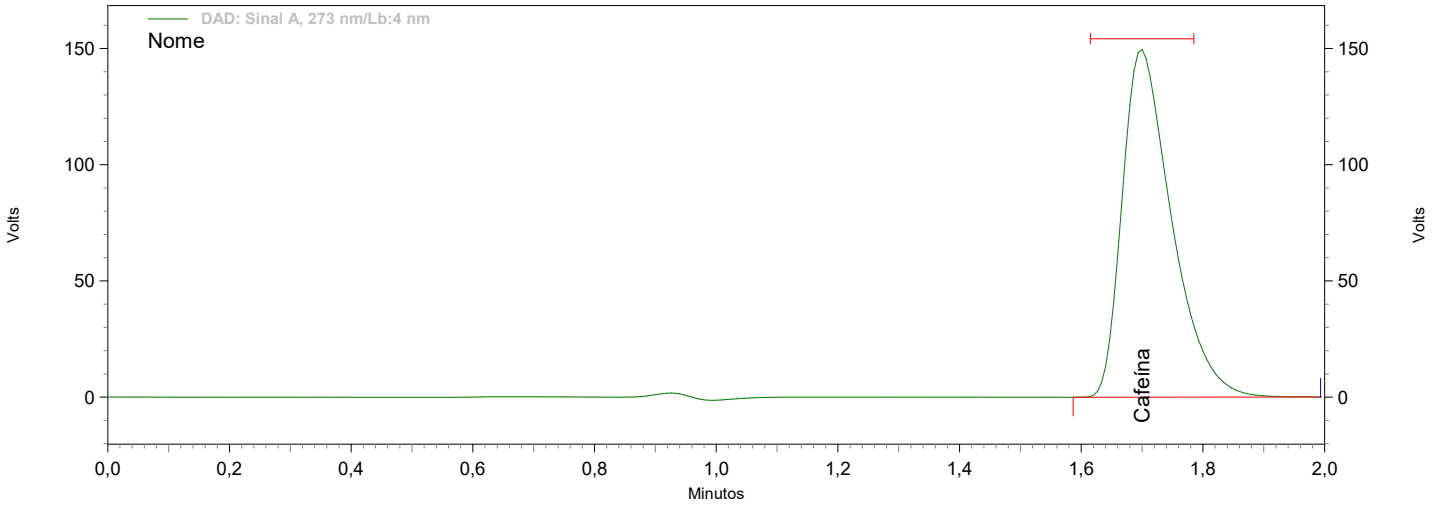

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1770863	0,000
Totais		1770863	0,000

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_06

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\PCIN_06HPL34_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:29:57 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:53:55 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: PCIN_06
Vial: 3 Volume: 10 µL

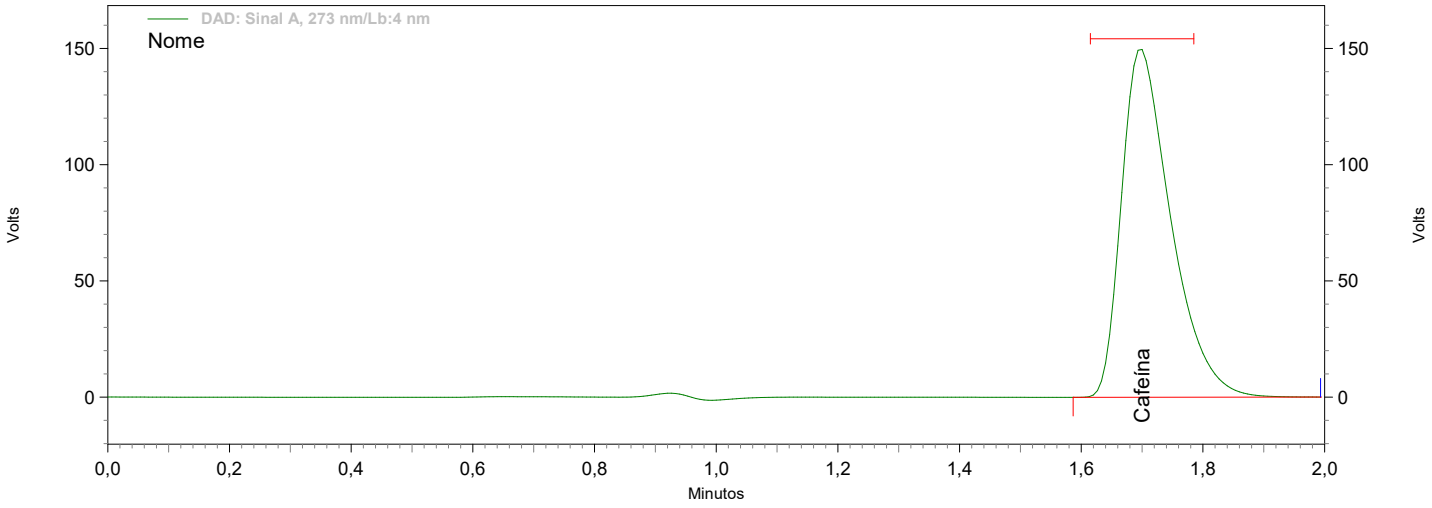

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1770279	0,000
Totais		1770279	0,000

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\BRANCO_03HPL34_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:33:06 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:54:47 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: BRANCO_03
Vial: 2 Volume: 10 µL

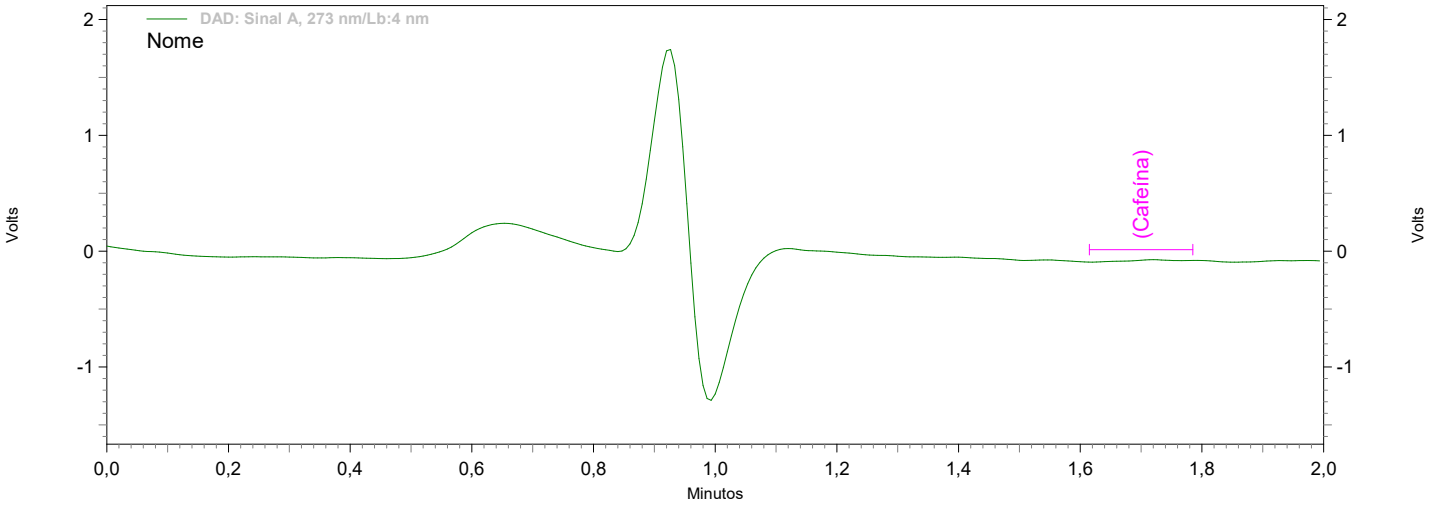

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL


Totais			

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\LDUV_01HPL34_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:36:17 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:57:05 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL34 (Off-line)	Amostra:	LDUV_01
Vial:	4	Volume:	10 µL

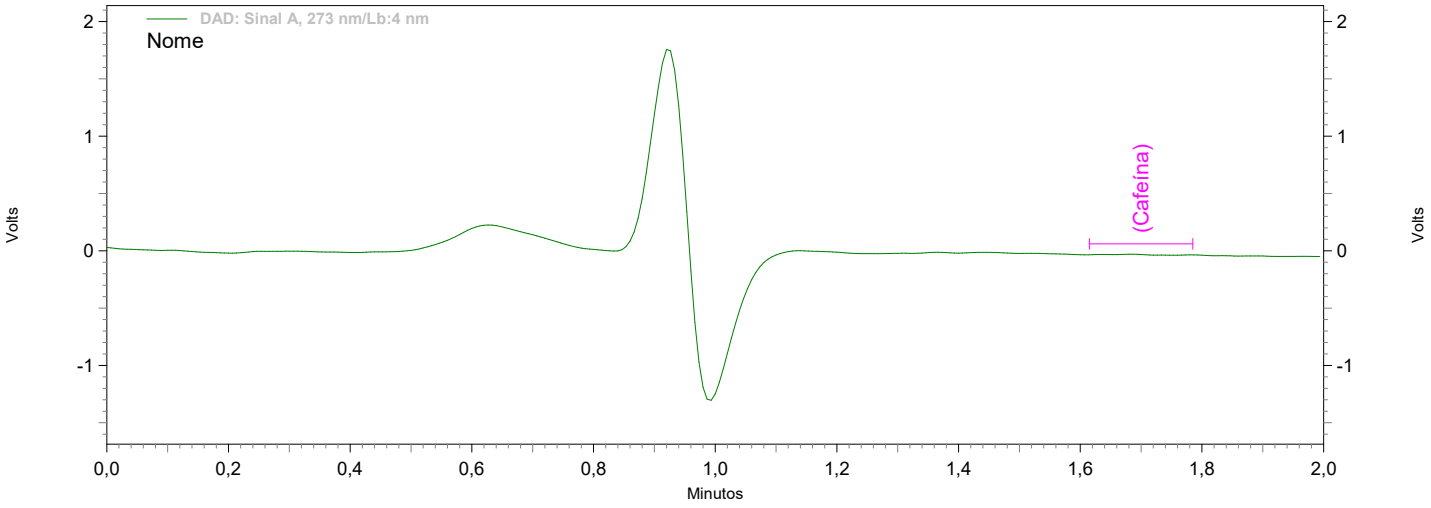

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL

Totais			

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\LDUV_02HPL34_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:39:26 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:57:21 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LDUV_02
Vial: 5 Volume: 10 µL

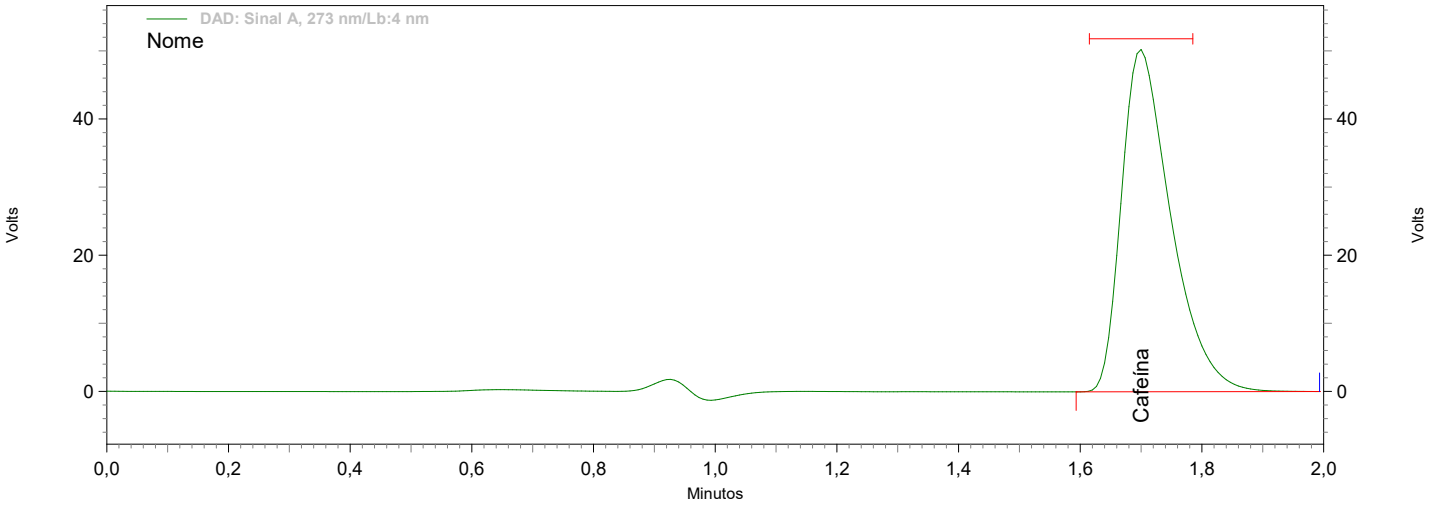

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	594214	0,000
Totais		594214	0,000

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\LDUV_03HPL34_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:42:36 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:57:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LDUV_03
Vial: 6 Volume: 10 µL

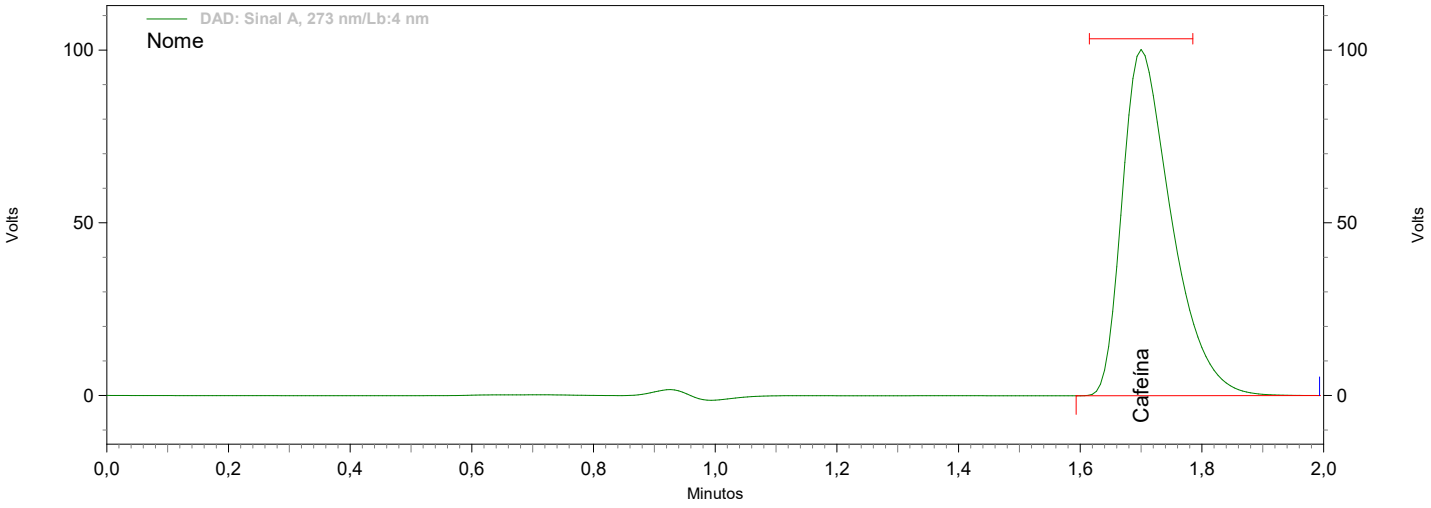

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1184276	0,000
Totais		1184276	0,000

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\LDUV_04HPL34_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:45:46 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:57:51 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LDUV_04
Vial: 7 Volume: 10 µL

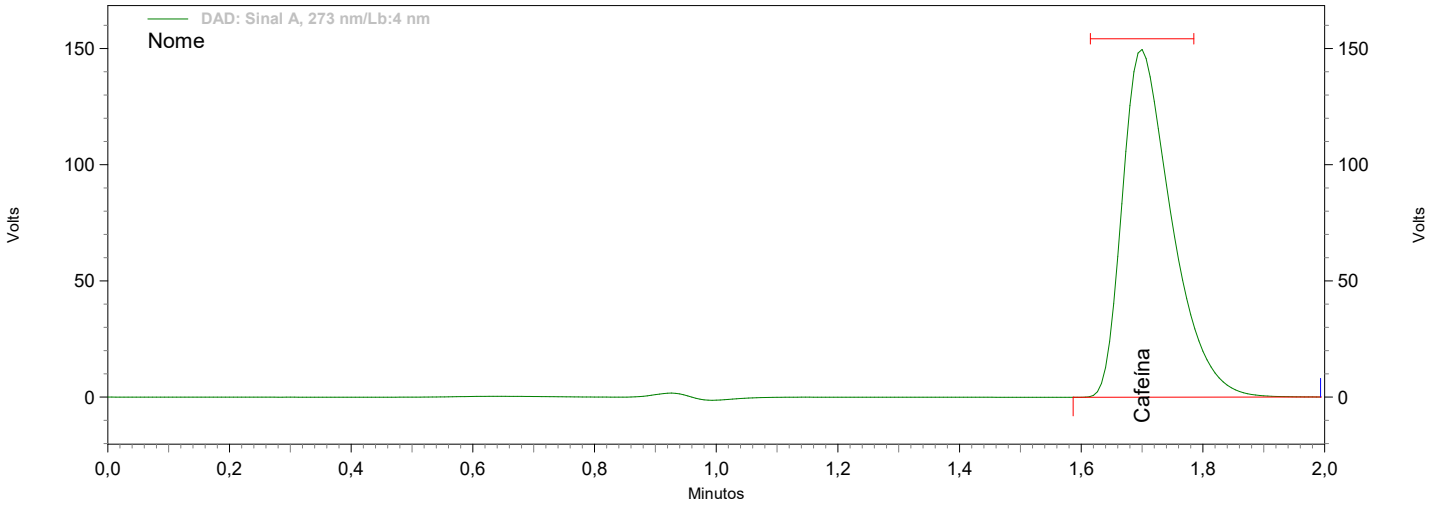

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	1767806	0,000
Totais		1767806	0,000

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 16-54-08 (GMT -03-00).rslt\LDUV_05HPL34_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 16:49:00 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 17:58:07 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LDUV_05
Vial: 8 Volume: 10 µL

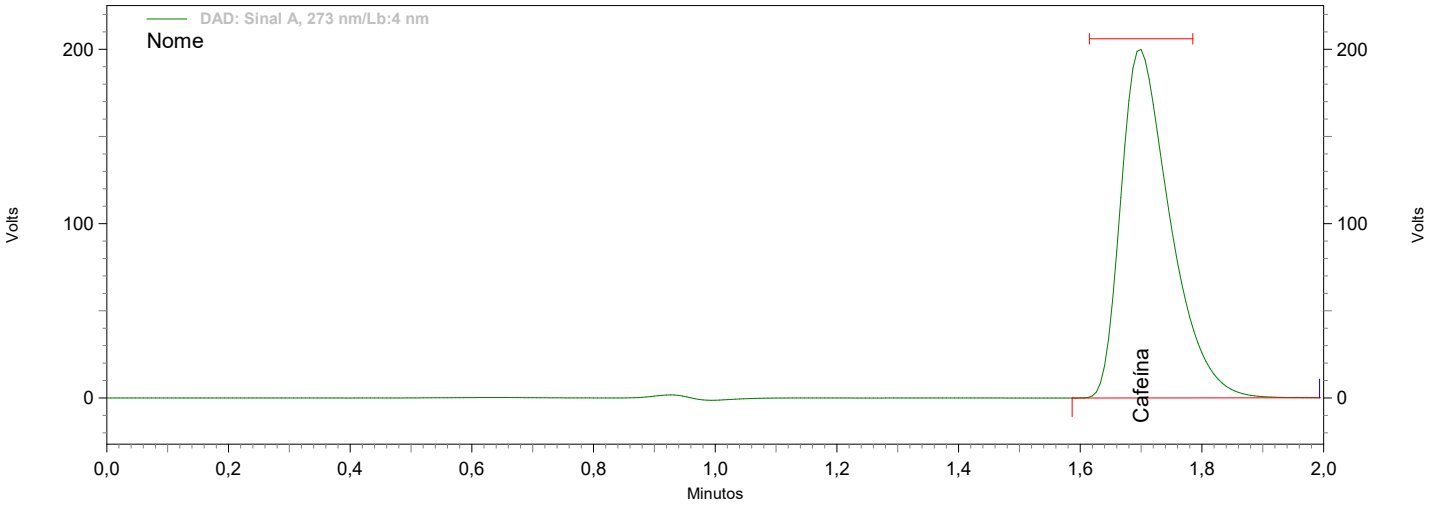

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,700	2362883	0,000
Totais		2362883	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_01HPL34_025.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 18:13:54 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:06:32 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL34 (Off-line)	Amostra:	LIIN_01
Vial:	9	Volume:	0 µL

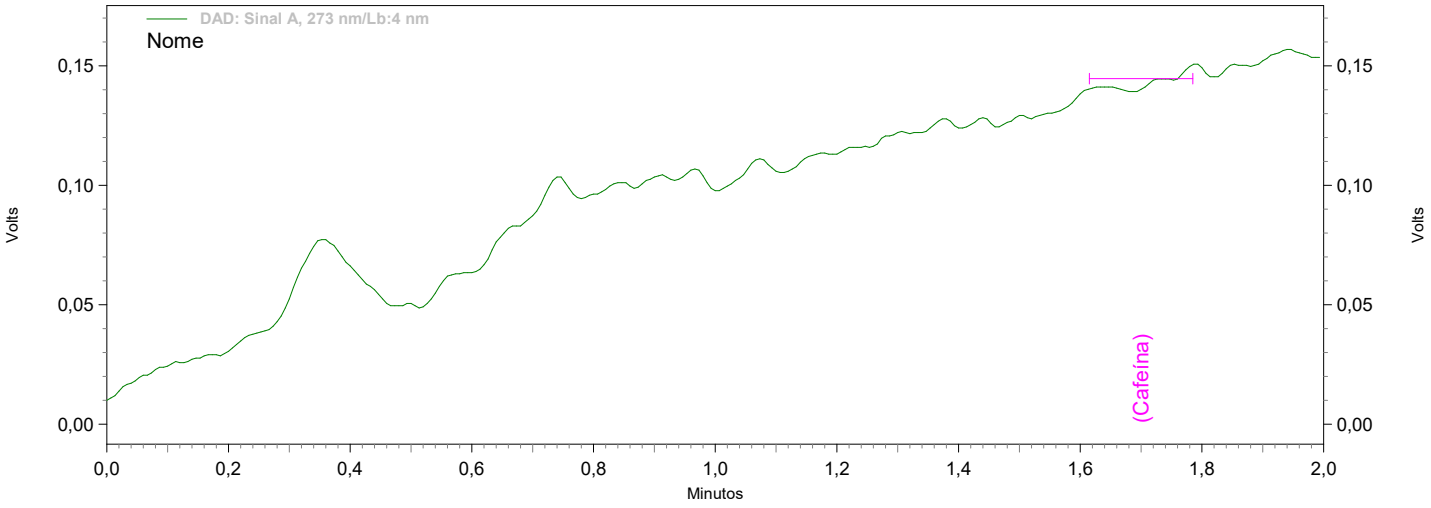

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína			0,000 BDL


Totais			

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\2025\Qualificação.seq_012.rslt\LIIN_02HPL34_026.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 17:38:05 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:06:21 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL34 (Off-line)	Amostra:	LIIN_02
Vial:	9	Volume:	5 µL

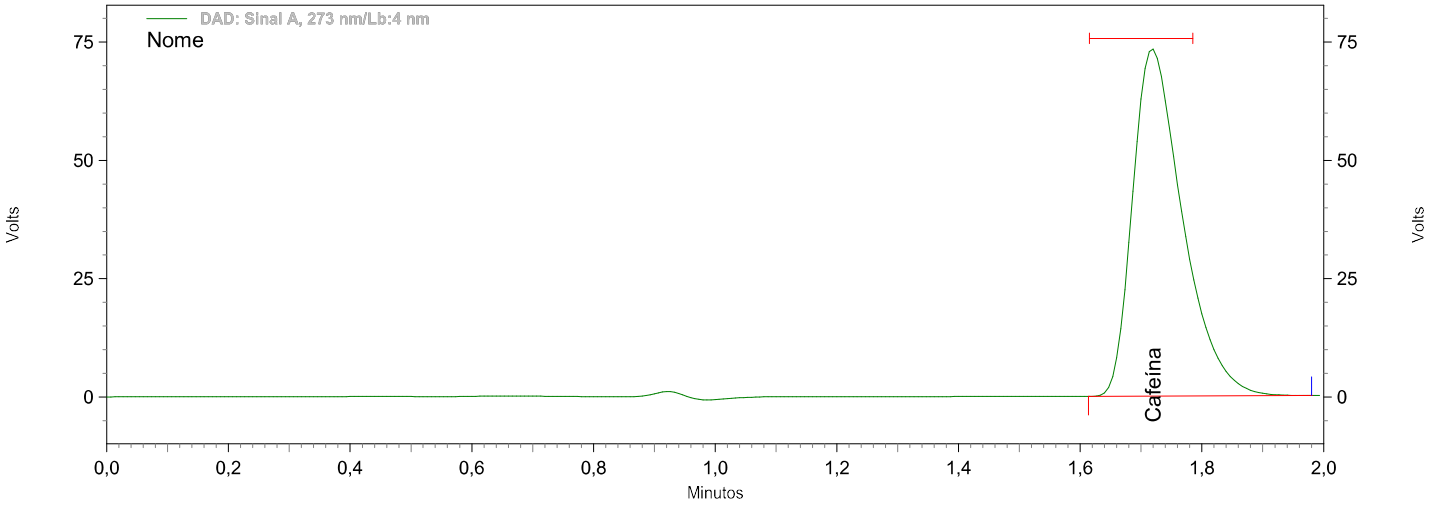

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,720	880612	0,000

Totais		880612	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_03HPL34_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 17:40:24 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:07:33 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LIIN_03
Vial: 9 Volume: 10 µL

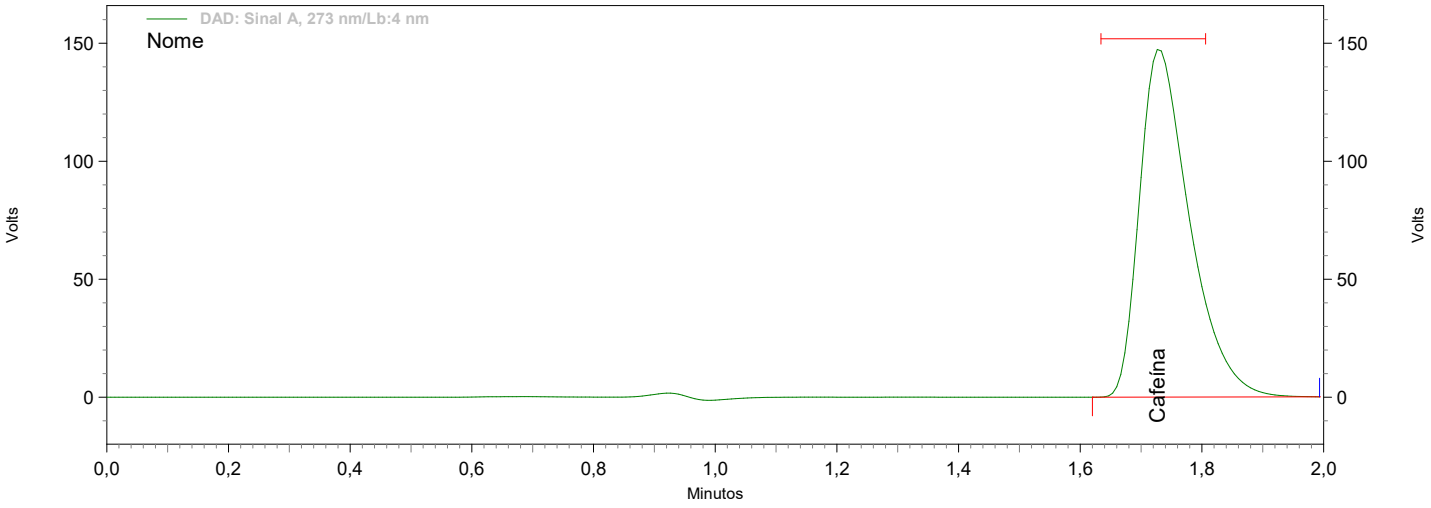

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,727	1766042	0,000

Totais		1766042	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_04HPL34_021.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 17:43:34 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:07:53 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LIIN_04
Vial: 9 Volume: 15 µL

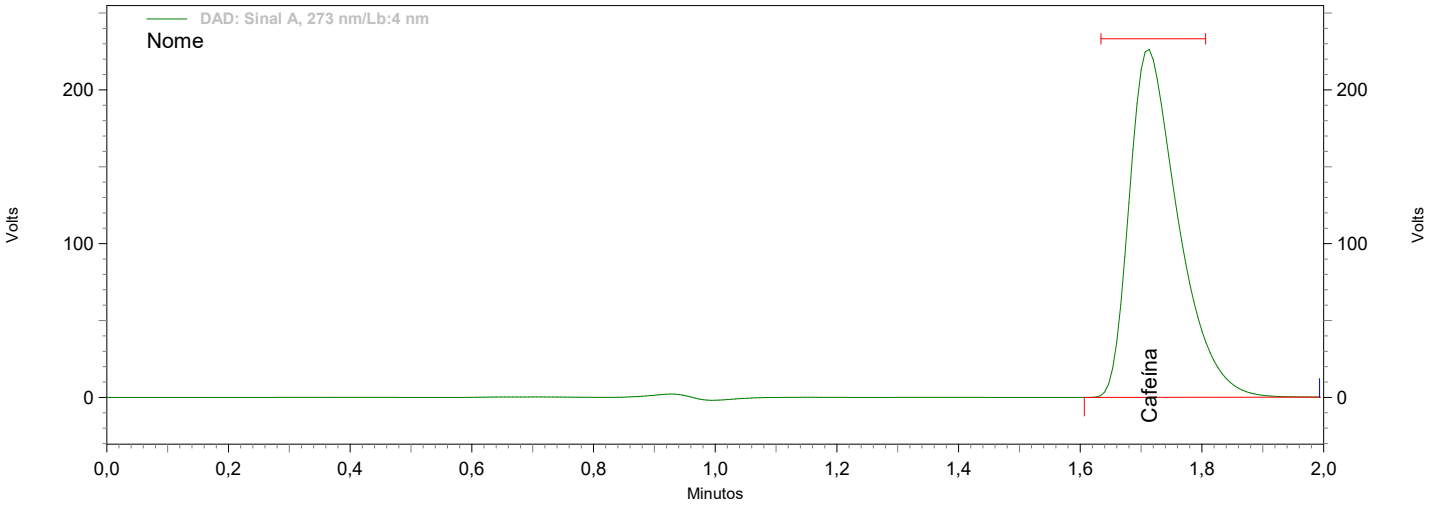

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,713	2648198	0,000

Totais		2648198	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN_05HPL34_022.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 20/02/2025 17:46:48 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:08:09 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL34 (Off-line) Amostra: LIIN_05
Vial: 9 Volume: 20 µL

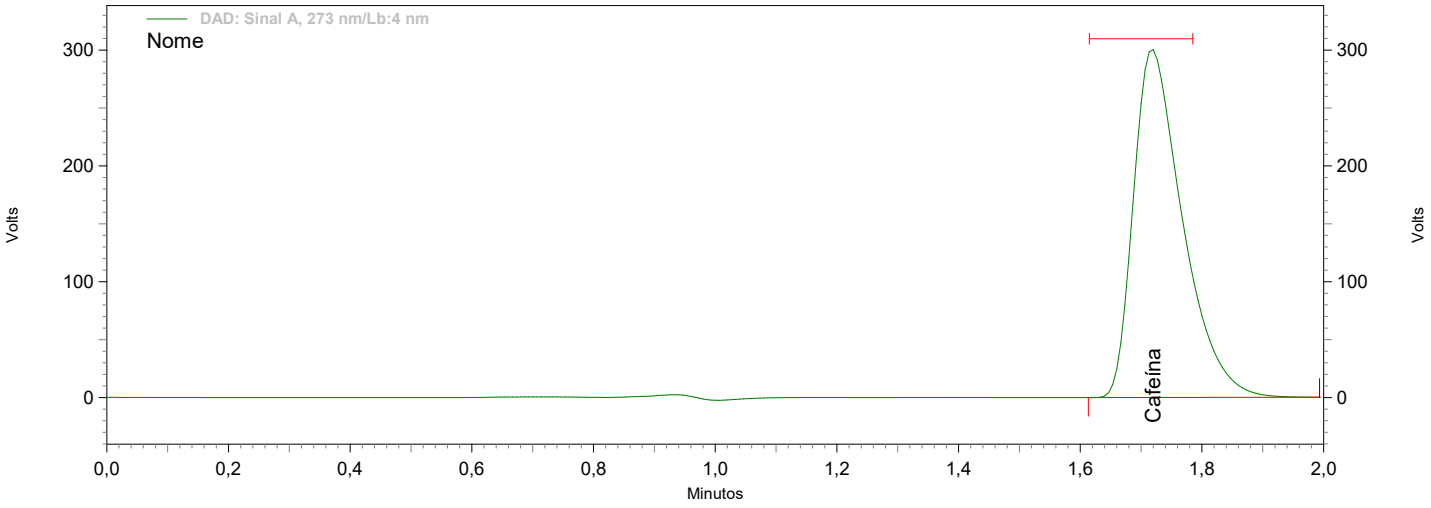

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,720	3532899	0,000


Totais		3532899	0,000

Teste de Sinal/Ruído - RELB_01


Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\RELB_01HPL34_016.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 16:52:16 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 18:56:41 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** RELB_01
Vial: 10 **Volume:** 20 µl

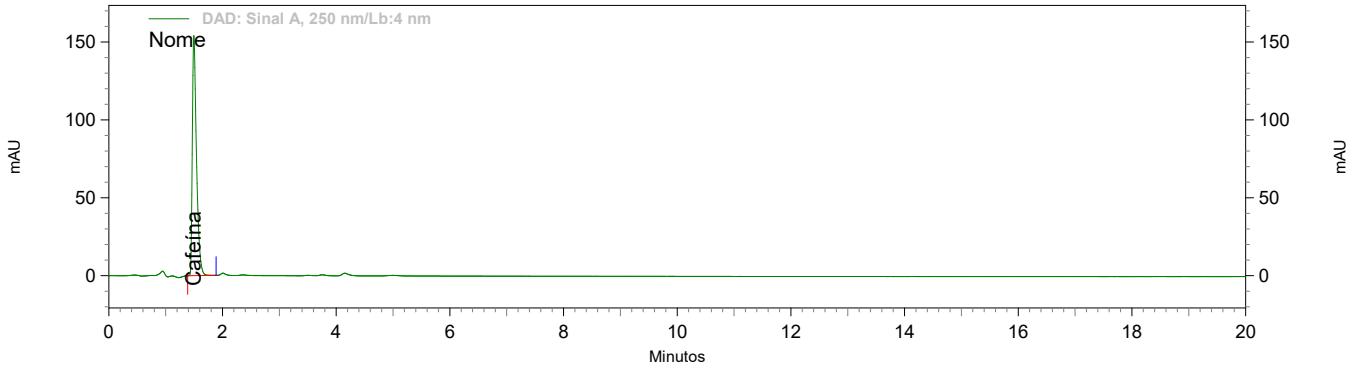

Estabilidade da Linha de Base

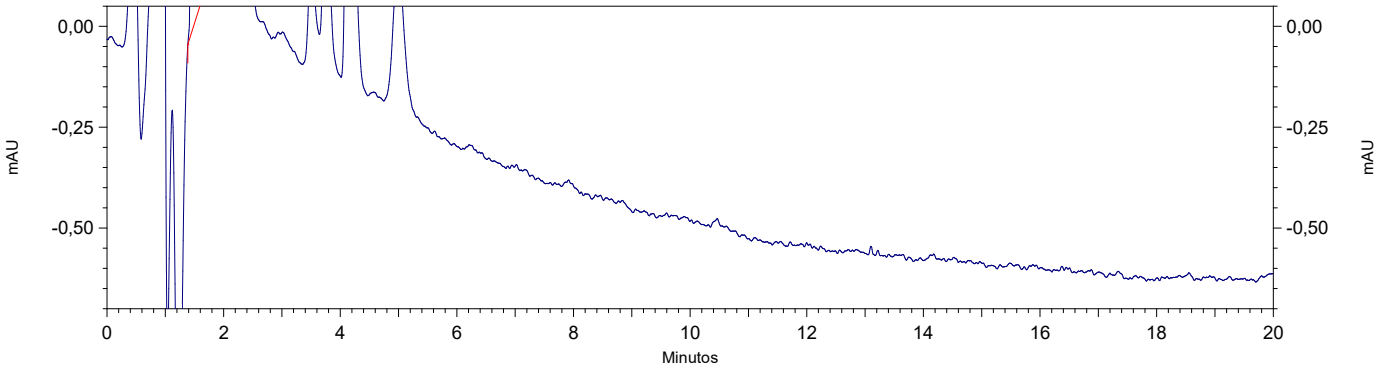


Ruído

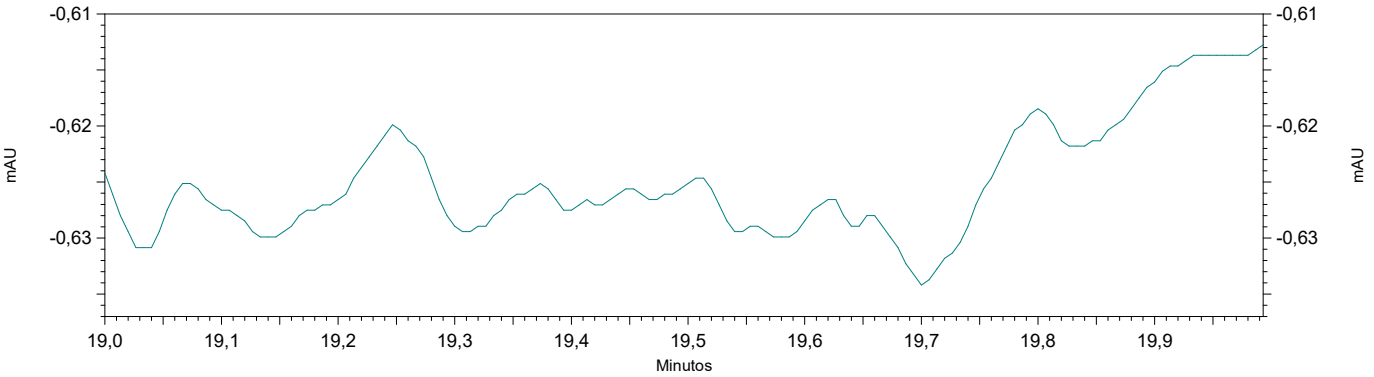

Altura do Pico

Teste de Sinal/Ruído - RELB_01

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\RELB_01HPL34_016.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 16:52:16 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 18:56:41 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** RELB_01
Vial: 10 **Volume:** 20 µl

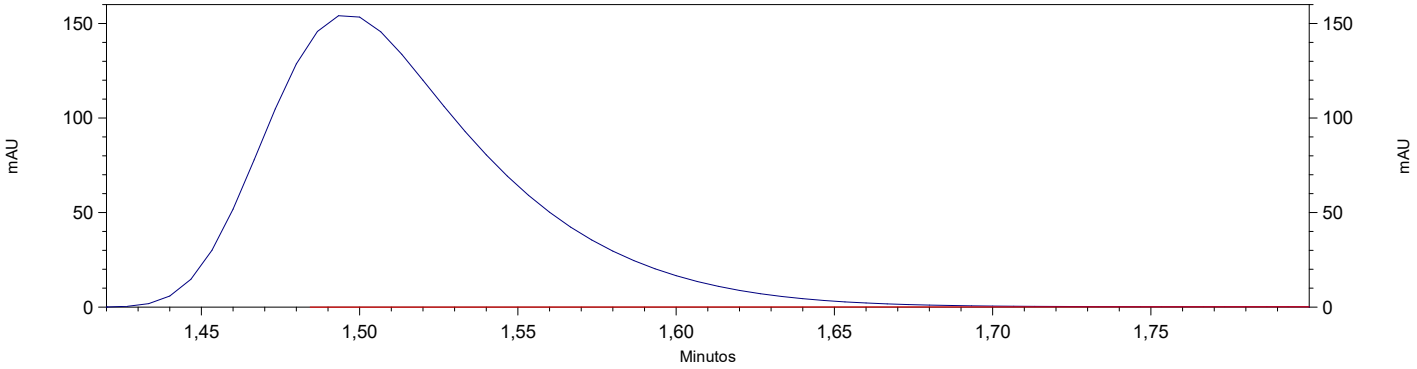


Resultados DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*S/N (ASTM)*	Altura
1	Cafeína	1,493	1645437	**71,040425**	323139
Totais			1645437		323139

Teste de Sinal/Ruído - RELB_01


Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\RELB_01HPL34_016.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 16:52:16 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 18:56:41 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** RELB_01
Vial: 10 **Volume:** 20 µl

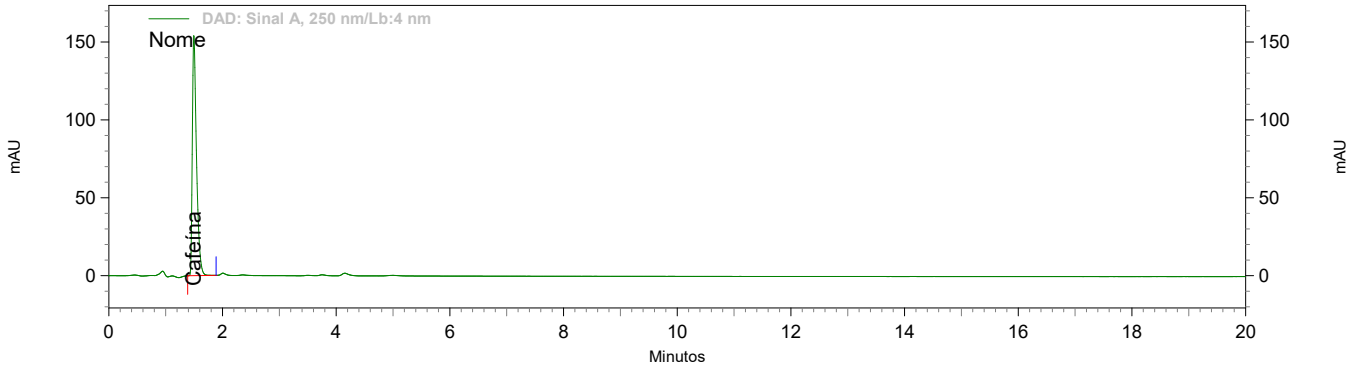

Estabilidade da Linha de Base

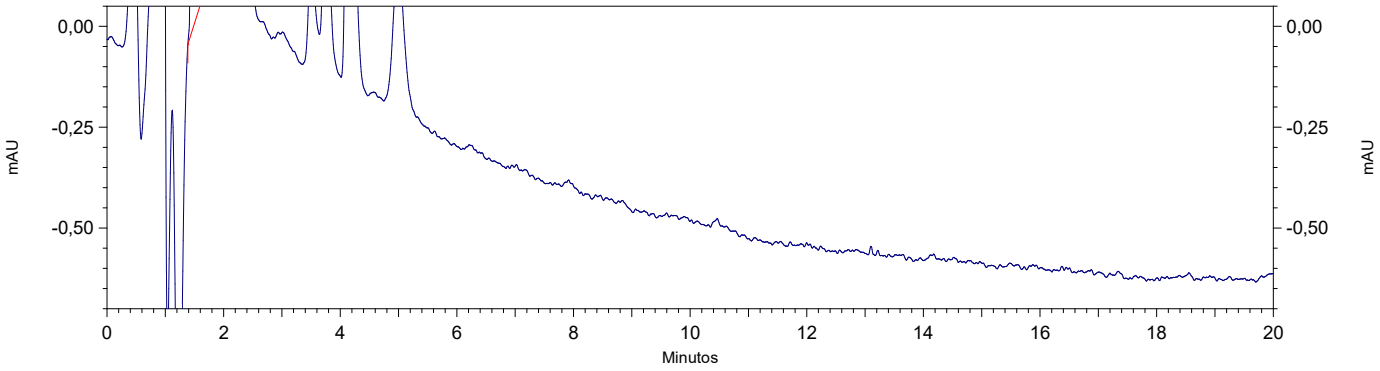


Ruído

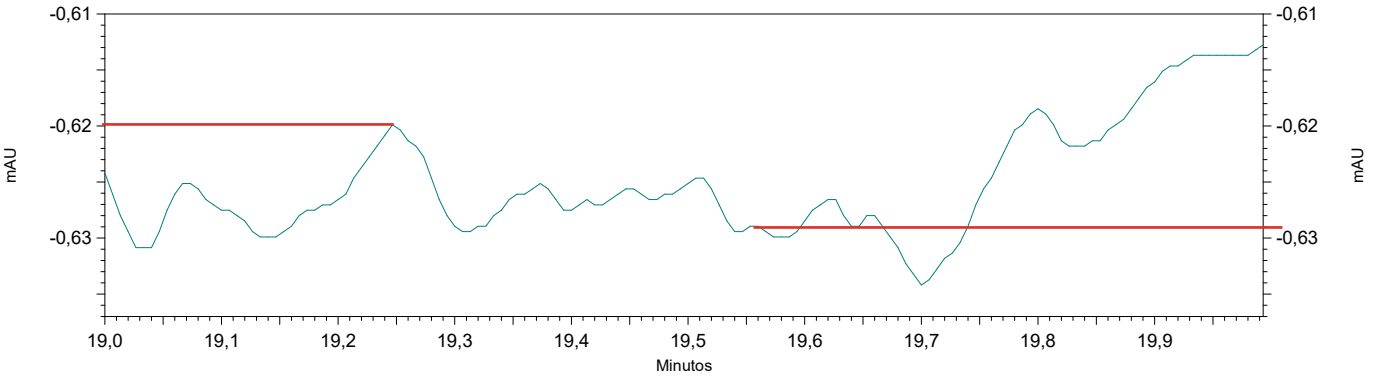

Altura do Pico

Teste de Sinal/Ruído - RELB_01

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 18-20-28 (GMT -03-00).rslt\RELB_01HPL34_016.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 16:52:16 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 18:56:41 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** RELB_01
Vial: 10 **Volume:** 20 µl

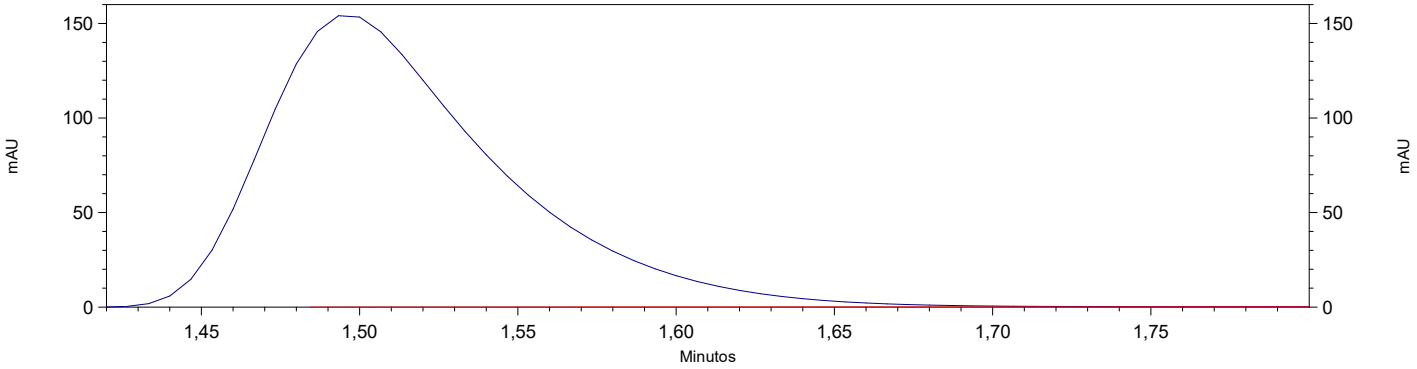


Resultados DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*S/N (ASTM)*	Altura
1	Cafeína	1,493	1645437	**71,040425**	323139
Totais			1645437		323139

RTeste de Gradiente dos Canais - GRBO - Gradiente AB_01

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD AB 20.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL34 (Off-line).22 2025-02-20 19-14-22 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB_01_001.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 18:48:46 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:30:35 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** Gradiente AB_01
Vial: 2 **Volume:** 0 µL

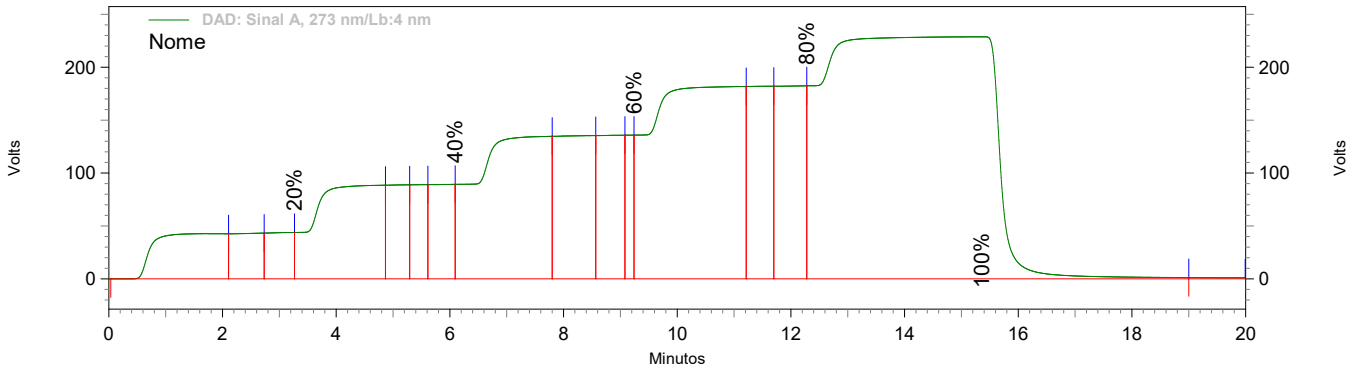


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
3	20%	3,267	91871
7	40%	6,093	187252
11	60%	9,240	284872
14	80%	12,280	382603
15	100%	15,353	479689

Totais			1426287

Teste de Gradiente dos Canais - GRBO - Gradiente CD_01

Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD CD 20.met
Arquivo de dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\2025\Gradientes AB-CD.seq_013.rslt\Gradiente CD_01_002.dat
Usuário: QPack Soluções Analíticas LTDA (QPackSA)
Adquirido: 20/02/2025 19:09:15 (GMT -03:00)
Impresso: 20/02/2025 19:32:00 (GMT -03:00)
TAG: HPL34 (Off-line) **Amostra:** Gradiente CD_01
Vial: 2 **Volume:** 0 µL

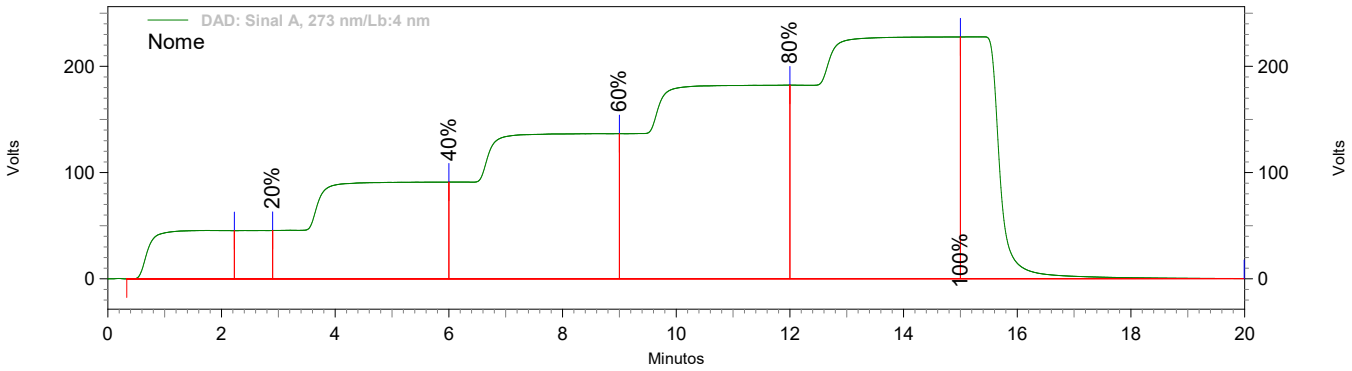

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
2	20%	2,893	95427
3	40%	5,993	190862
4	60%	8,993	286343
5	80%	11,993	382159
6	100%	14,993	477102

Totais			1431893