
PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Teste de Exatidão do Detector - EDUV

Method Name: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\EDUV.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 11-54-50 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
User: administrador (admin)
Acquired: 20/03/2024 11:38:06 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 12:05:55 (GMT -03:00)
TAG: UPL-001 (Off-line) **Amostra:** EDUV
Vial: P1-A1 **Volume:** 10 uL

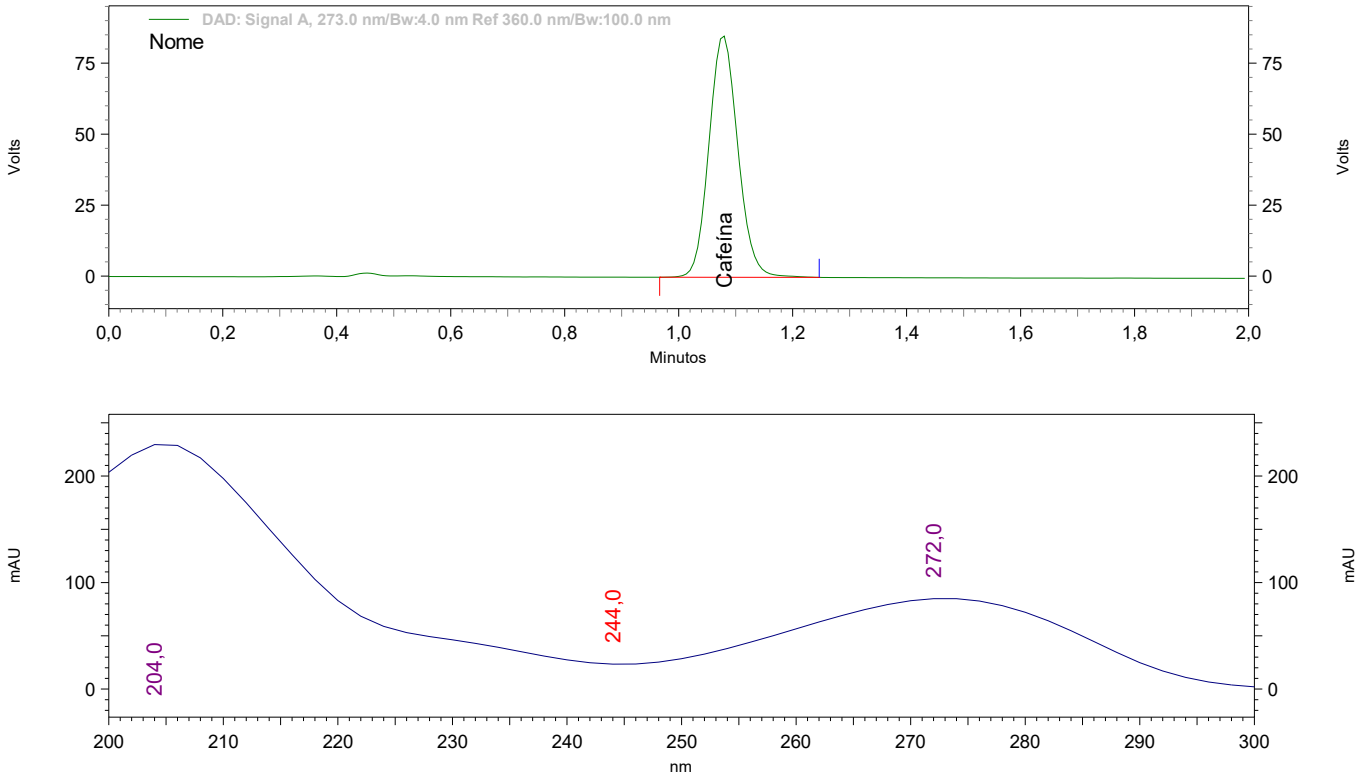

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Pk #	*Name*	*Retention Time*	*Area*	*Altura*
1	Cafeína	1,080	40263151	***11404707***


Totais			40263151	***11404707***

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco_01

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-50-25 (GMT -03-00).rslt\Branco_01_002.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:41:10 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:50:41 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: Branco_01
Vial: P1-A2 Volume: 10 uL

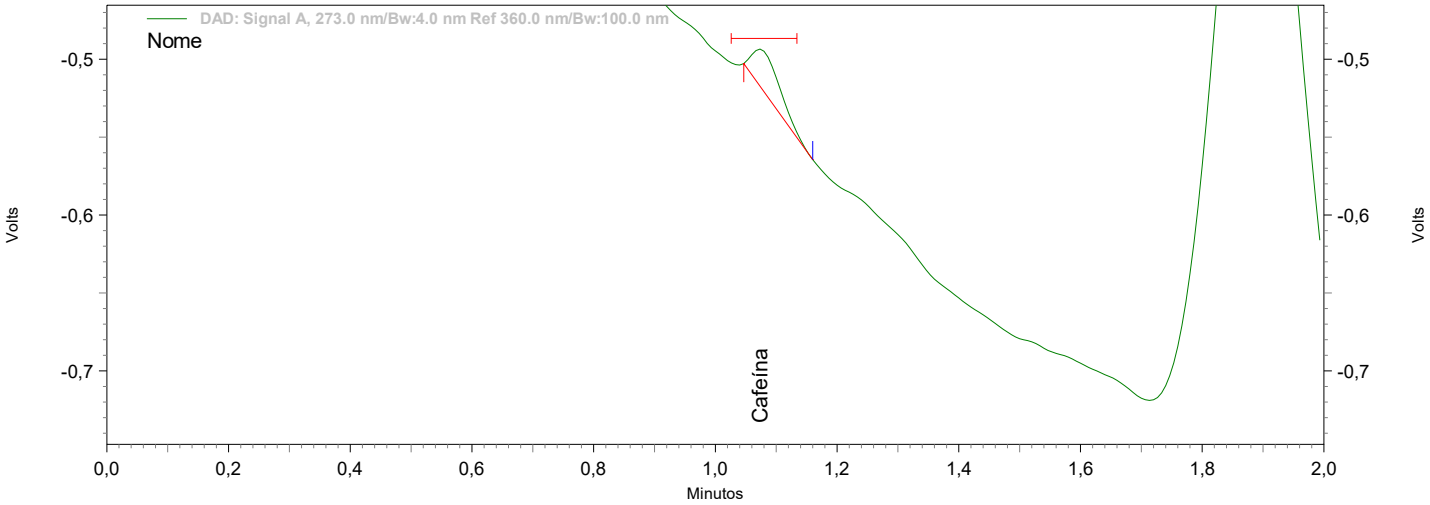

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,073	11041	0,000	3194


Totais		11041	0,000	3194

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_01

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 11-54-50 (GMT -03-00).rslt\PCIN_01_003.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:44:07 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 12:11:47 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_01
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

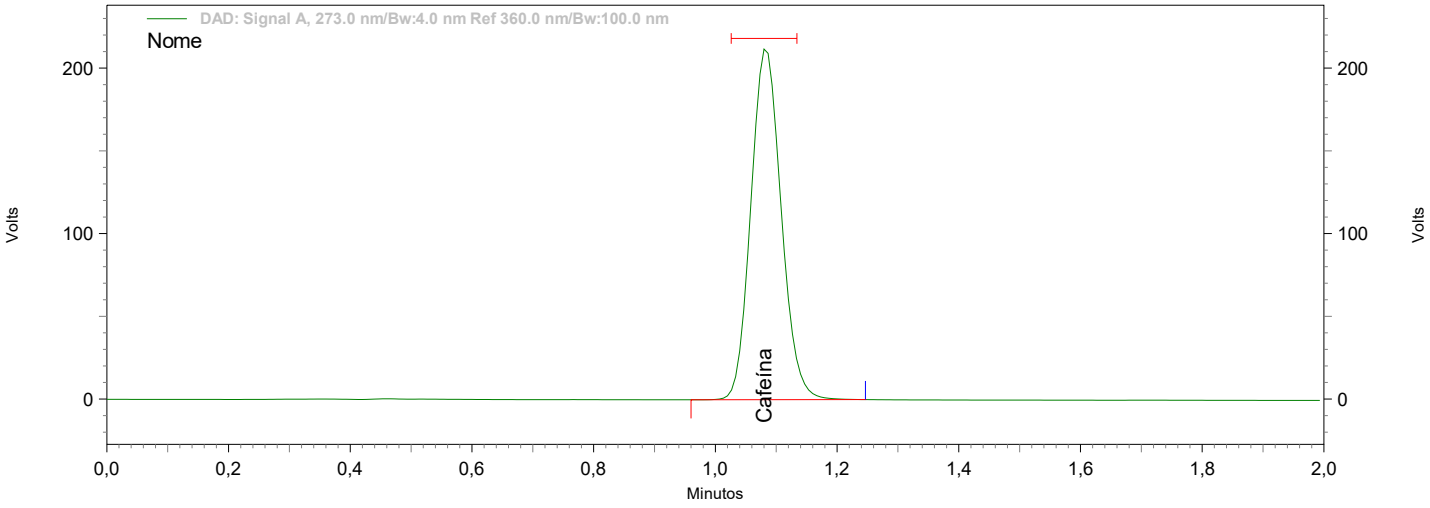

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,080	98696452	0,000	28441030


Totais		98696452	0,000	28441030

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_02

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 11-54-50 (GMT -03-00).rslt\PCIN_02_004.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:47:10 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:17:03 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_02
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

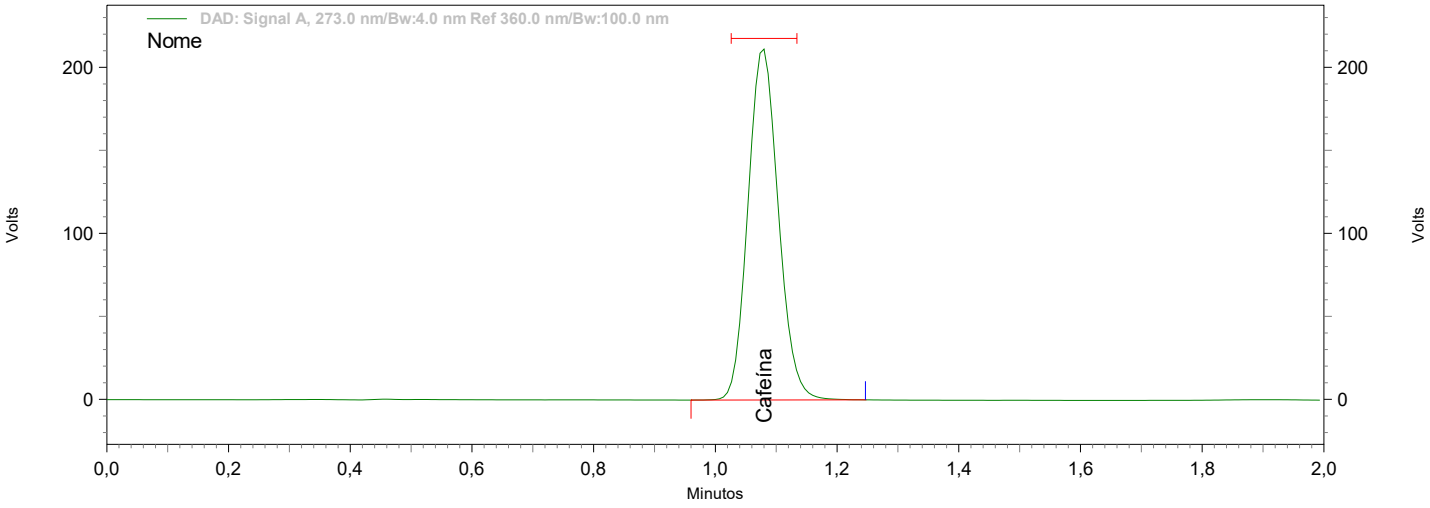

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,080	98731354	0,000	28371184


Totais		98731354	0,000	28371184

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_03

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 11-54-50 (GMT -03-00).rslt\PCIN_03_005.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:50:08 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:18:08 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_03
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

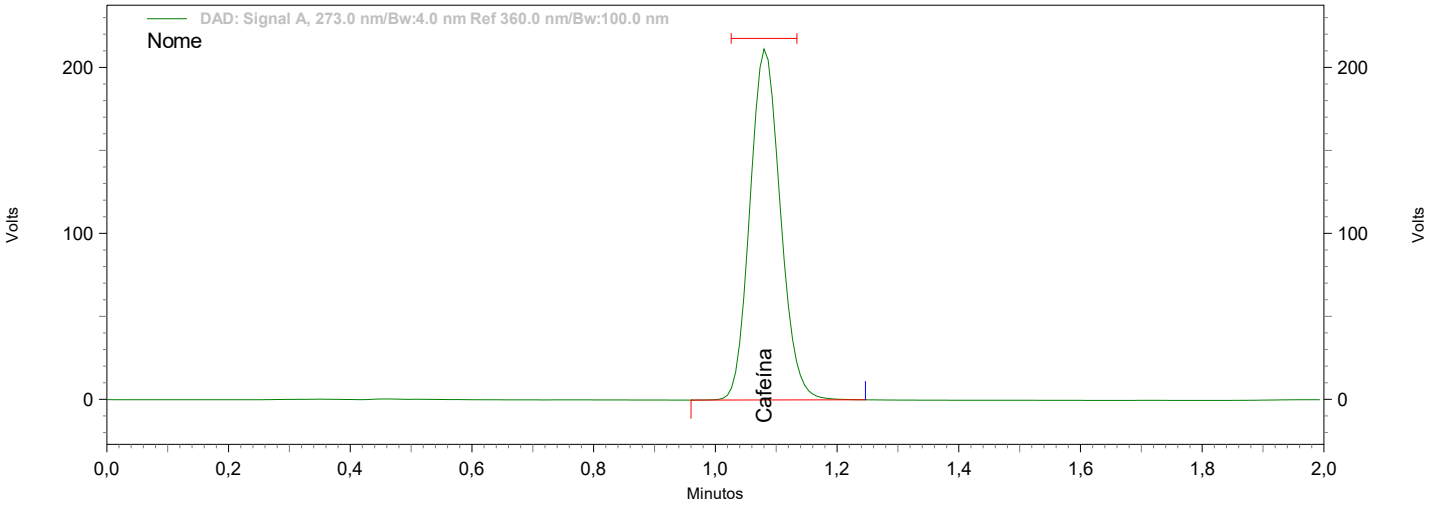

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,080	98718631	0,000	28374714


Totais		98718631	0,000	28374714

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco_02

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\Branco_02_006.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:53:06 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:21:02 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: Branco_02
Vial: P1-A2 Volume: 10 uL

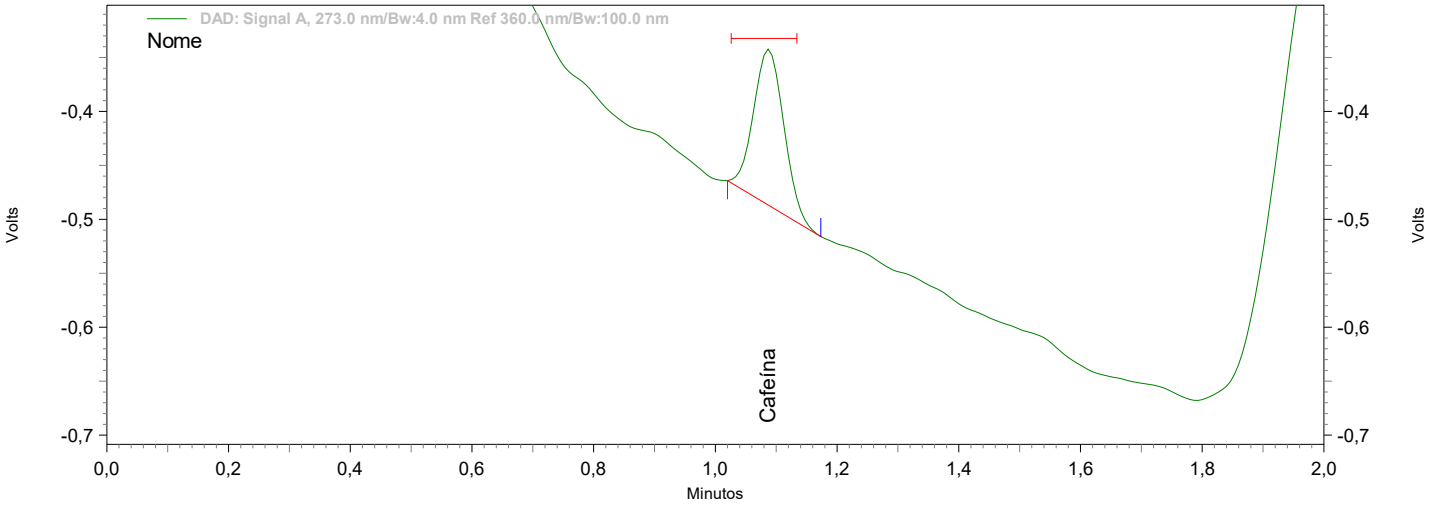

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	67388	0,000	19387


Totais		67388	0,000	19387

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_04

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\PCIN_04_007.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:56:04 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:21:29 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_04
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

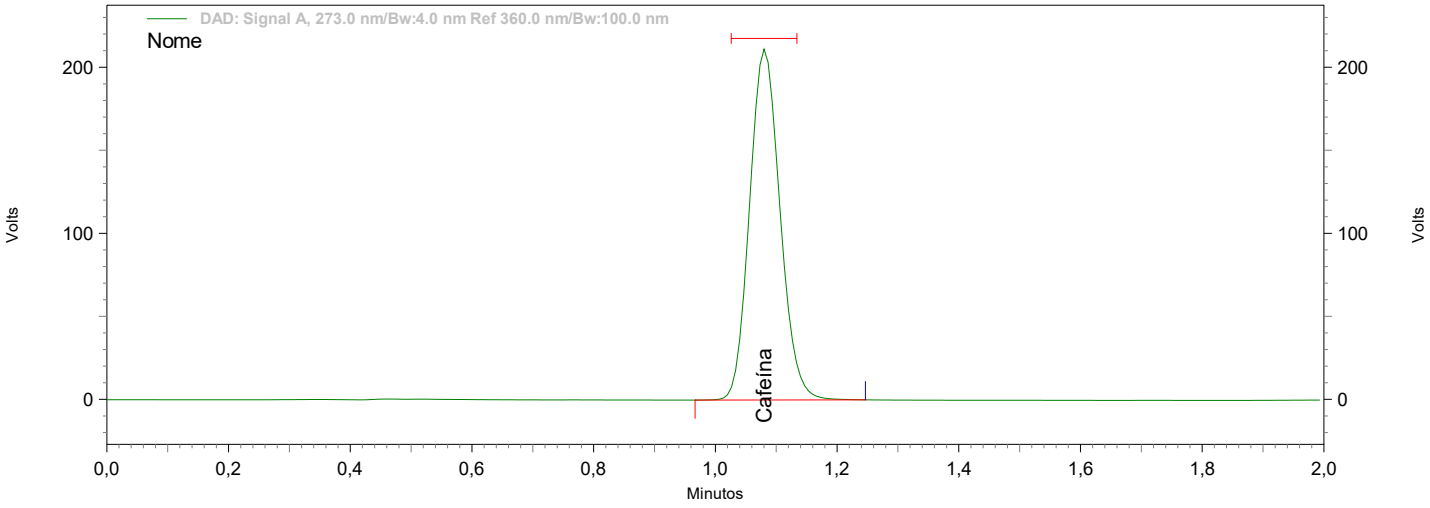

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,080	98690851	0,000	28364607


Totais		98690851	0,000	28364607

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_05

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\PCIN_05_008.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 11:59:03 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:21:55 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_05
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

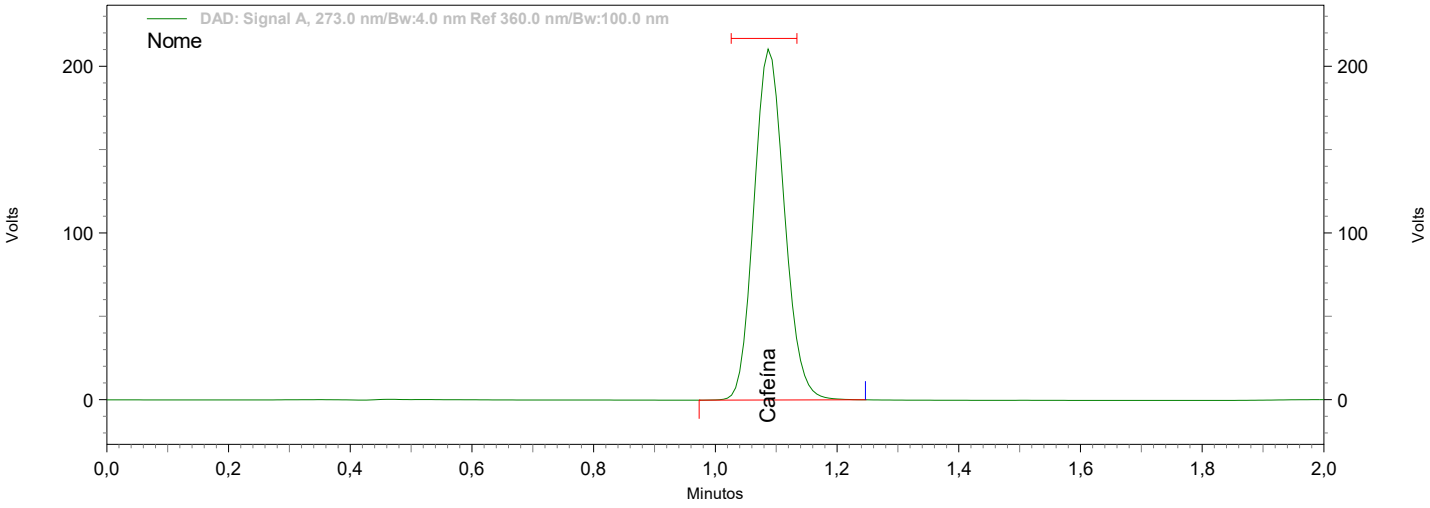

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	98645099	0,000	28257599


Totais		98645099	0,000	28257599

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - PCIN_06

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\PCIN_06_009.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:02:05 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:22:16 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: PCIN_06
Vial: P1-A3 Volume: 10 uL

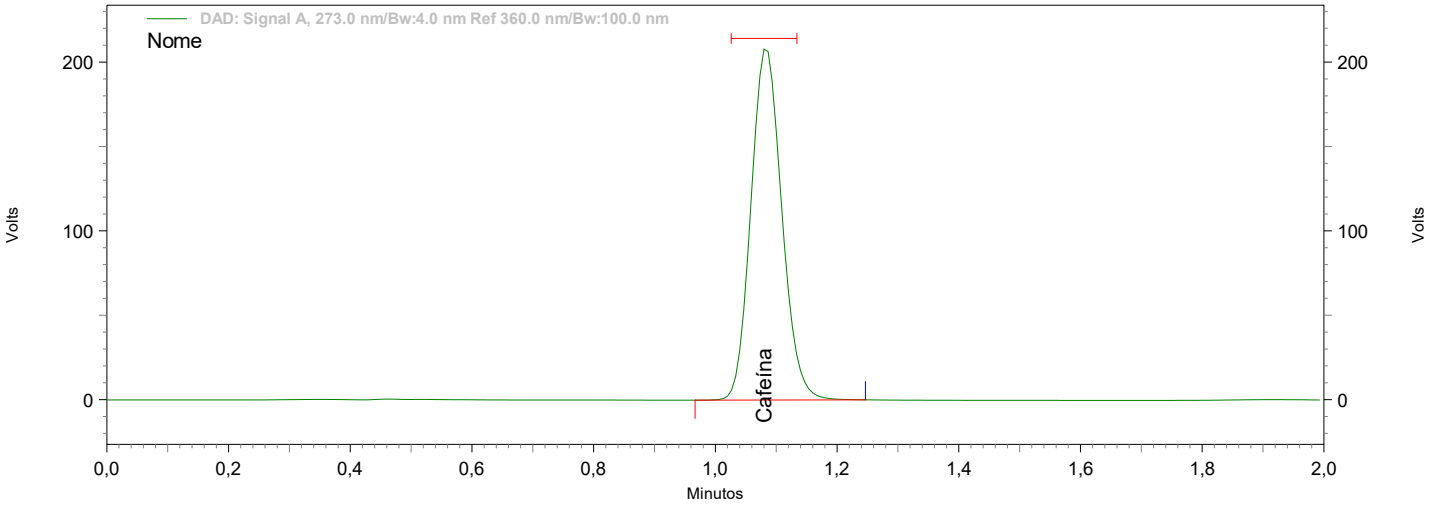

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,080	98678404	0,000	27909156


Totais		98678404	0,000	27909156

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - Branco_03

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\Branco_03_010.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:05:02 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:22:41 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: Branco_03
Vial: P1-A2 Volume: 10 uL

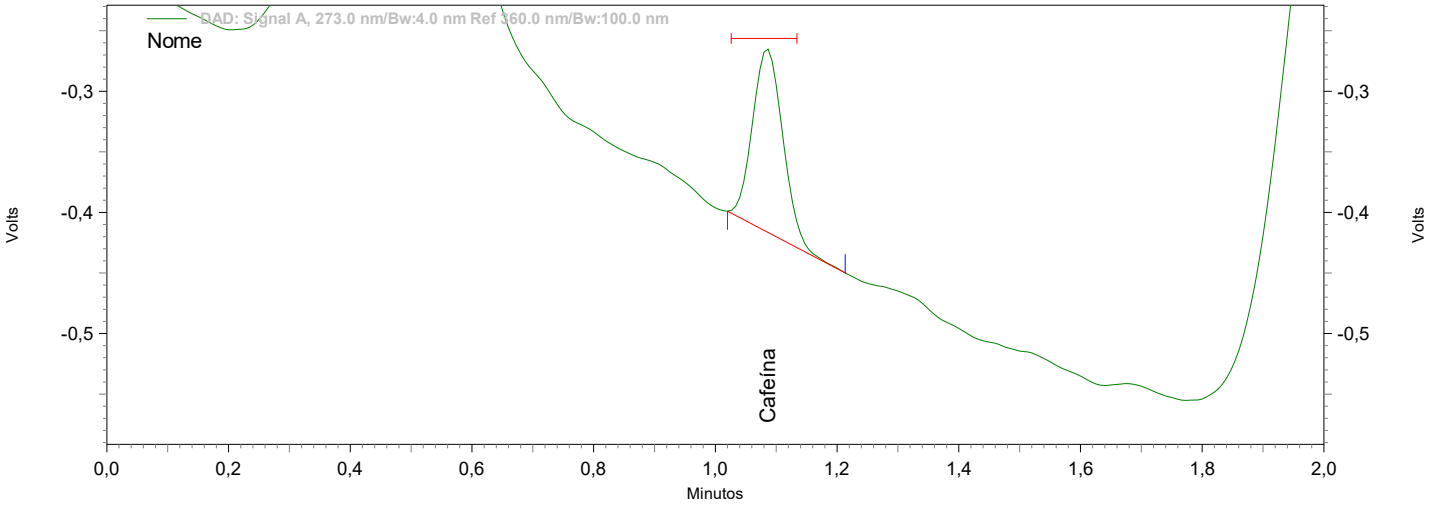

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	70698	0,000	20321


Totais		70698	0,000	20321

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_01

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LDUV_01_011.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:08:00 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:23:01 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LDUV_01
Vial: P1-A4 Volume: 10 uL

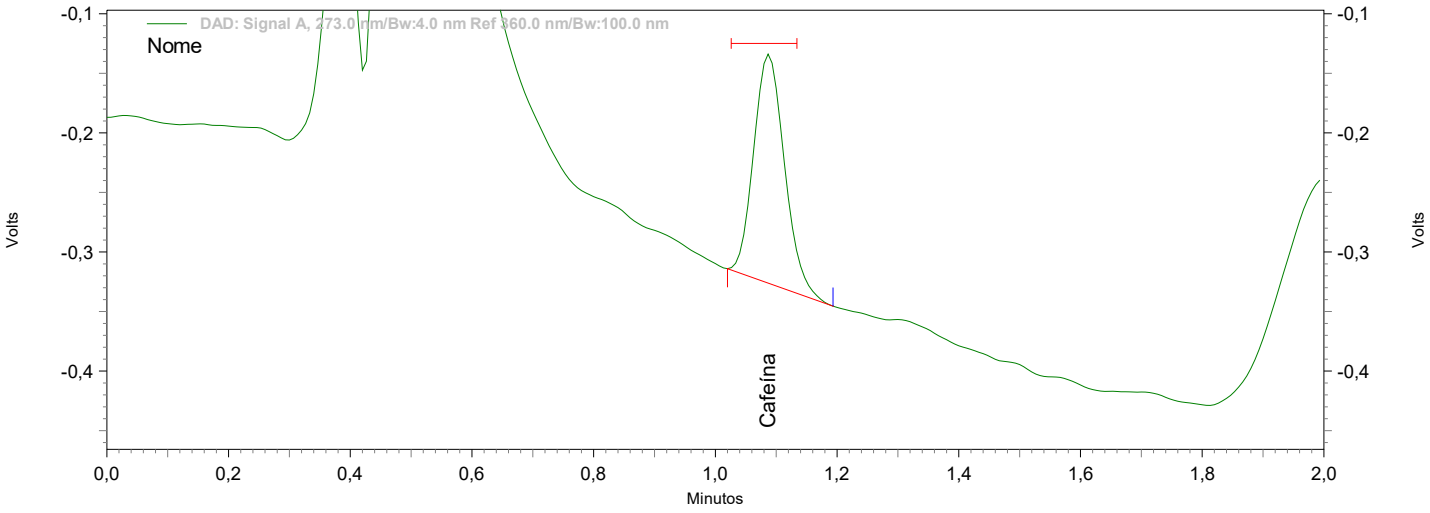

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	91119	0,000	25809


Totais		91119	0,000	25809

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_02

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LDUV_02_012.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:10:58 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:23:18 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LDUV_02
Vial: P1-A5 Volume: 10 uL

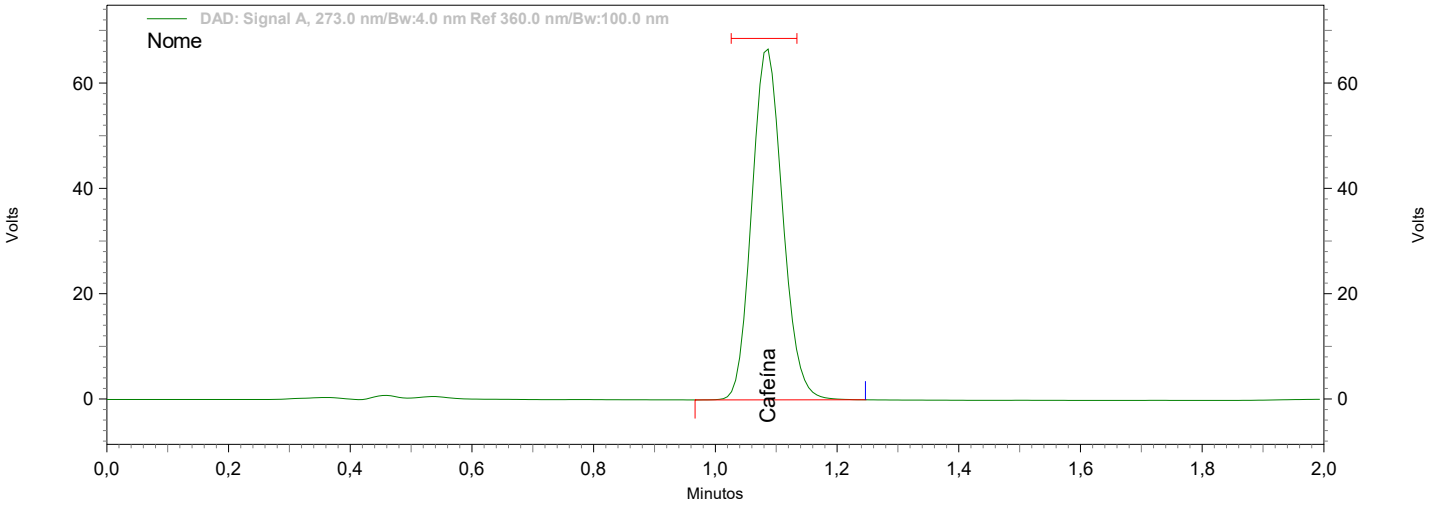

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	31553781	0,000	8940977


Totais		31553781	0,000	8940977

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_03

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LDUV_03_013.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:13:57 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:23:39 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LDUV_03
Vial: P1-A6 Volume: 10 uL

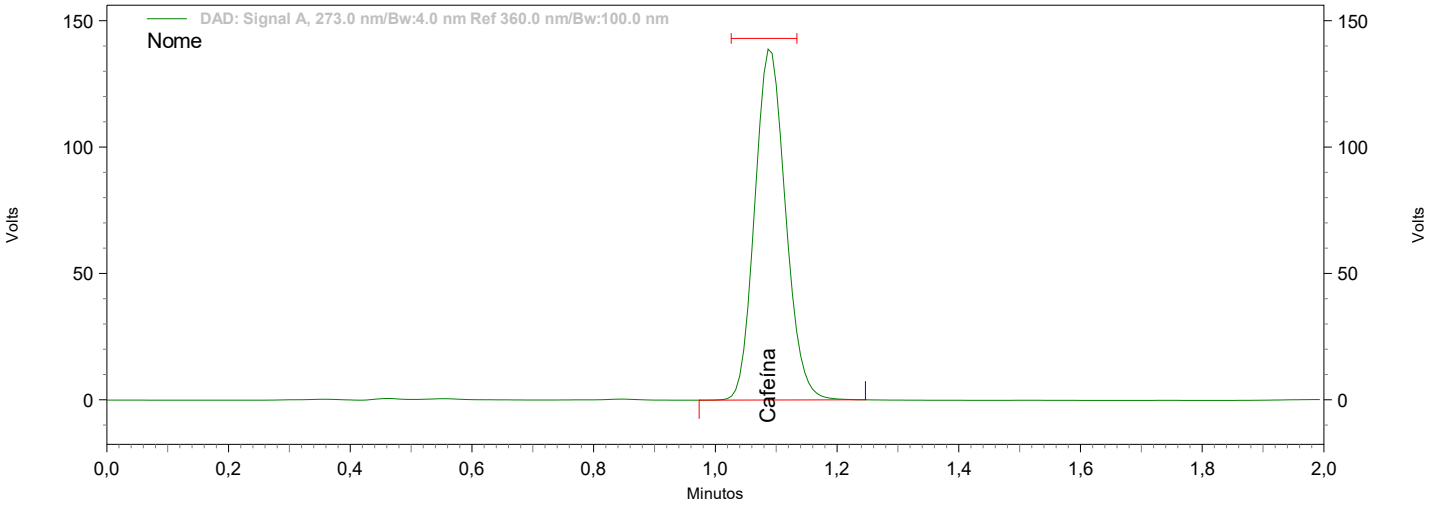

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	65555249	0,000	18640124


Totais		65555249	0,000	18640124

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_04

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 14-13-10 (GMT -03-00).rslt\LDUV_04_014.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:16:57 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 14:17:45 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LDUV_04
Vial: P1-A7 Volume: 10 uL

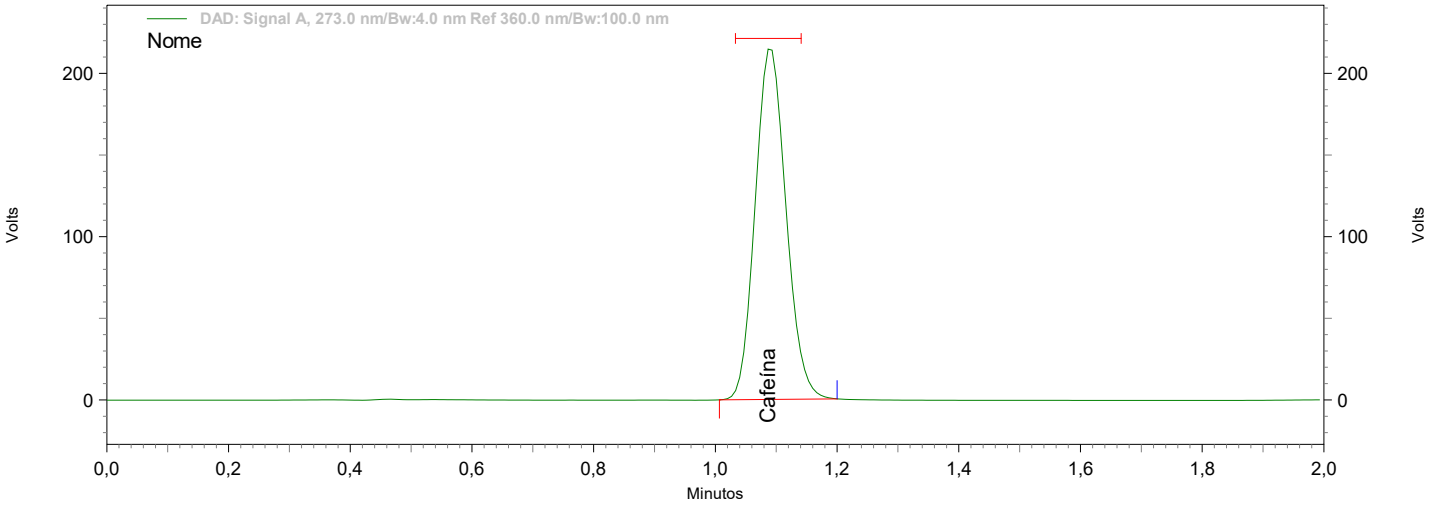

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	101656878	0,000	28796401


Totais		101656878	0,000	28796401

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LDUV_05

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LDUV_05_015.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:19:54 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:24:26 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LDUV_05
Vial: P1-A8 Volume: 10 uL

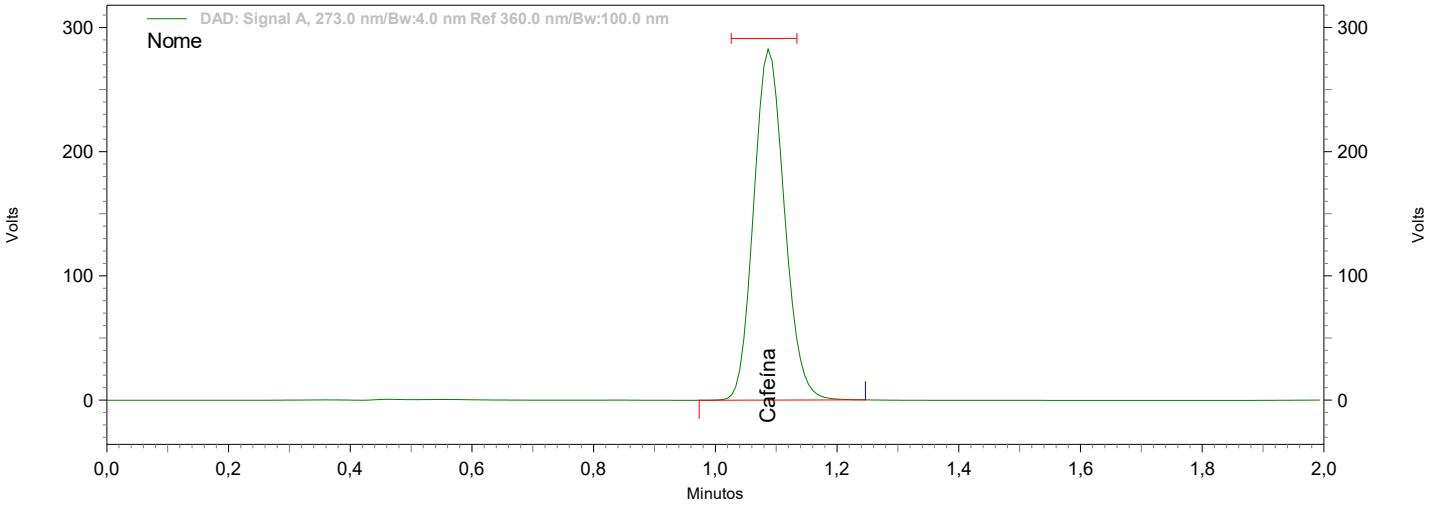

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	133333958	0,000	37934674


Totais		133333958	0,000	37934674

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LIIN_01

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LIIN_01_017.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:43:28 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:38:39 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LIIN_01
Vial: P1-A9 Volume: 0 uL

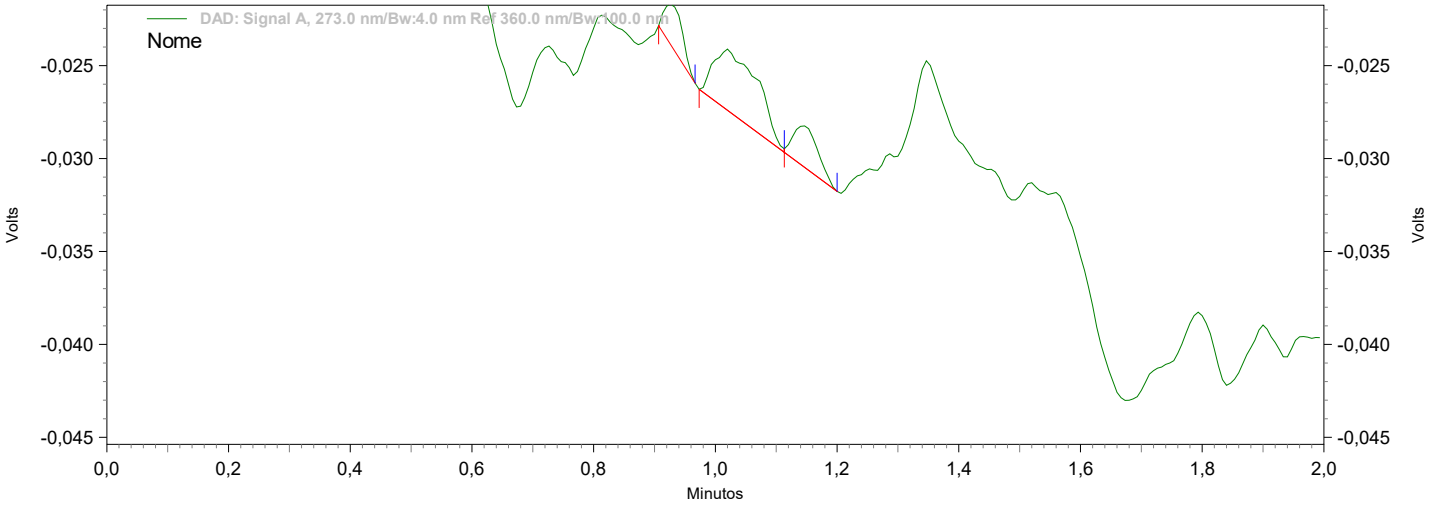

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
	0,927	649	0,000	293
	1,020	2354	0,000	443
Cafeína			0,000 BDL	
	1,147	847	0,000	300
Totais		3850	0,000	1036

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LIIN_02

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LIIN_02_018.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:46:27 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:39:00 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LIIN_02
Vial: P1-A9 Volume: 5 uL

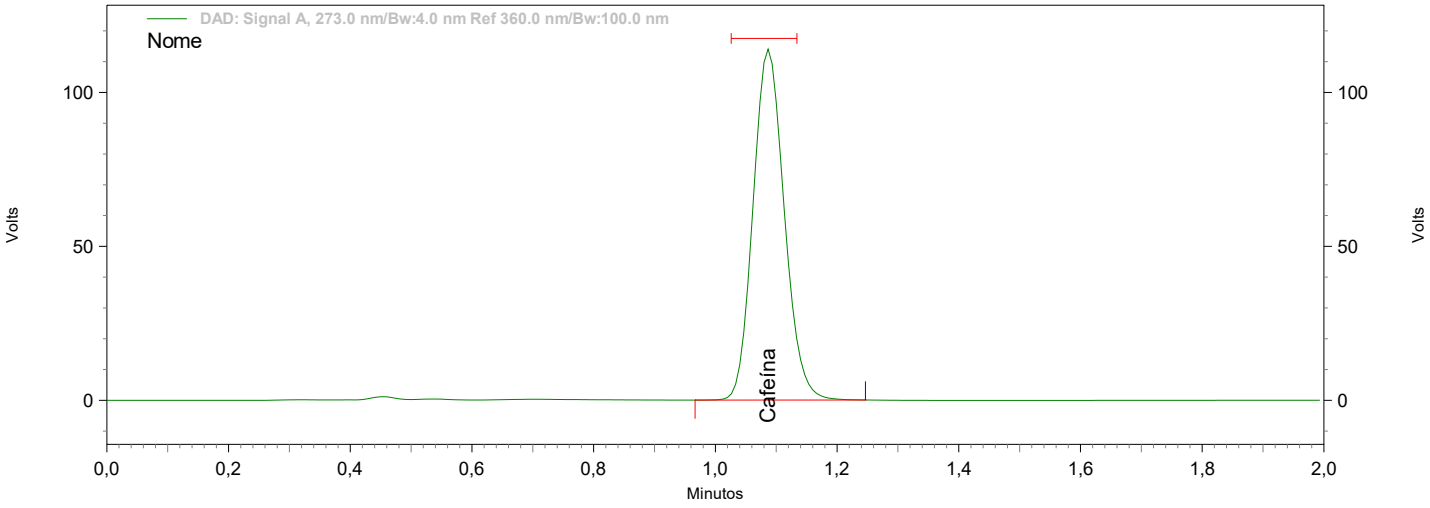

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	54506845	0,000	15299140


Totais		54506845	0,000	15299140

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LIIN_03

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LIIN_03_019.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:49:23 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:39:31 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LIIN_03
Vial: P1-A9 Volume: 10 uL

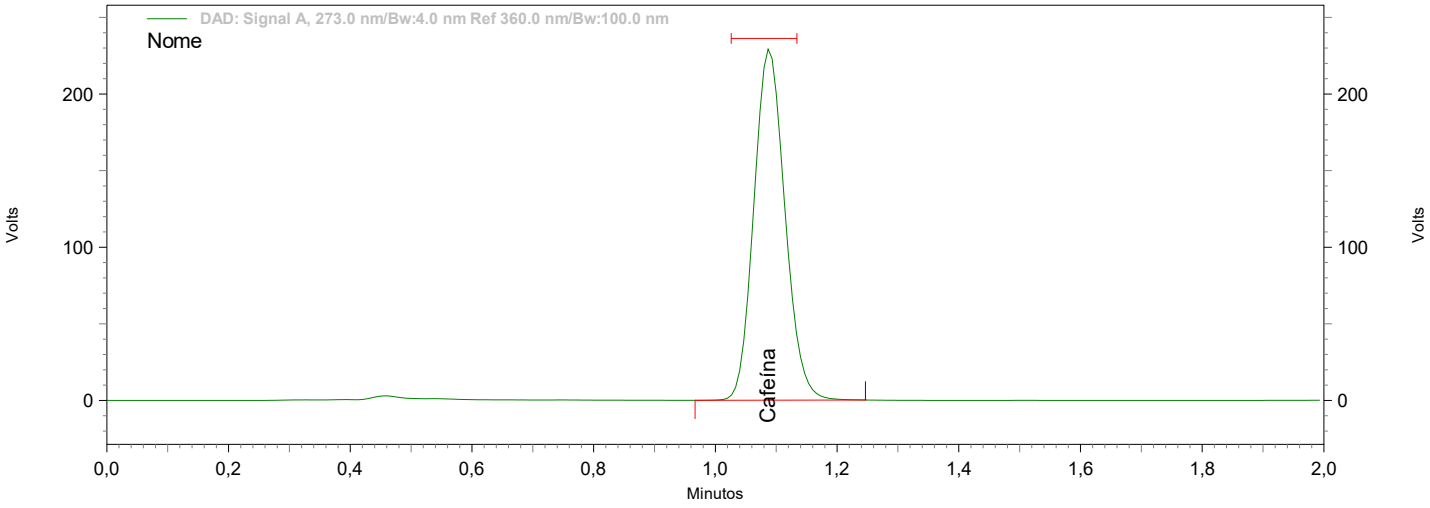

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,087	109106929	0,000	30755106


Totais		109106929	0,000	30755106

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LIIN_04

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LIIN_04_020.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:52:26 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:39:54 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LIIN_04
Vial: P1-A9 Volume: 15 uL

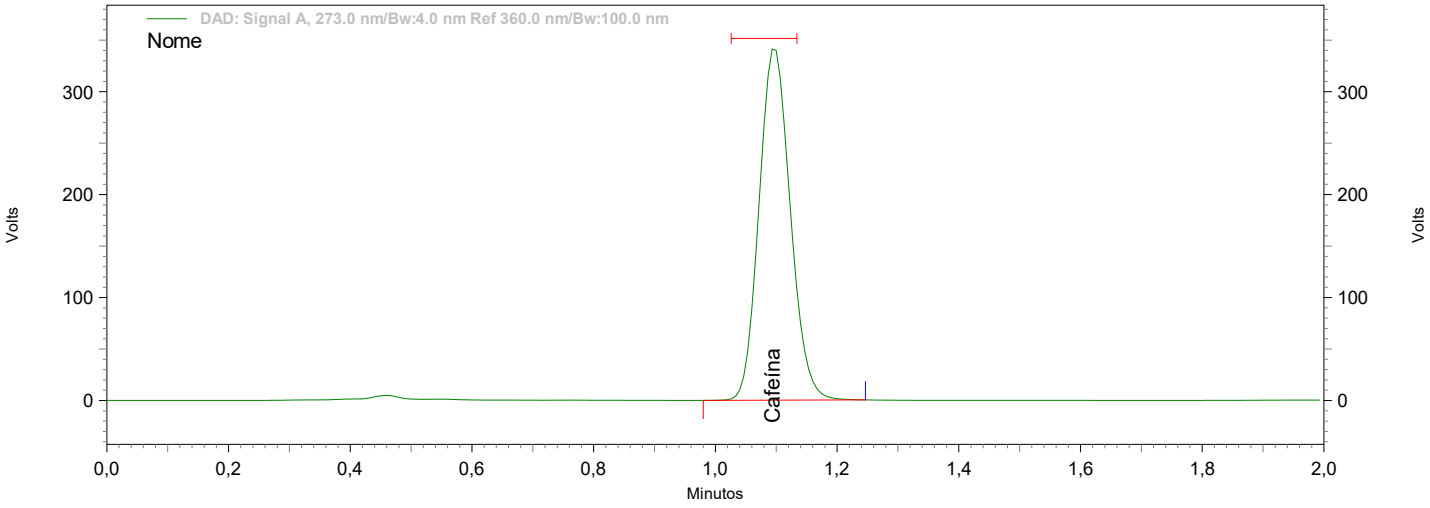

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,093	163839879	0,000	45772255


Totais		163839879	0,000	45772255

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Precisão do Injetor - LIIN_05

Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 13-20-09 (GMT -03-00).rslt\LIIN_05_021.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\Qualificação.met
Acquired: 20/03/2024 12:55:35 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 13:40:15 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: LIIN_05
Vial: P1-A9 Volume: 20 uL

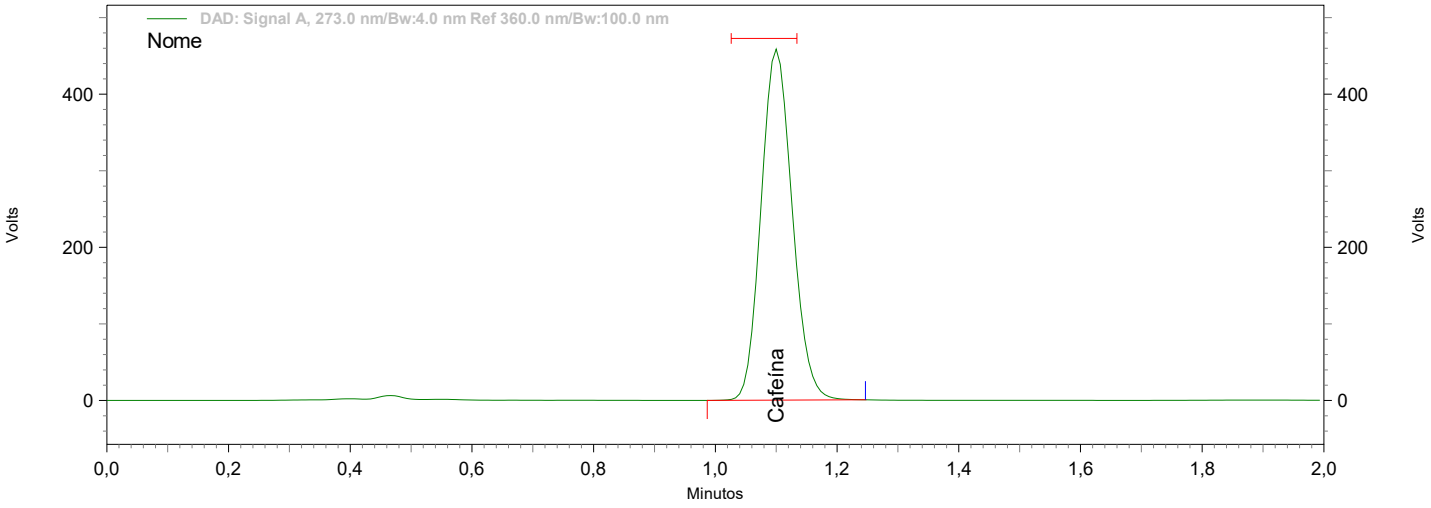

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,100	218473587	0,000	61530314

Totais		218473587	0,000	61530314


PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste Sinal/Ruído do Detector - RELB_02


Data File: C:\Enterprise\Projects\Ibuprofeno 100 mg\Result\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 15-08-10 (GMT -03-00).rslt\RELB_02_022.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\RELB.met
Acquired: 20/03/2024 12:58:56 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 15:14:00 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1


TAG:	UPL-001 (Off-line)	Amostra:	RELB_02
Vial:	P1-B1	Volume:	20 uL

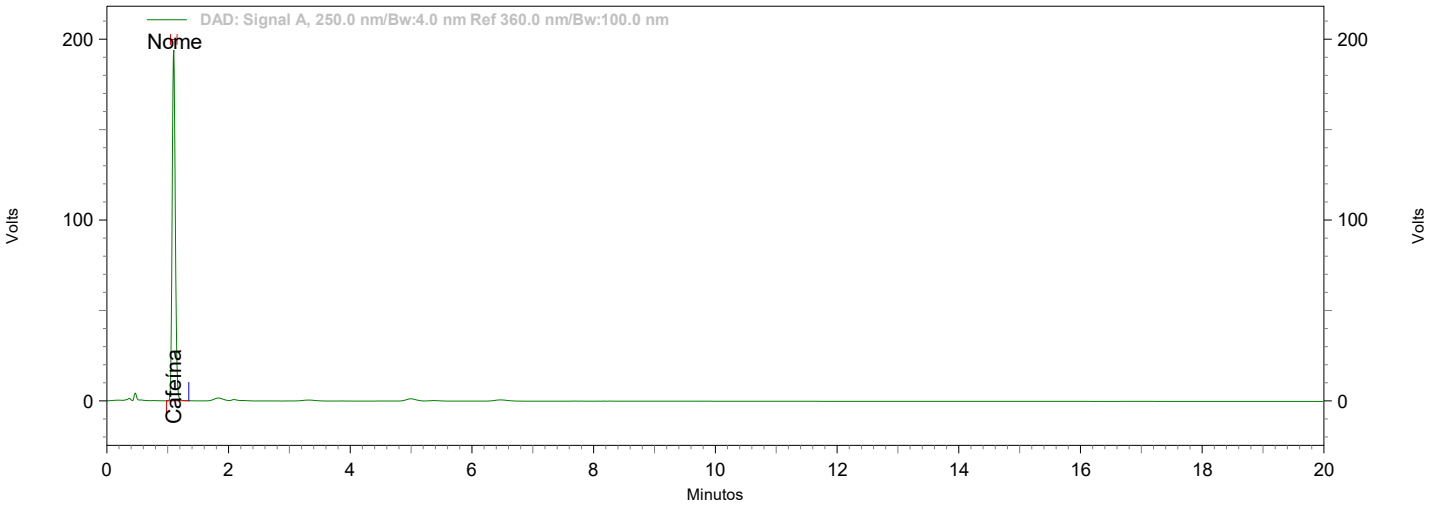

Estabilidade da Linha de Bas

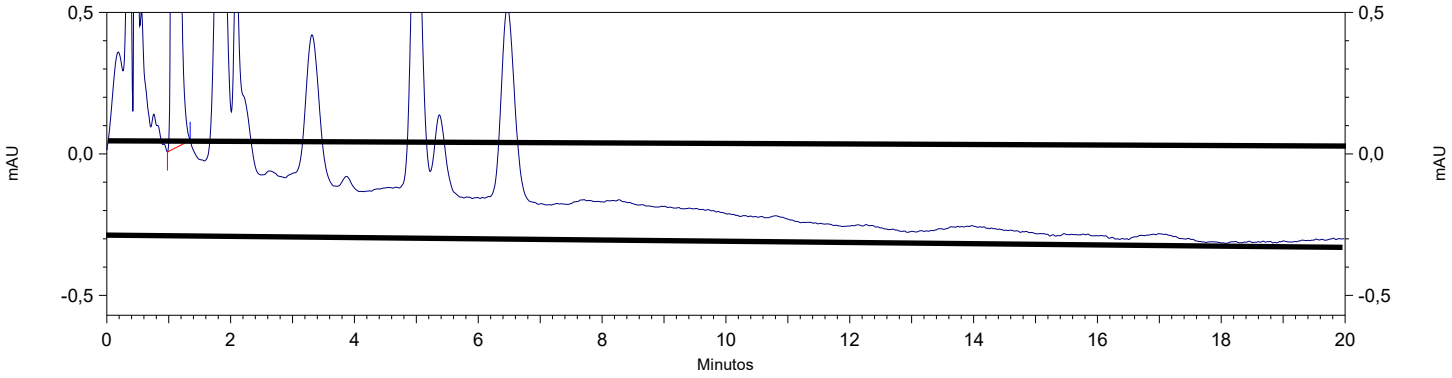


Ruído- Noise

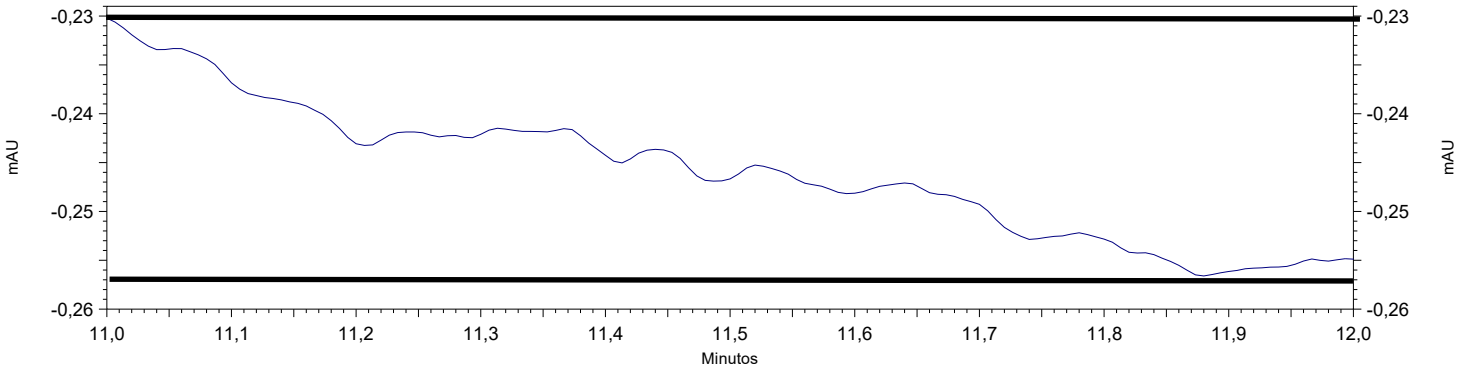

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Altura do Pico

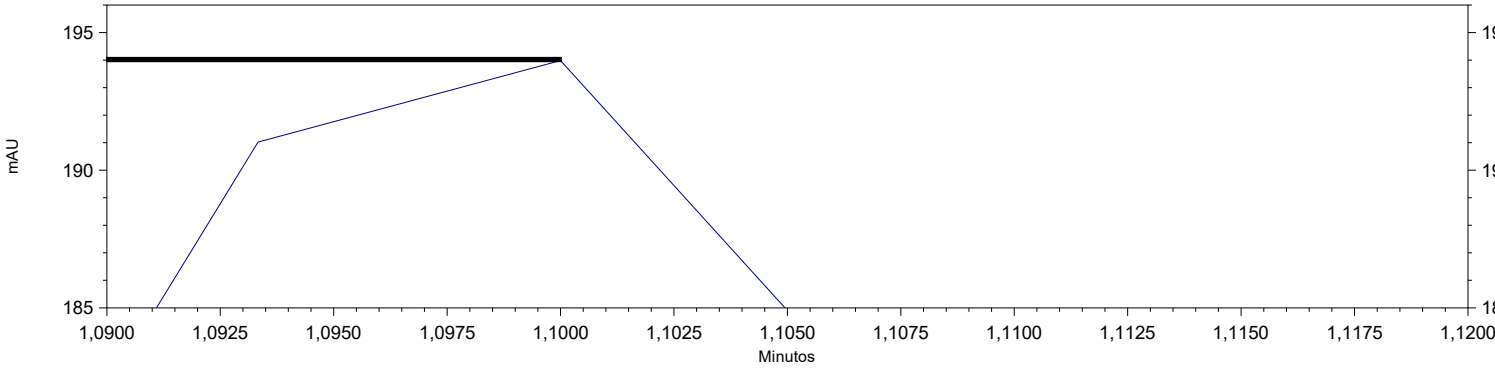

Channel A

Resultados DAD:
Signal A, 250.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
Cafeína	1,100	93218545	0,000	26033140,00


Totais		93218545	0,000	26033140,00

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente AB

Data File: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\Results\Gradientes.seq_005.rslt\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 16-12-41 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB_003.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\GRAD AB.met
Acquired: 20/03/2024 15:36:46 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 16:16:43 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: Gradiente AB
Vial: P1-A2 Volume: 0 uL

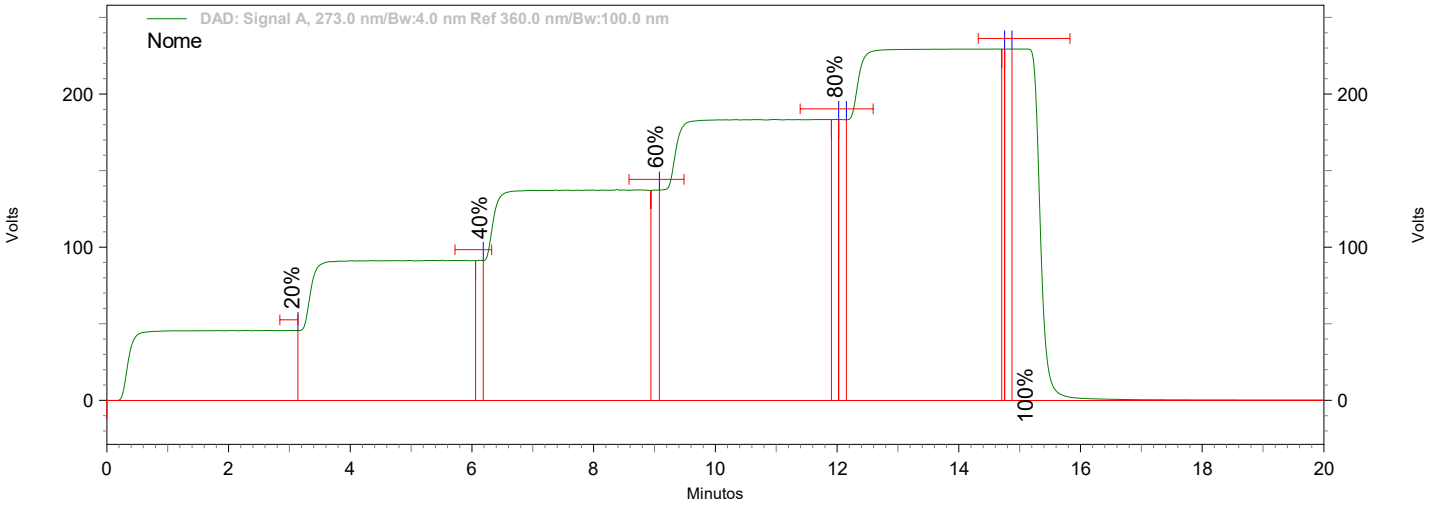

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm


Name	Time	Area	Amount	Altura
20%	3,047	1019132265	0,000	6123249
40%	6,133	93170278	0,000	12270420
60%	9,020	154728697	0,000	18432354
80%	11,973	177171418	0,000	24612235
	12,060	186943998	0,000	24607125
	14,727	86178573	0,000	30778209
	14,840	221605459	0,000	30778973
100%	15,093	904691399	0,000	30780501
Totais		2843622087	0,000	178383066

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Test e Gradiente dos Canais - Gradiente CD

Data File: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\Results\Gradientes.seq_005.rslt\UPL-001 (Off-line).35 2024-03-20 16-17-34 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CD_004.dat
Method: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2024\method\GRAD CD.met
Acquired: 20/03/2024 15:57:15 (GMT -03:00)
Printed: 20/03/2024 16:45:53 (GMT -03:00)

Sample Amt: 1
Multiplier: 1
TAG: UPL-001 (Off-line) Amostra: Gradiente CD
Vial: P1-A2 Volume: 0 uL

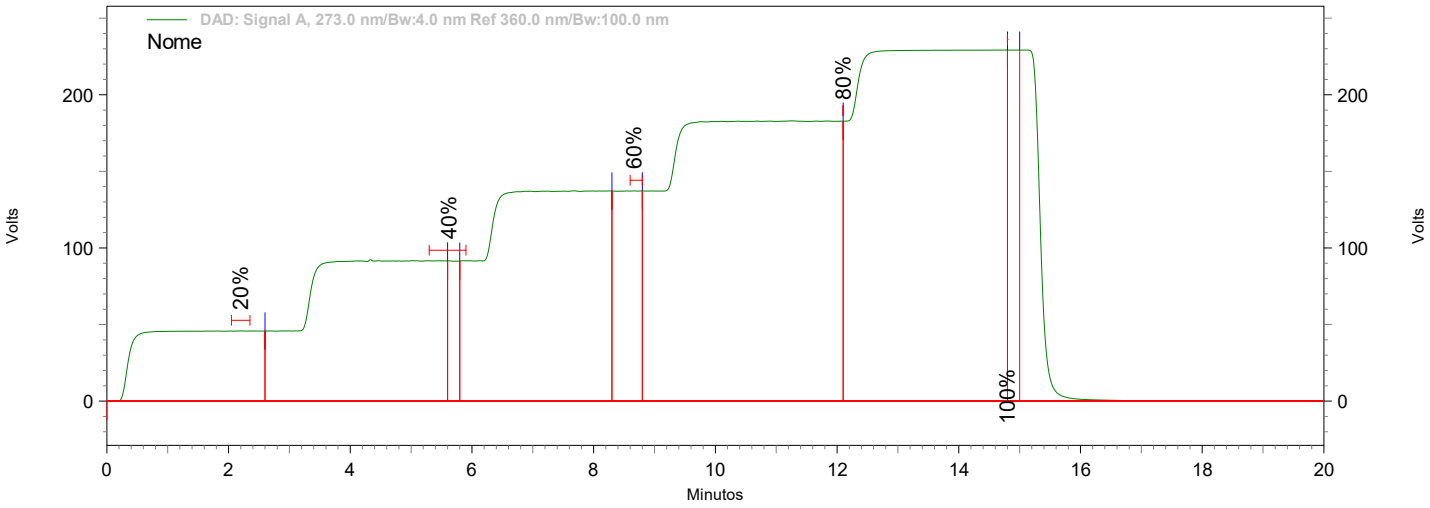

Channel A

Resultados DAD: Signal A, 273.0 nm/Bw:4.0 nm Ref 360.0 nm/Bw:100.0 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
20%	2,207	825767784	0,000	6150800
	4,333	1932481785	0,000	12395178
40%	5,620	147257934	0,000	12291852
	7,680	2556714281	0,000	18425181
60%	8,667	552186392	0,000	18419770
	11,267	4651458489	0,000	24558711
80%	12,100	4885291325	0,000	24526990
100%	14,800	369058424	0,000	30753968
	18,553	664045407	0,000	6163
Totais		16584261821	0,000	147528613