

# *Teste de Exatidão do Detector - EDUV*

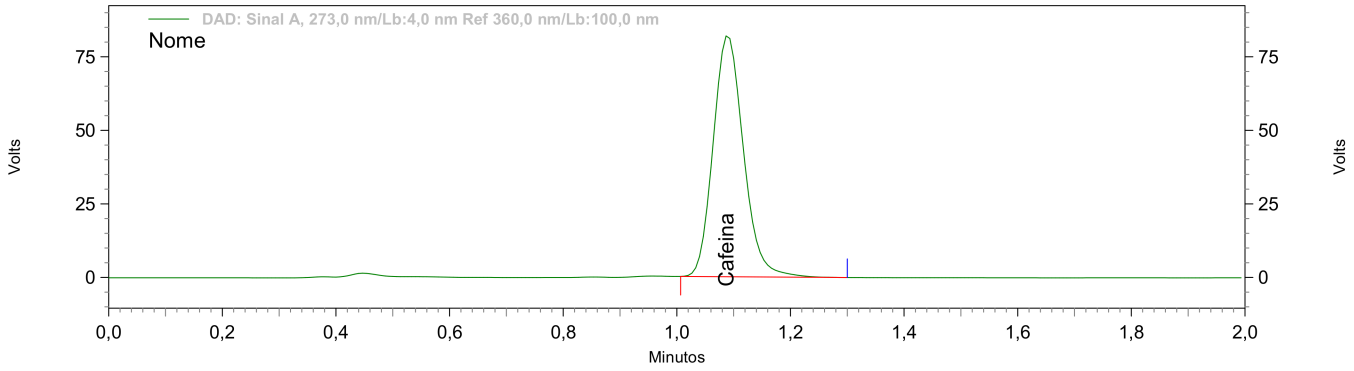

**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\EDUV.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\EDUV_001.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:25:05 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:22:45 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** EDUV
**Vial:** 1 **Volume:** 10 µL

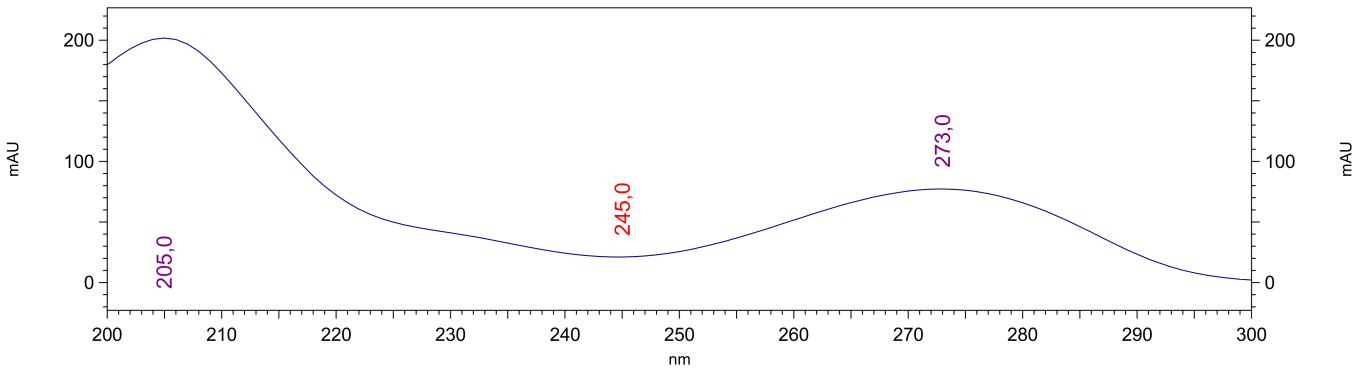



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 40800939 | **10987749** |
| Totais | | | 40800939 | **10987749** |

# *Teste de Precisão do Injetor - Branco 01*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Branco 01_002.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:28:25 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:25:05 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** Branco 01
**Vial:** 2 **Volume:** 10 µL

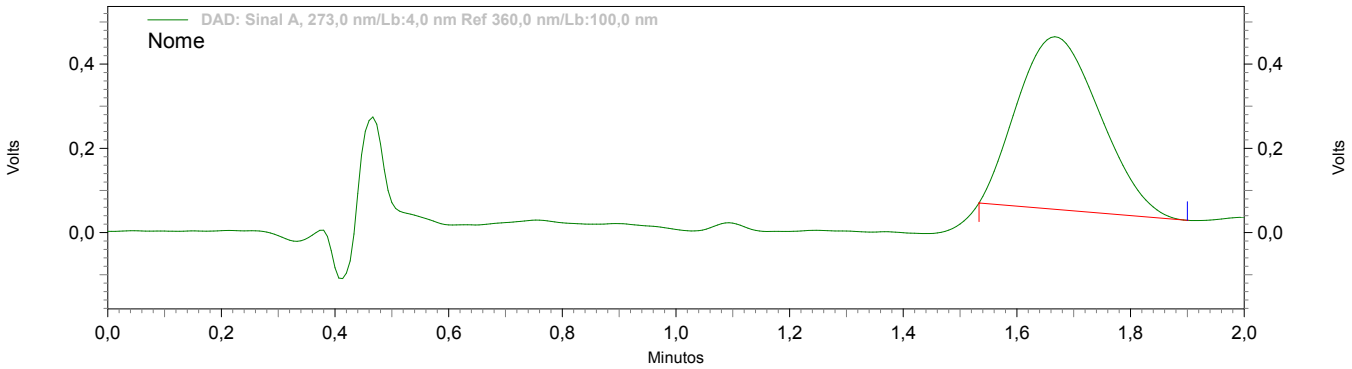



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| | Cafeina | | | |
| Totais | | | | |

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 01*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01_003.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:32:16 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:26:03 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 01
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

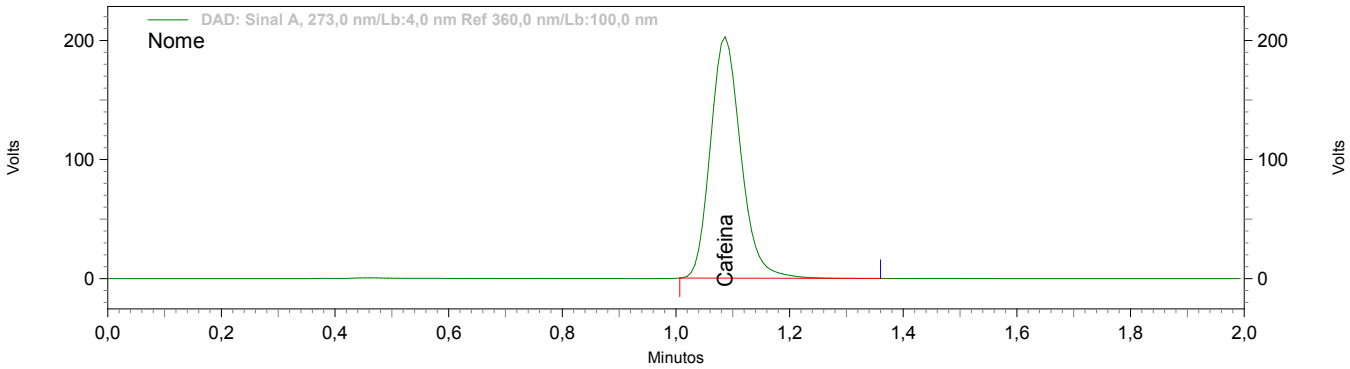



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101290076 | **27218085** |
| Totais | | | 101290076 | **27218085** |

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 02*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02_004.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:36:05 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:26:38 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 02
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

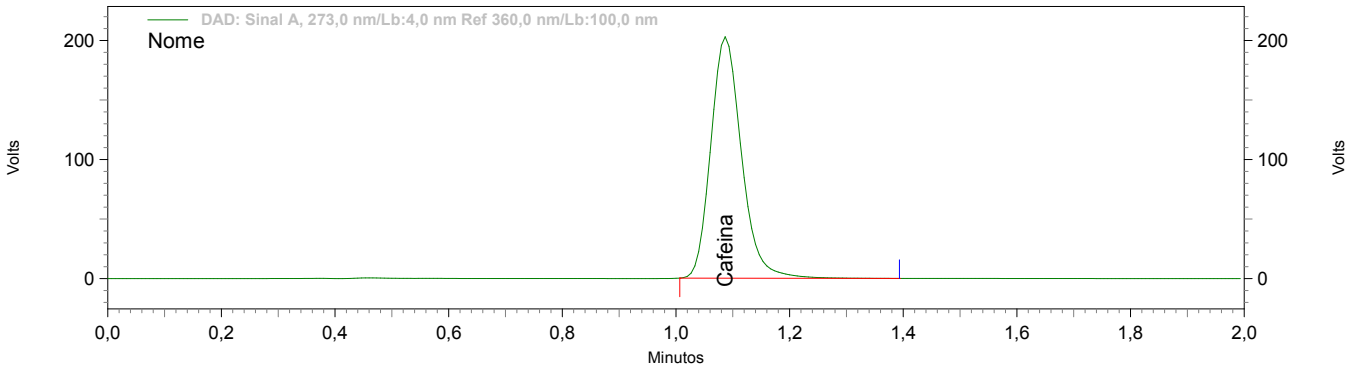



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101982491 | **27224218** |
| Totais | | | 101982491 | **27224218** |

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 03*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03_005.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:40:00 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:27:21 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 03
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

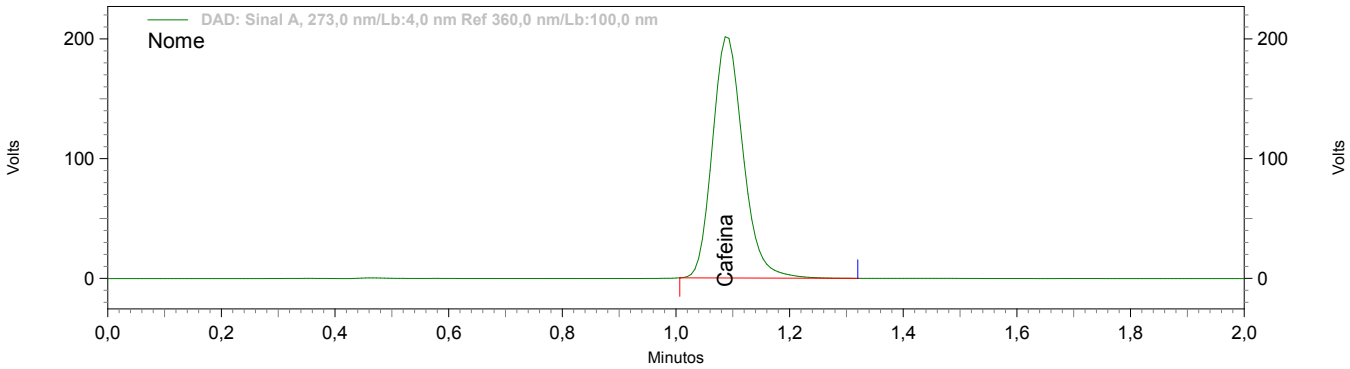



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101696774 | **27049413** |
| Totais | | | 101696774 | **27049413** |

# *Teste de Precisão do Injetor - Branco 02*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Branco 02_006.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:43:25 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:27:56 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** Branco 02
**Vial:** 2 **Volume:** 10 µL

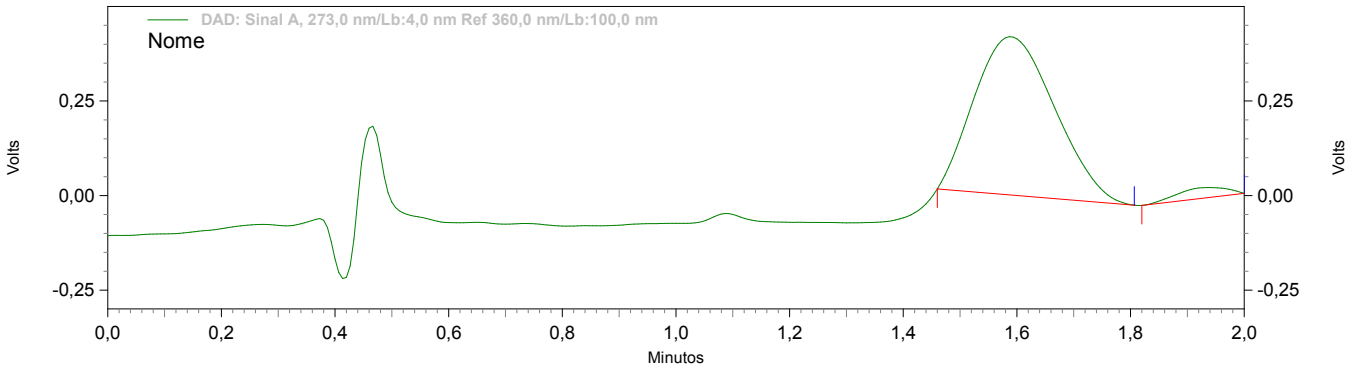



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| | Cafeina | | | |
| Totais | | | | |

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 04*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 10-49-35 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04_007.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:47:16 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:28:28 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 04
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

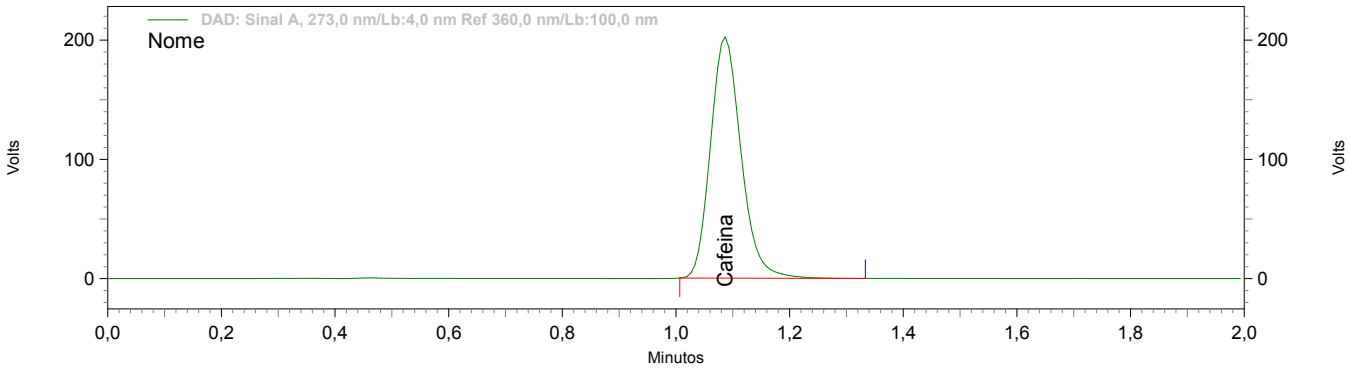



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101330430 | **27179673** |
| Totais | | | 101330430 | **27179673** |

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 05*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05_008.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:51:13 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:36:13 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 05
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

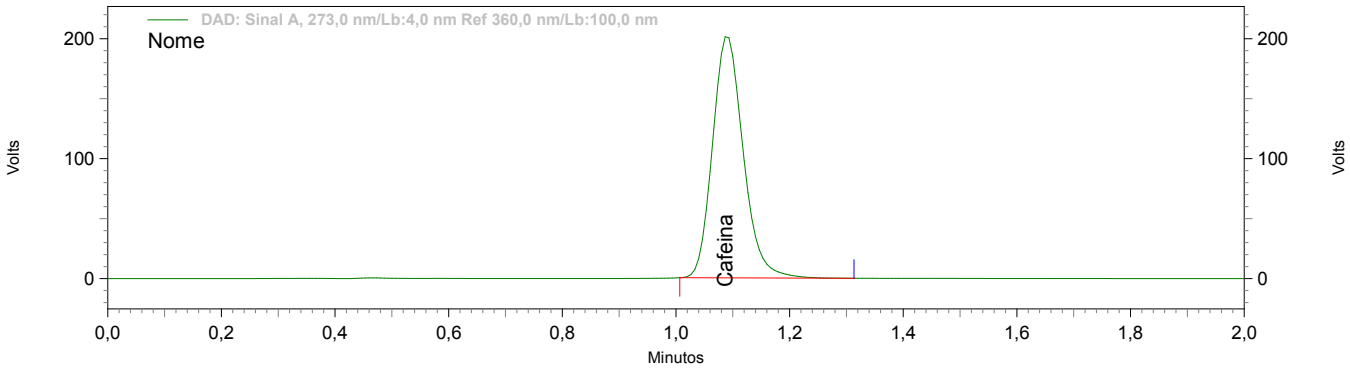


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101501828 | **26987898** |
| Totais | | | 101501828 | **26987898** |

**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - PCIN 06*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06_009.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:55:04 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:36:58 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** PCIN 06
**Vial:** 3 **Volume:** 10 µL

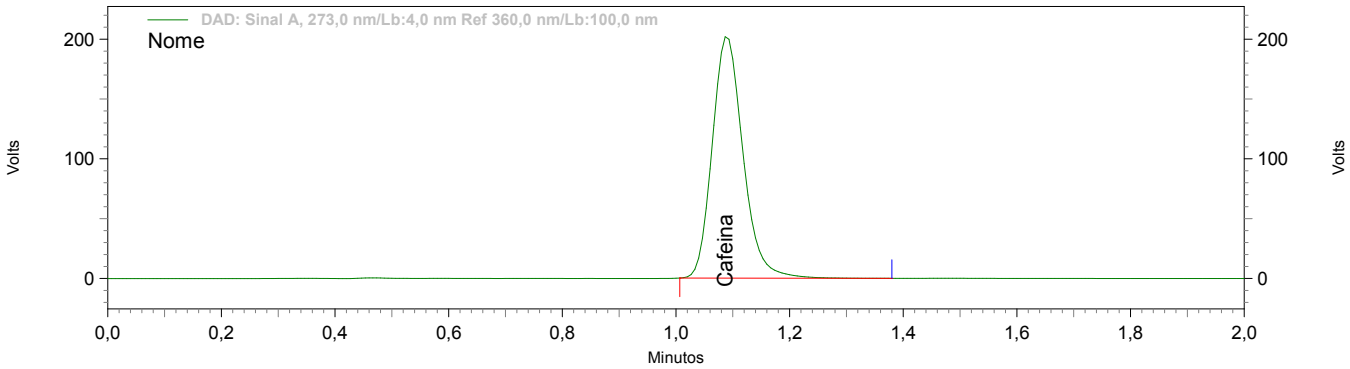


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 101941677 | **27084285** |
| Totais | | | 101941677 | **27084285** |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - Branco 03*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Branco 03_010.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 10:58:30 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:37:41 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** Branco 03
**Vial:** 2 **Volume:** 10 µL

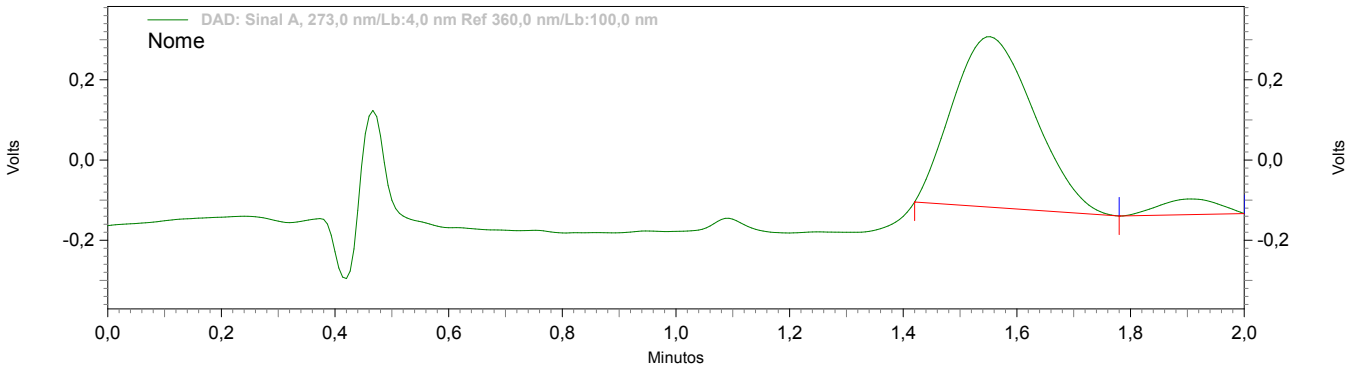


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| | Cafeina | | | |
| Totais | | | | |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LDUV 01*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01_011.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:02:20 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:39:44 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LDUV 01
**Vial:** 4 **Volume:** 10 µL

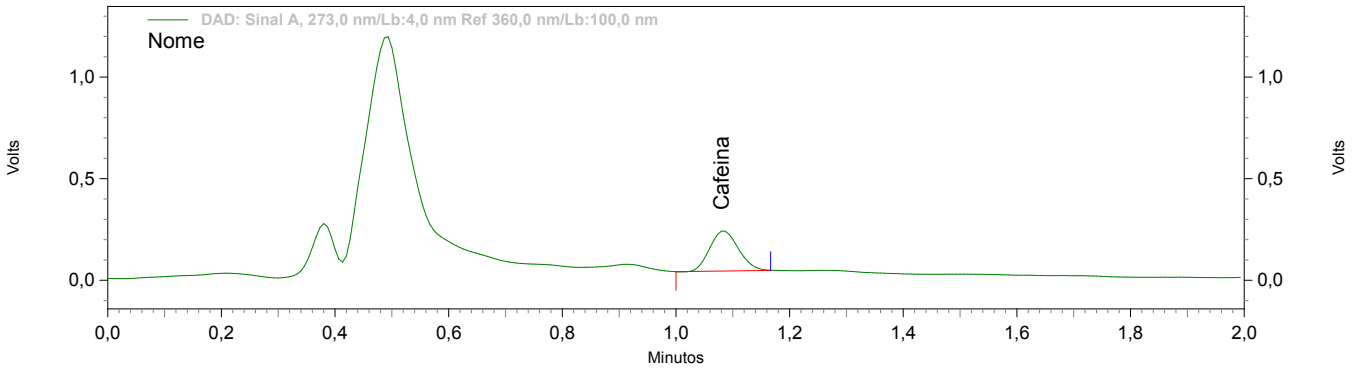


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,080 | 92540 | **26320** |
| Totais | | | 92540 | **26320** |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LDUV 02*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02_012.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:06:15 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:40:38 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LDUV 02
**Vial:** 5 **Volume:** 10 µL

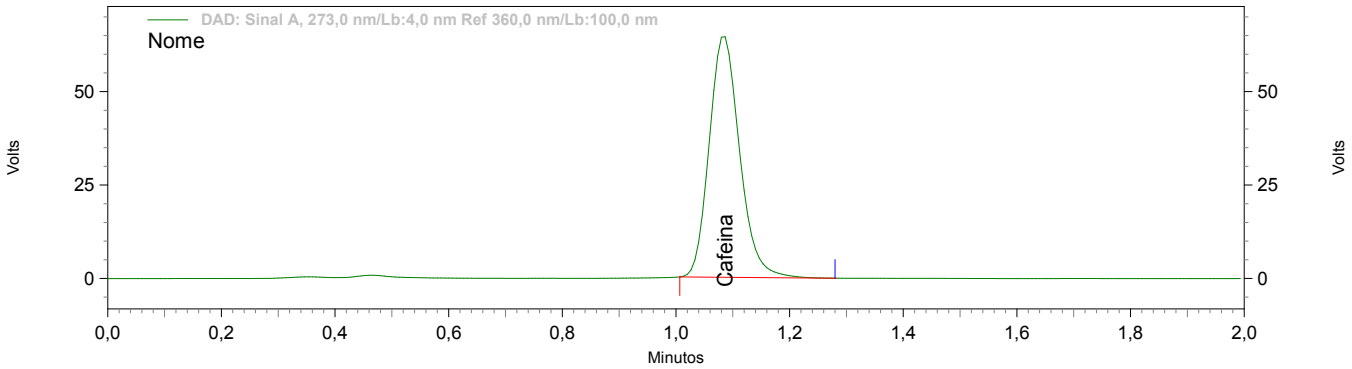


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 32239156 | **8642106** |
| Totais | | | 32239156 | **8642106** |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LDUV 03*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03_013.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:10:08 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:45:40 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LDUV 03
**Vial:** 6 **Volume:** 10 µL

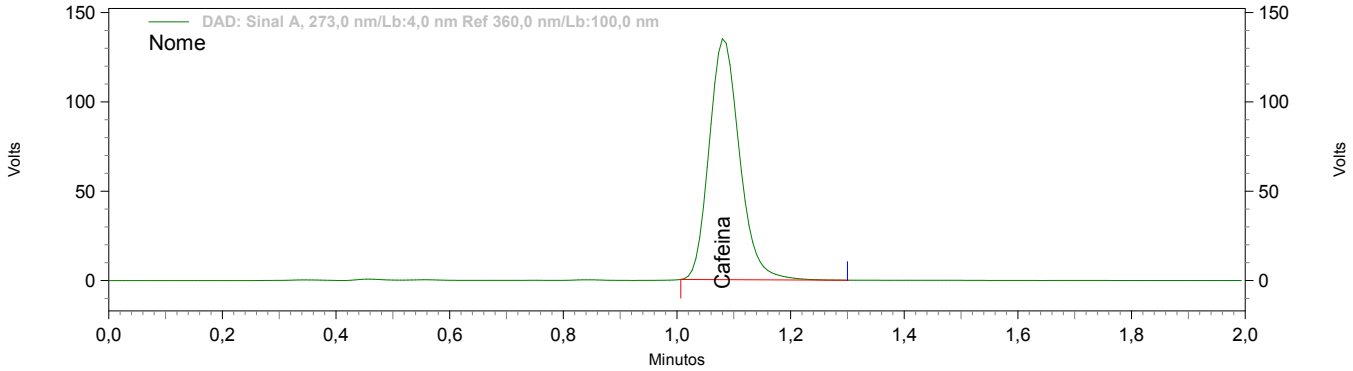


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,080 | 67254805 | **18103870** |
| Totais | | | 67254805 | **18103870** |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LDUV 04*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04_014.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:14:03 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:51:18 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LDUV 04
**Vial:** 7 **Volume:** 10 µL

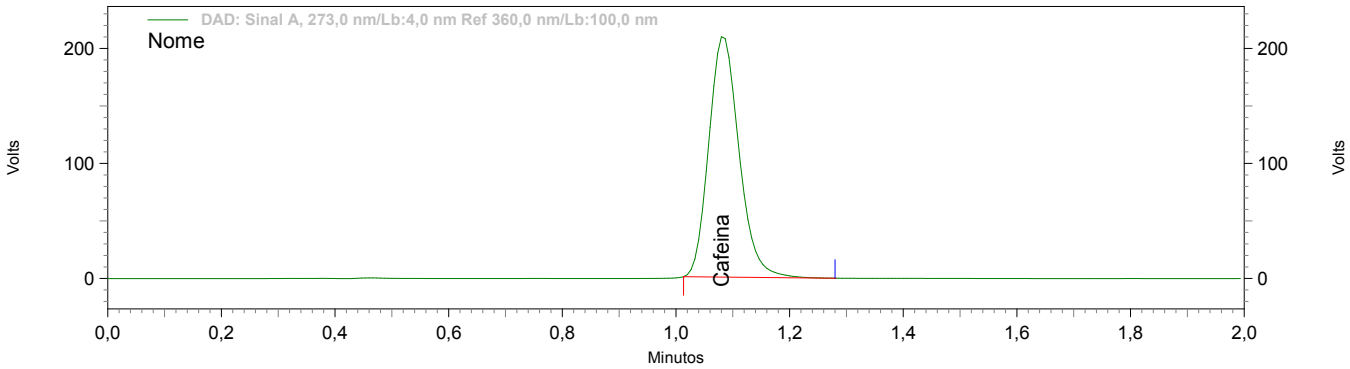


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,080 | 103990894 | **28057951** |
| Totais | | | 103990894 | **28057951** |

**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LDUV 05*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 11-33-38 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05_015.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:17:58 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 11:48:15 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LDUV 05
**Vial:** 8 **Volume:** 10 µL

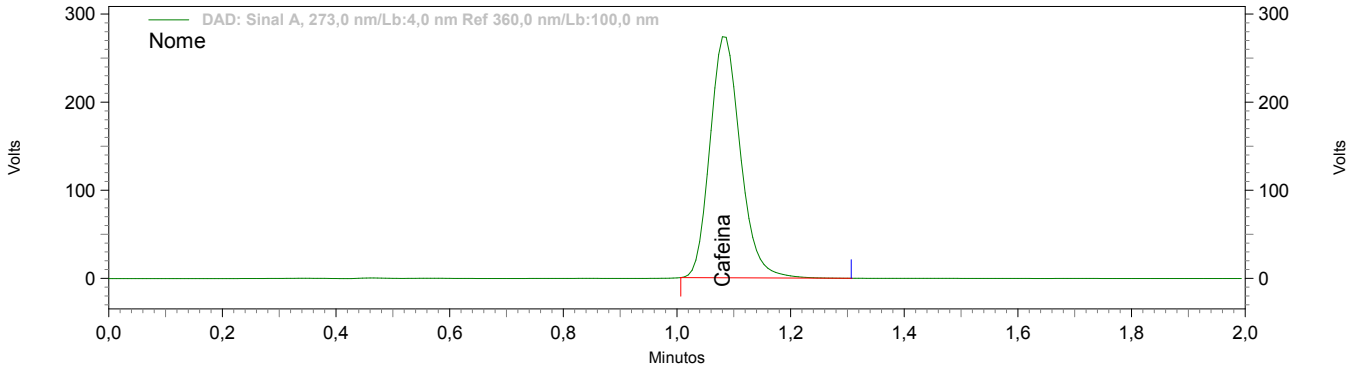


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,080 | 136838088 | **36729828** |
| Totais | | | 136838088 | **36729828** |

**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LIIN 01*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01_017.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:43:31 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 13:53:04 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LIIN 01
**Vial:** 9 **Volume:** 0,1 µL

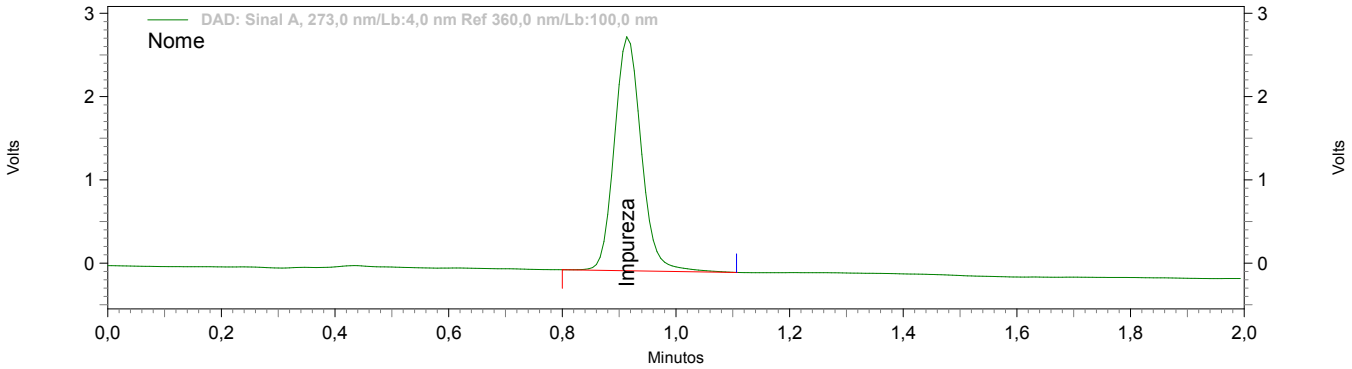


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impureza<br>Cafeina | 0,913 | 1244797 | **377148** |
| Totais | | | 1244797 | **377148** |

**Resultados 200,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|


**Resultados Representação Gráfica de Espectro Máx**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|

# *Teste de Precisão do Injetor - LIIN 02*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02_018.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:47:18 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 13:56:01 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LIIN 02
**Vial:** 9 **Volume:** 5 µL

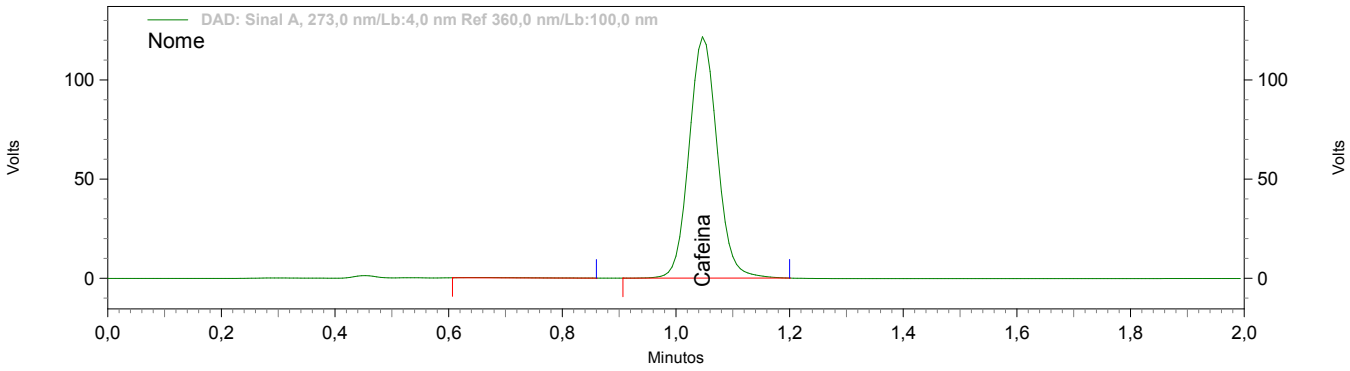



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cafeina | 1,047 | 56182696 | **16338841** |
| Totais | | | 56182696 | **16338841** |

# *Teste de Precisão do Injetor - LIIN 03*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03_019.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:51:09 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 13:57:24 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LIIN 03
**Vial:** 9 **Volume:** 10 µL

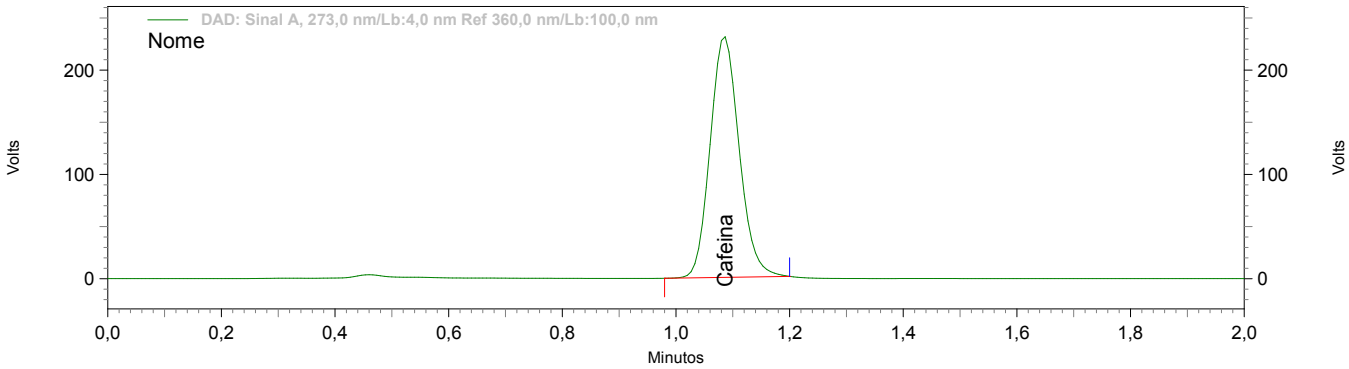



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,087 | 110233365 | **30972524** |
| Totais | | | 110233365 | **30972524** |

# *Teste de Precisão do Injetor - LIIN 04*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04_020.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:55:04 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 13:58:38 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LIIN 04
**Vial:** 9 **Volume:** 15 µL

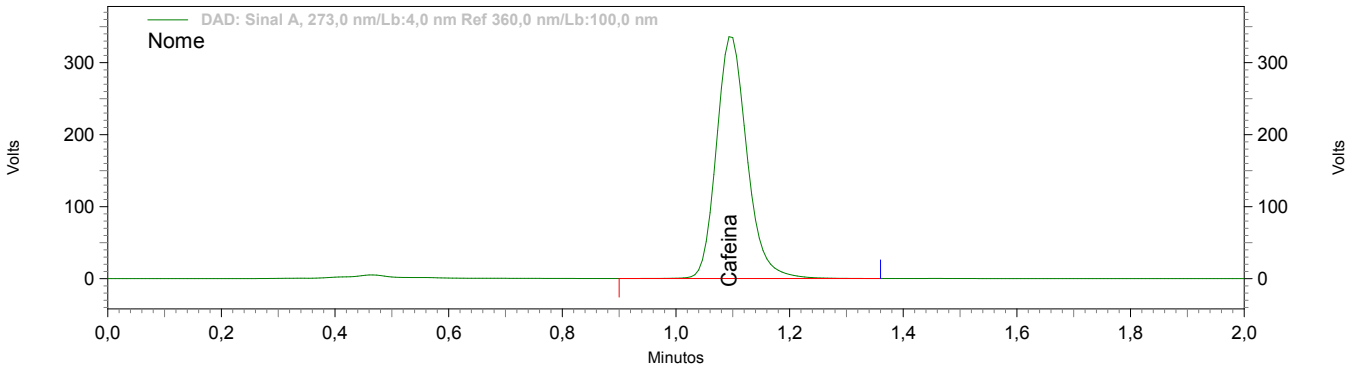



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,093 | 168674686 | **45075167** |
| Totais | | | 168674686 | **45075167** |

# *Teste de Precisão do Injetor - LIIN 05*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\Qualificação.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 13-47-28 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05_021.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 11:59:07 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 13:59:29 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** LIIN 05
**Vial:** 9 **Volume:** 20 µL

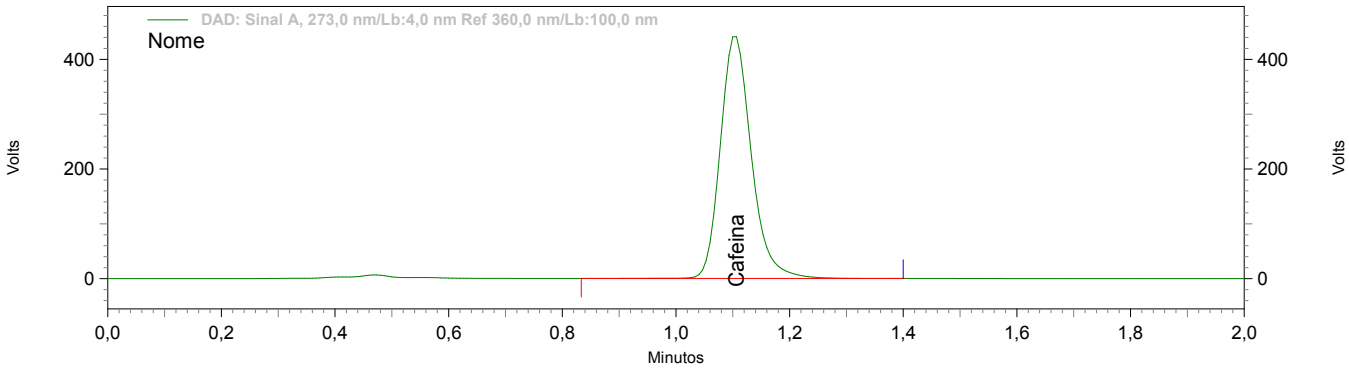



**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cafeina | 1,107 | 224875769 | **59193054** |
| Totais | | | 224875769 | **59193054** |


Teste de Estabilidade da Linha de Base/ Sinal-Ruído - RELB

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-04-00 (GMT -03-00).rslt\RELB_022.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-04-00 (GMT -03-00).rslt\Sinal Ruído.met
Adquirido: 21/03/2024 12:02:38 (GMT -03:00)
Impresso: 21/03/2024 14:14:48 (GMT -03:00)


Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL-0008 (Off-line) Amostra: RELB
Vial: 10 Volume: 20 µL

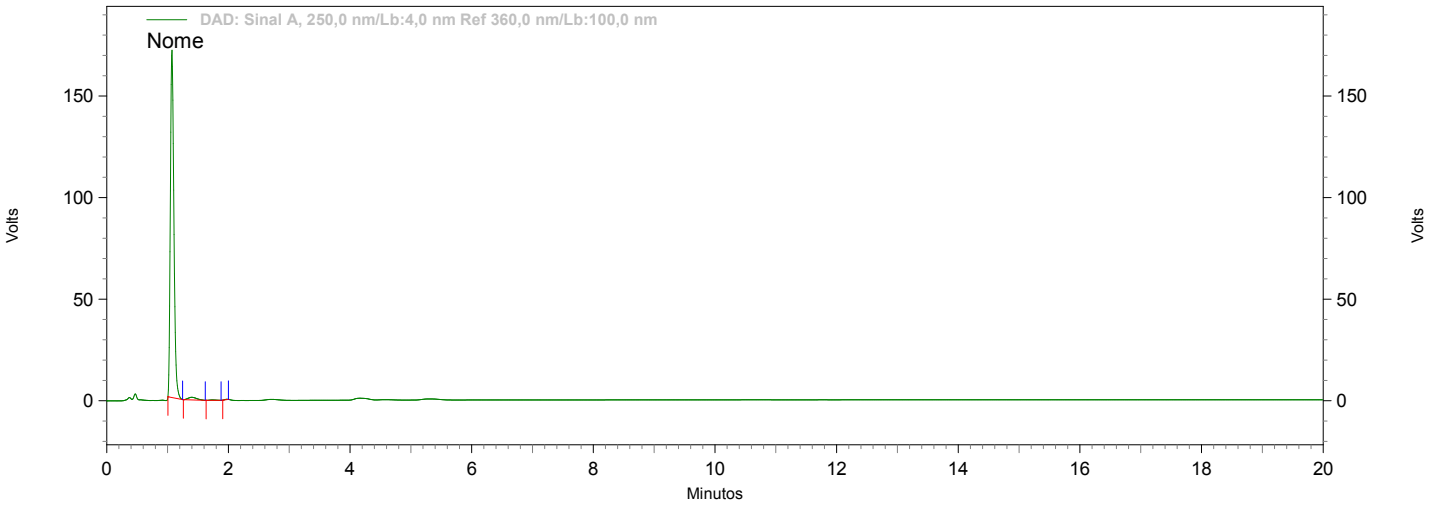



Estabilidade da Linha de Base

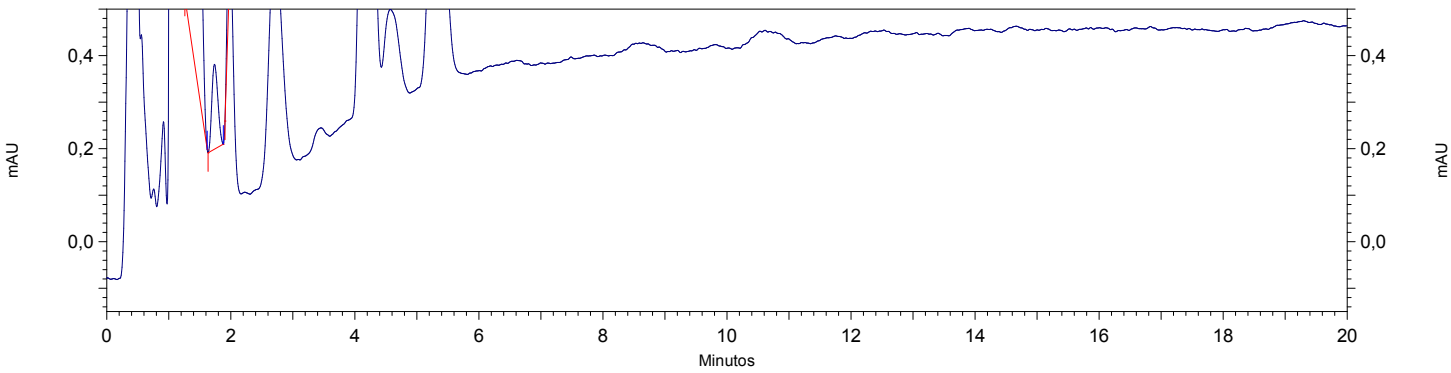


Ruído - Noise

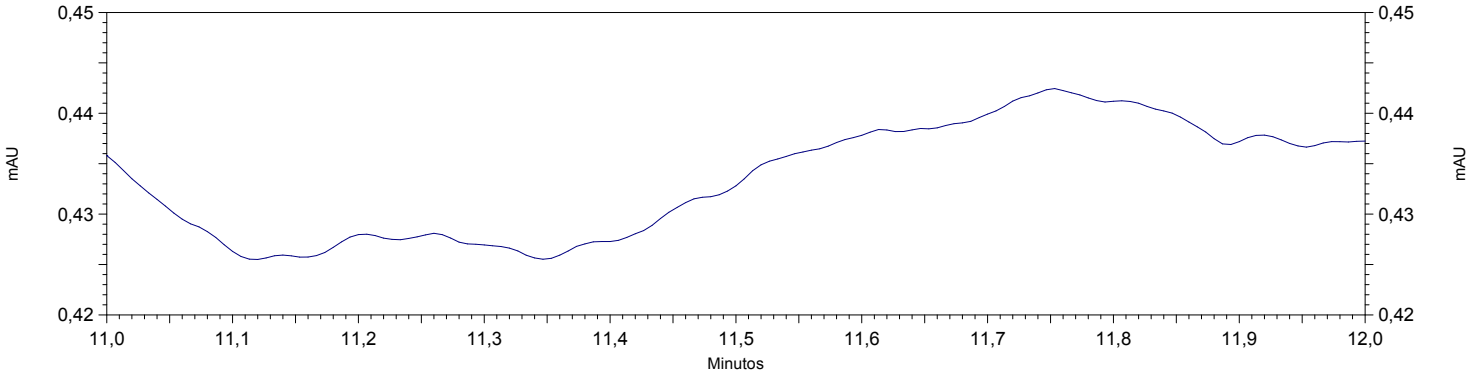

Altura do Pico

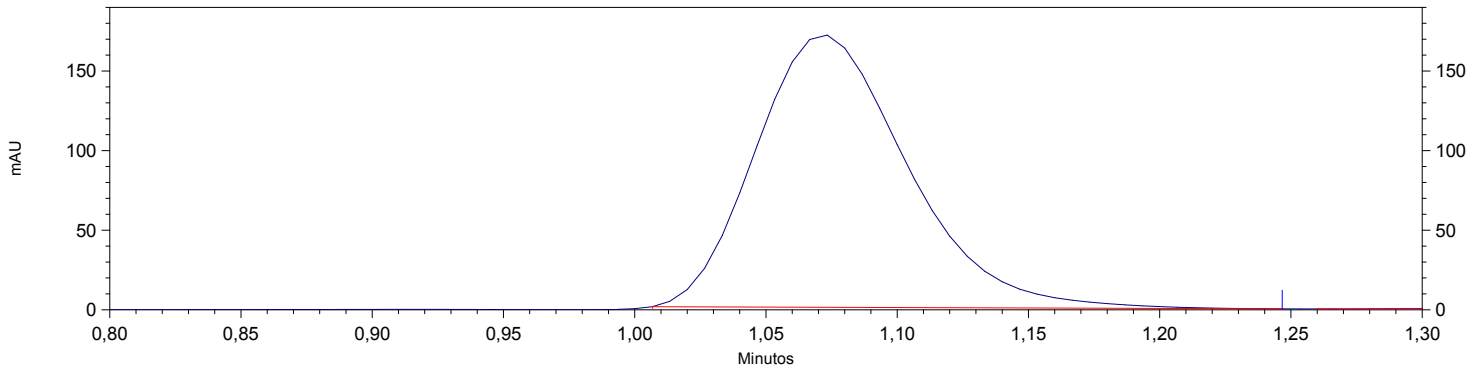


# Channel A

**Resultados DAD: Sinal A,**
**250,0 nm/Lb:4,0 nm Ref**
**360,0 nm/Lb:100,0 nm**


| Name | Time | Area | Amount |
|---|---|---|---|
| | 1,073 | 92407053 | 0,000 |
| | 1,400 | 1724689 | 0,000 |
| | 1,740 | 164959 | 0,000 |
| | 1,973 | 81821 | 0,000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Totais | | 94378522 | 0,000 |

# *Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente_AB*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-16-24 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-16-24 (GMT -03-00).rslt\Gradiente_AB_001.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 13:23:22 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 14:52:59 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** Gradiente_AB
**Vial:** 2 **Volume:** 0 µL

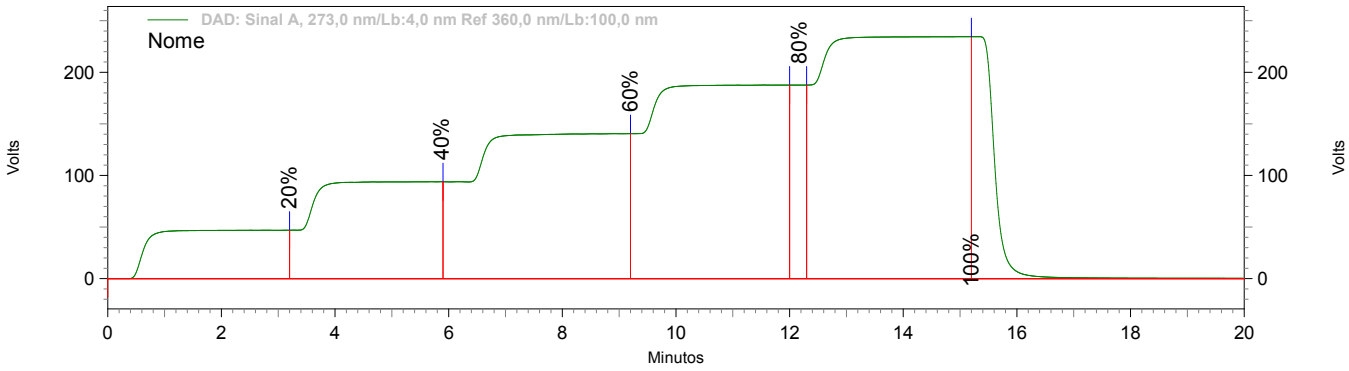


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**


| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 3,193 | 968338159 | **6299079** |
| 2 | 40% | 5,873 | 1877022294 | **12601221** |
| 3 | 60% | 9,193 | 3449730978 | **18856197** |
| 5 | 80% | 12,167 | 453210144 | **25179645** |
| 6 | 100% | 15,193 | 5347745992 | **31471953** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Totais | | | 12096047567 | **94408095** |

# *Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente_CD*



**Método:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-16-24 (GMT -03-00).rslt\Gradiente CD.met
**Arquivo de dados:** C:\Enterprise\Projects\Maxalgina\Result\HPL-0008 (Off-line).44 2024-03-21 14-16-24 (GMT -03-00).rslt\Gradiente_CD_002.dat
**Usuário:** Administrador do sistema (Admin)
**Adquirido:** 21/03/2024 13:44:03 (GMT -03:00)
**Impresso:** 21/03/2024 14:50:51 (GMT -03:00)
**TAG:** HPL-0008 (Off-line) **Amostra:** Gradiente_CD
**Vial:** 2 **Volume:** 0 µL

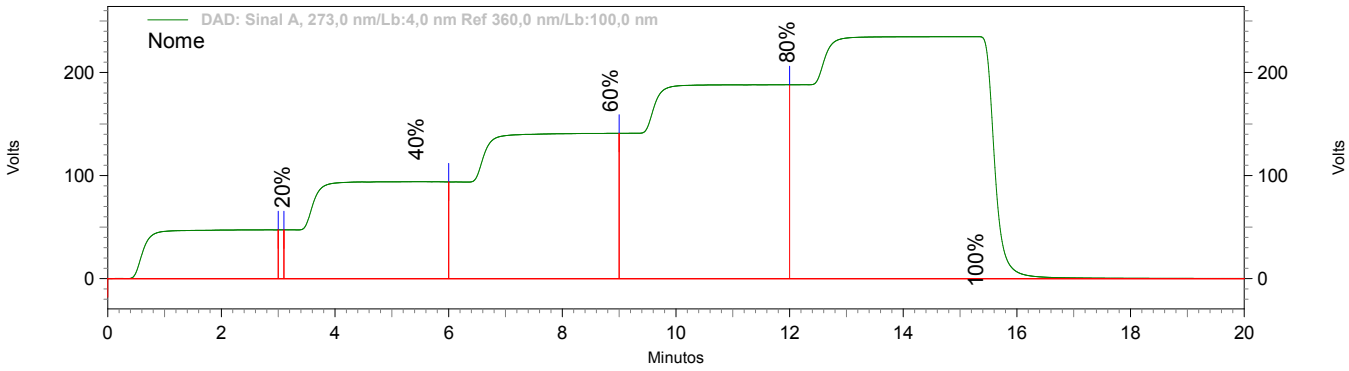


**Resultados DAD: Sinal A, 273,0 nm/Lb:4,0 nm Ref 360,0 nm/Lb:100,0 nm**

| *Número do Pico* | *Nome* | *Tempo de Retenção* | *Área* | *Altura* |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20% | 3,073 | 38108665 | **6352758** |
| 3 | 40% | 5,427 | 1994423219 | **12627687** |
| 4 | 60% | 8,847 | 3155325593 | **18925057** |
| 5 | 80% | 11,953 | 4303729359 | **25249085** |
| 6 | 100% | 15,280 | 6636683778 | **31506180** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Totais | | | 16128270614 | **94660767** |