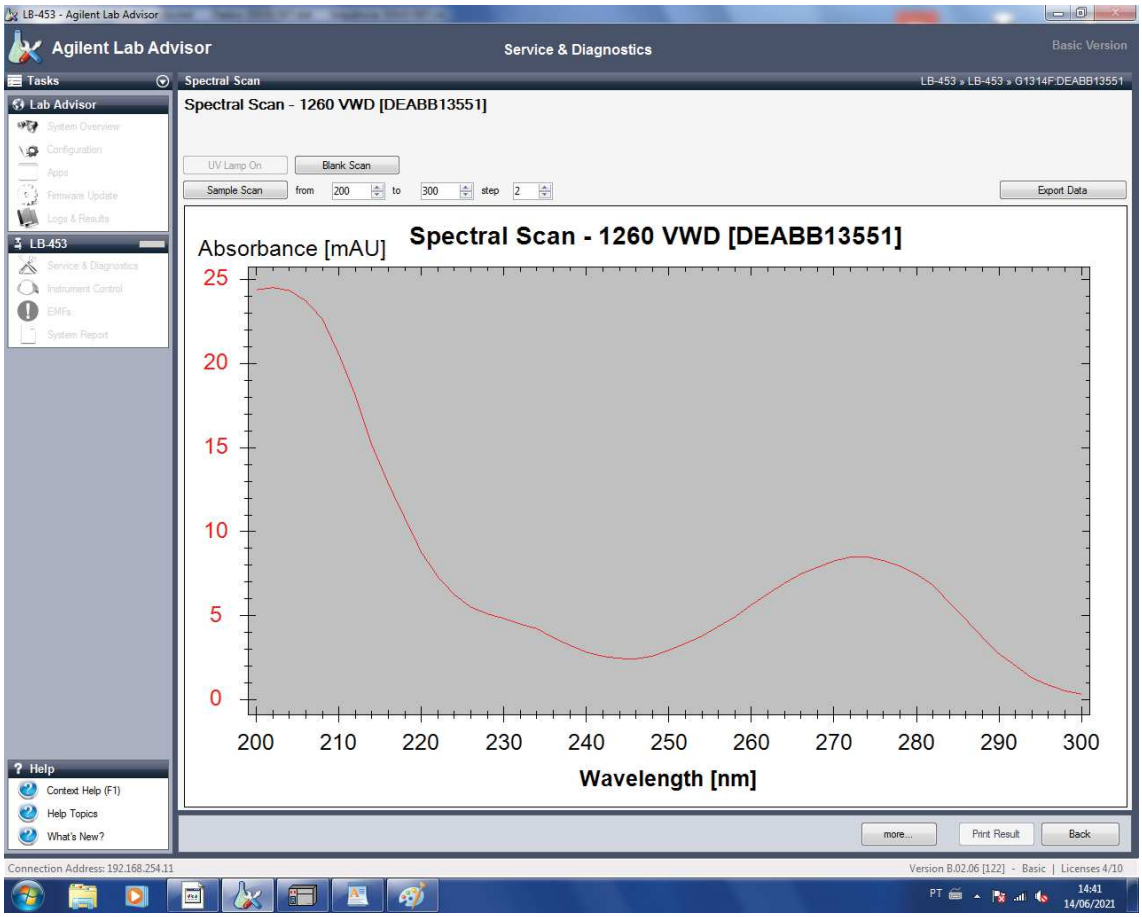
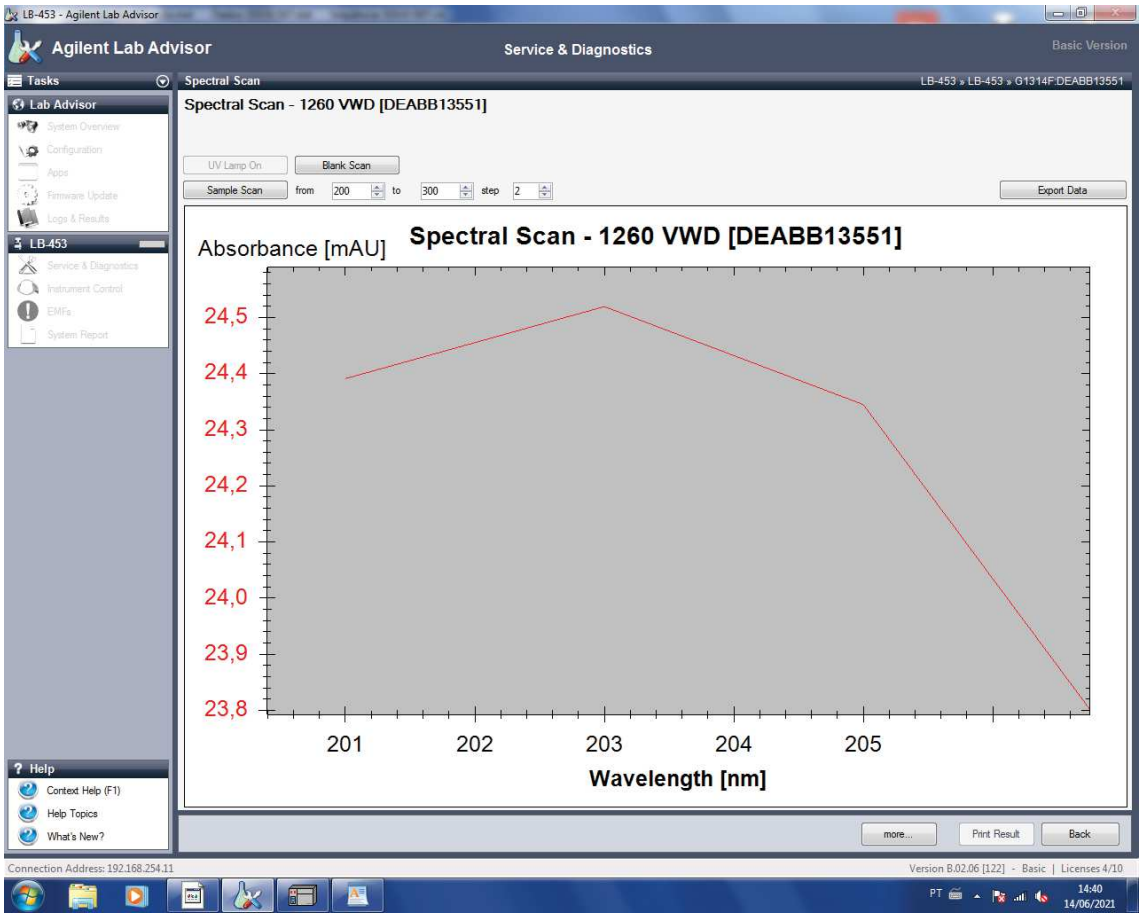
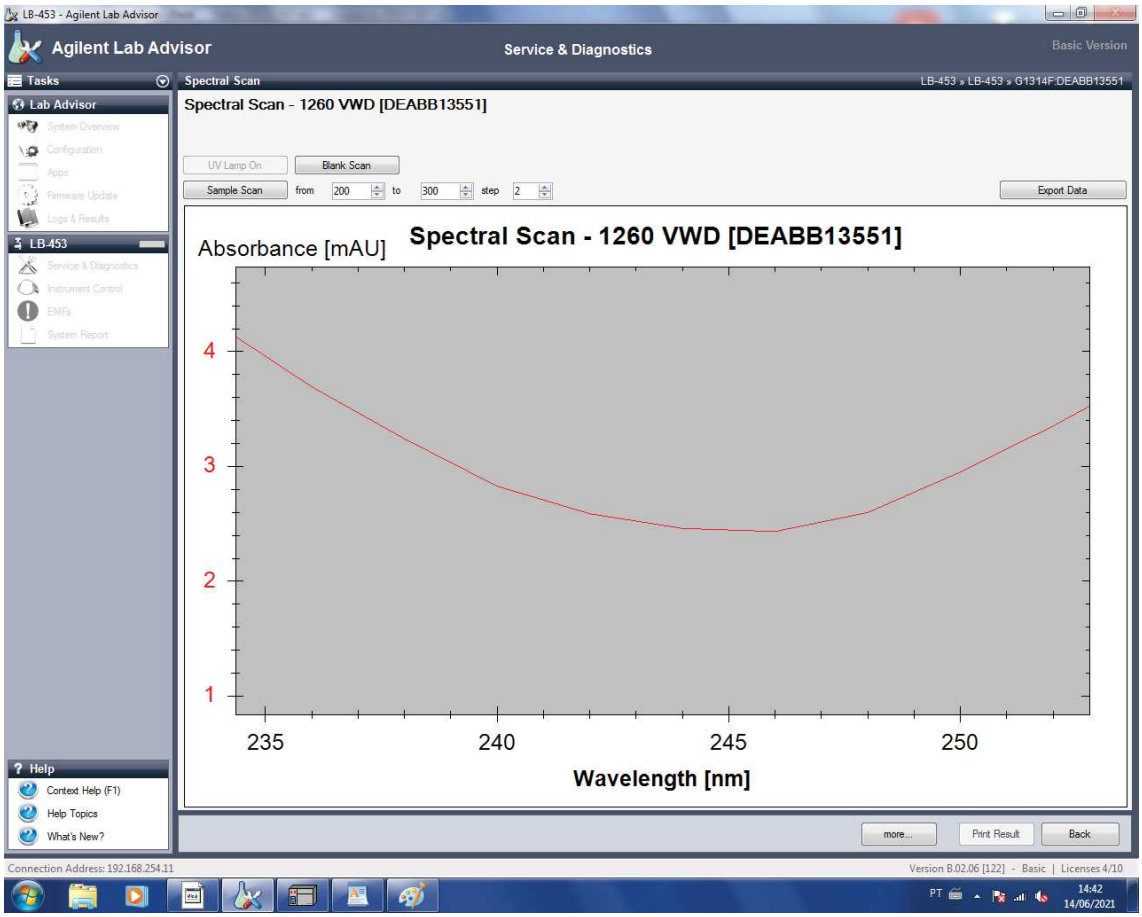
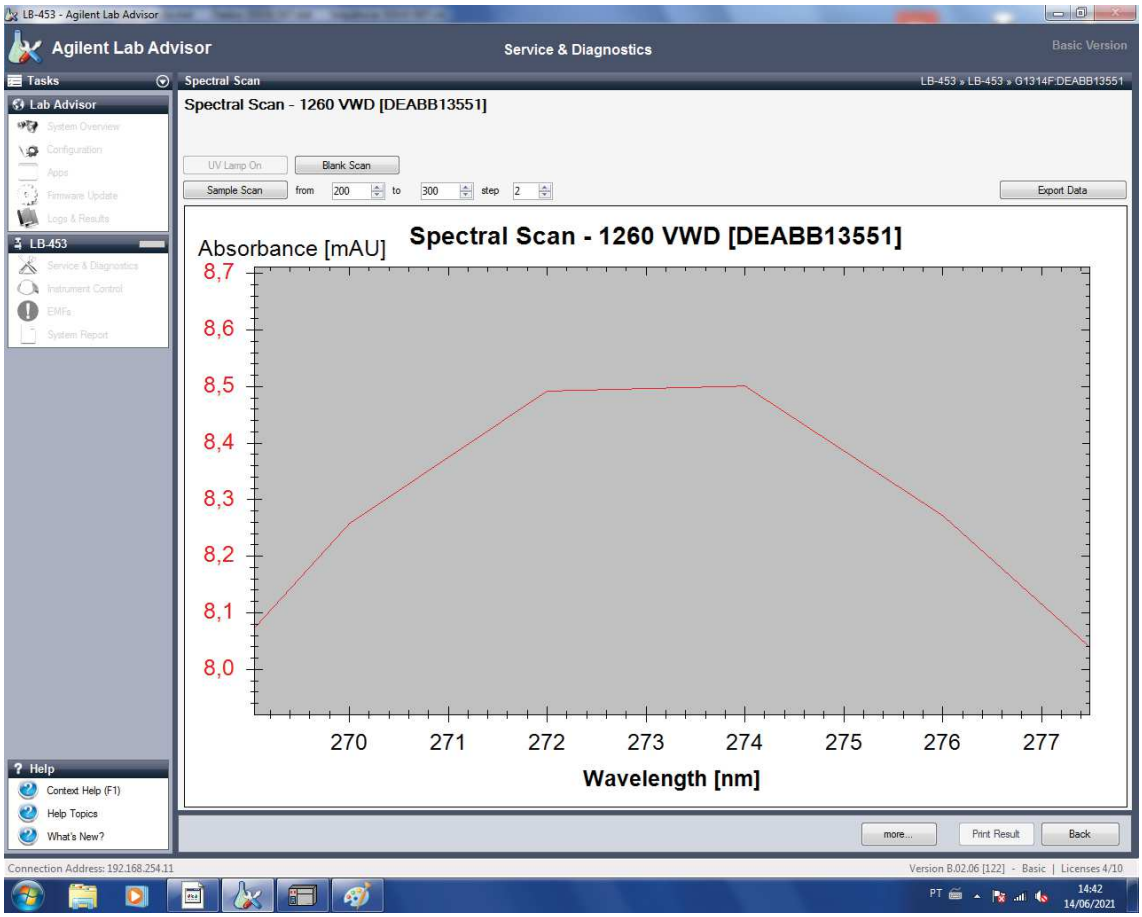

LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 200
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
25
20
15
10
5
0
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
PT
14:41
14/06/2021



LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 200
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
24,5
24,4
24,3
24,2
24,1
24,0
23,9
23,8
201
202
203
204
205
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
PT
14:40
14/06/2021


LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 200
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
4
3
2
1
235
240
245
250
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
PT
14:42
14/06/2021


LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 200
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
8,7
8,6
8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
8,0
270
271
272
273
274
275
276
277
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
PT
14:42
14/06/2021

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 14:48:57 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 14:55:06 (GMT -03:00)

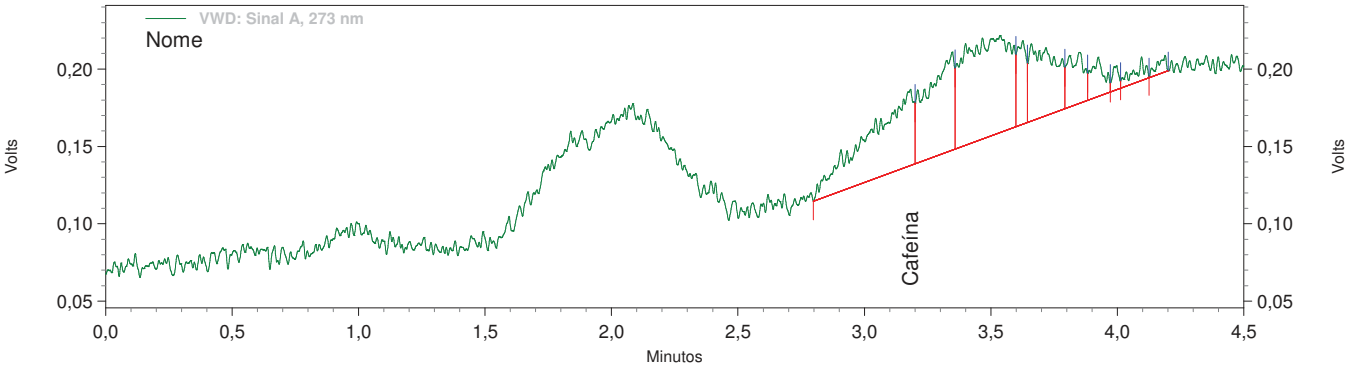


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,182	10746	**0,000**
Totais			10746	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 001.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 14:54:24 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:06:09 (GMT -03:00)

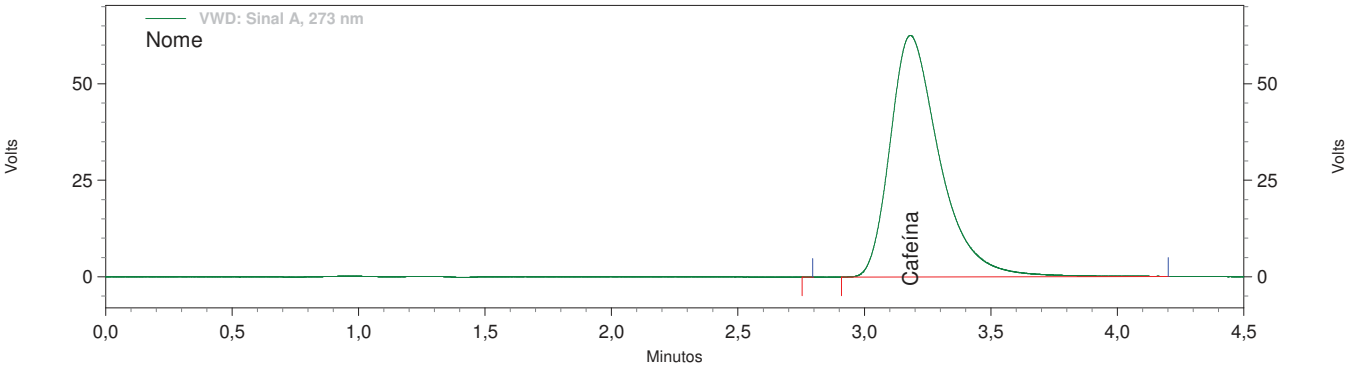


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
2	Cafeína	3,182	14274214	**0,000**

Totais			14274214	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 14:59:54 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:07:06 (GMT -03:00)

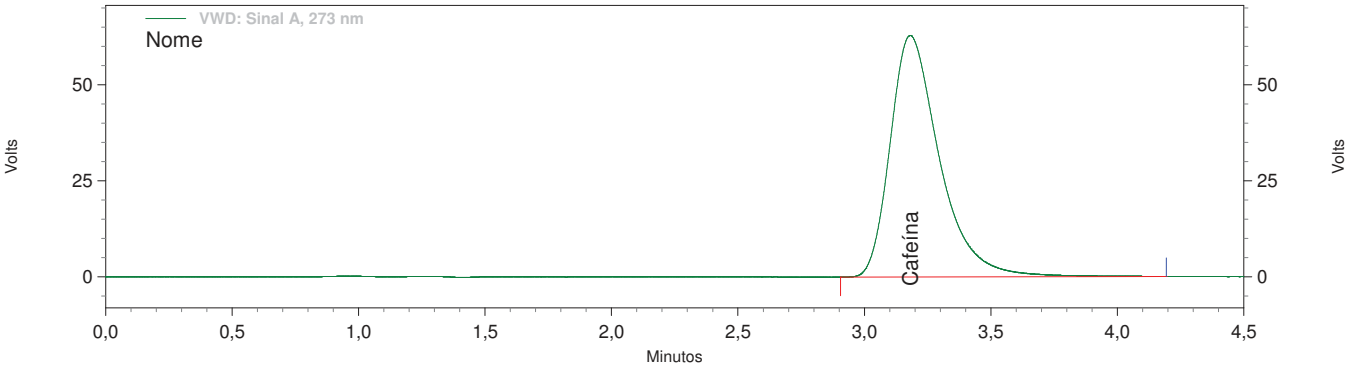


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,181	14285967	**0,000**

Totais			14285967	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:05:24 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:10:37 (GMT -03:00)

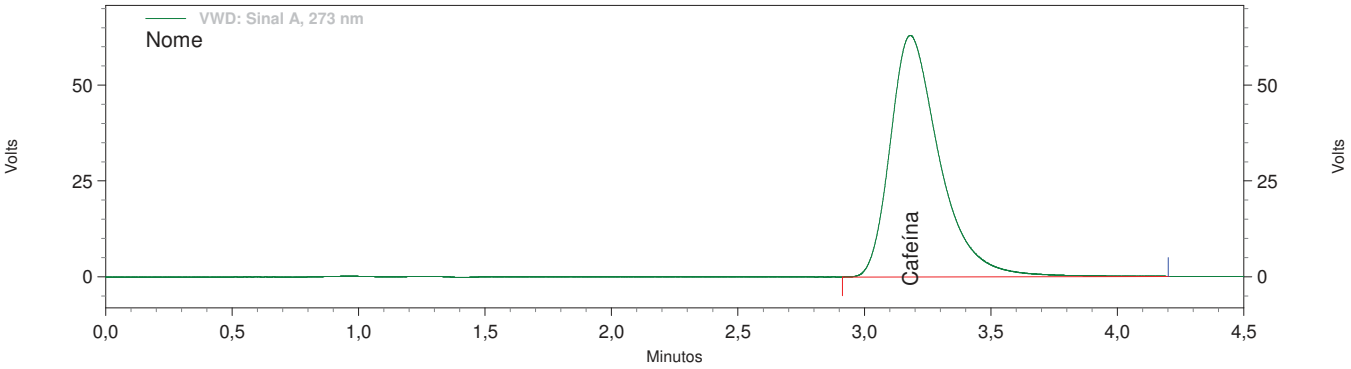


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,181	14287732	**0,000**

Totais			14287732	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 002.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:10:51 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:23:09 (GMT -03:00)

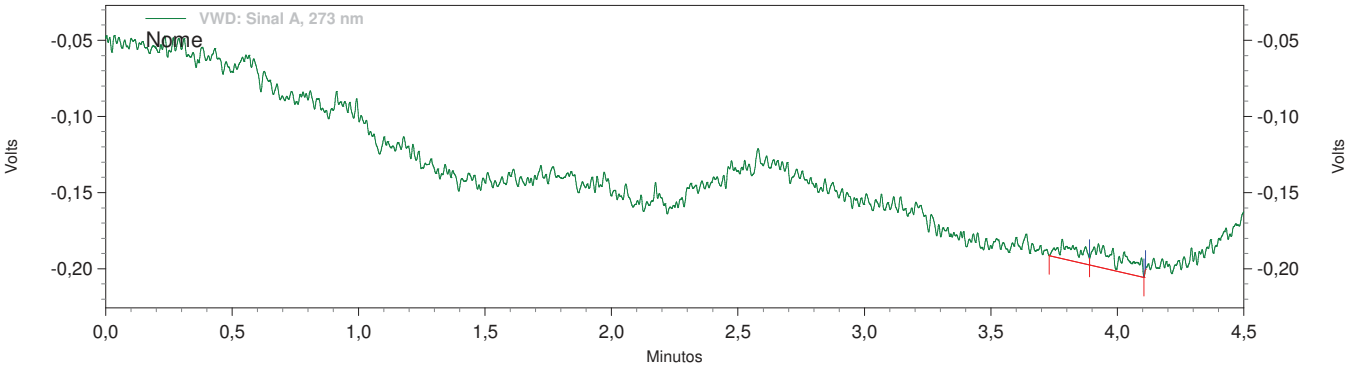


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 004.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:16:19 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:23:41 (GMT -03:00)

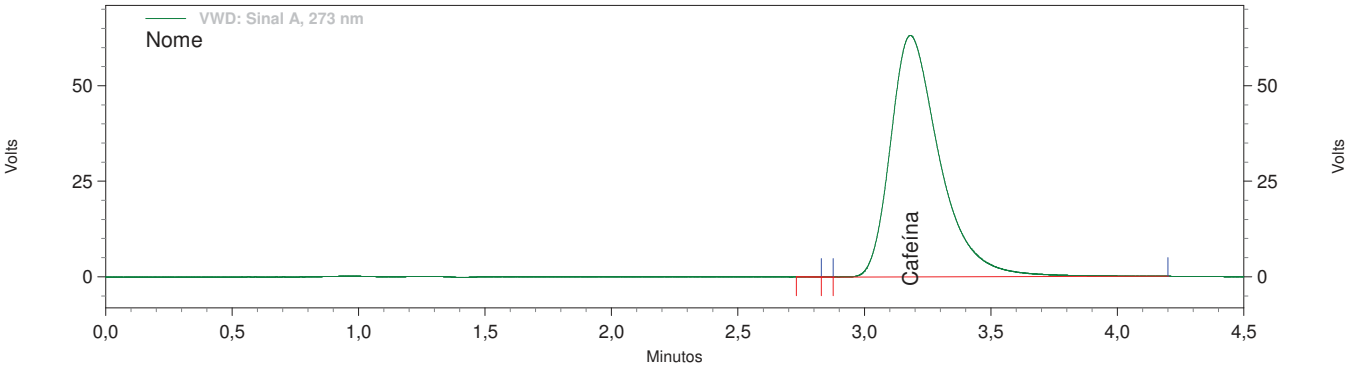


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
3	Cafeína	3,182	14283970	**0,000**
Totais			14283970	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 005.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:21:48 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:26:47 (GMT -03:00)

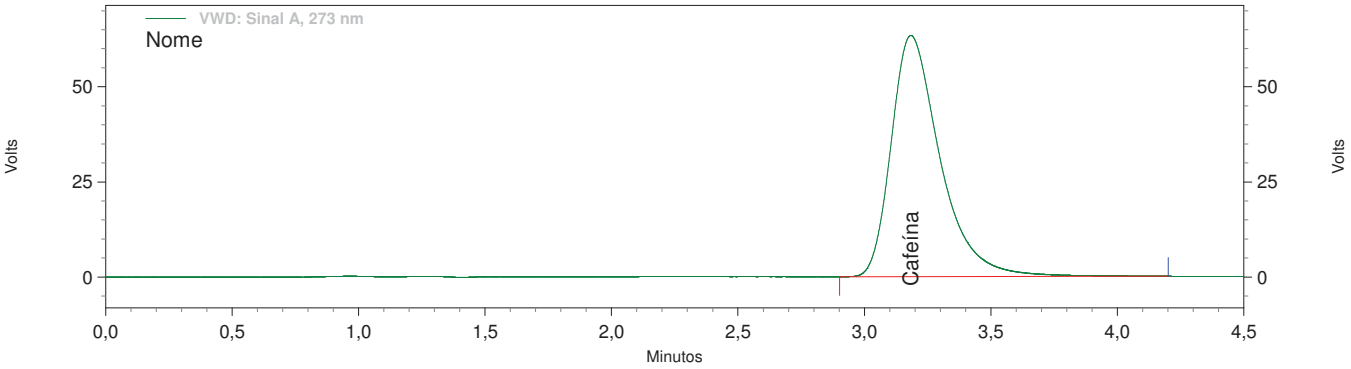


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,183	14291046	**0,000**

Totais			14291046	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\PCIN 006.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:27:14 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:31:53 (GMT -03:00)

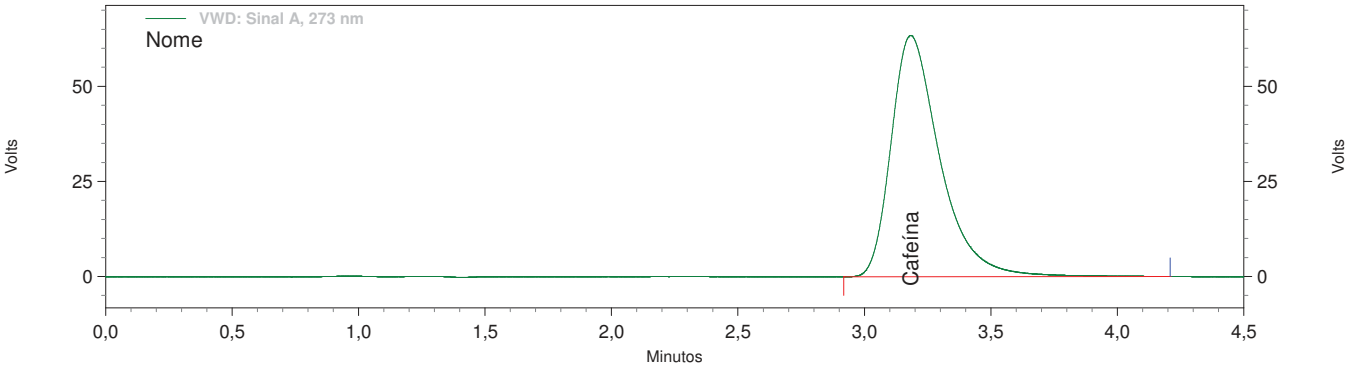


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,183	14297072	**0,000**

Totais			14297072	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\PCIN 001.rslt\Branco PCIN 003.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 15:32:44 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 15:42:36 (GMT -03:00)

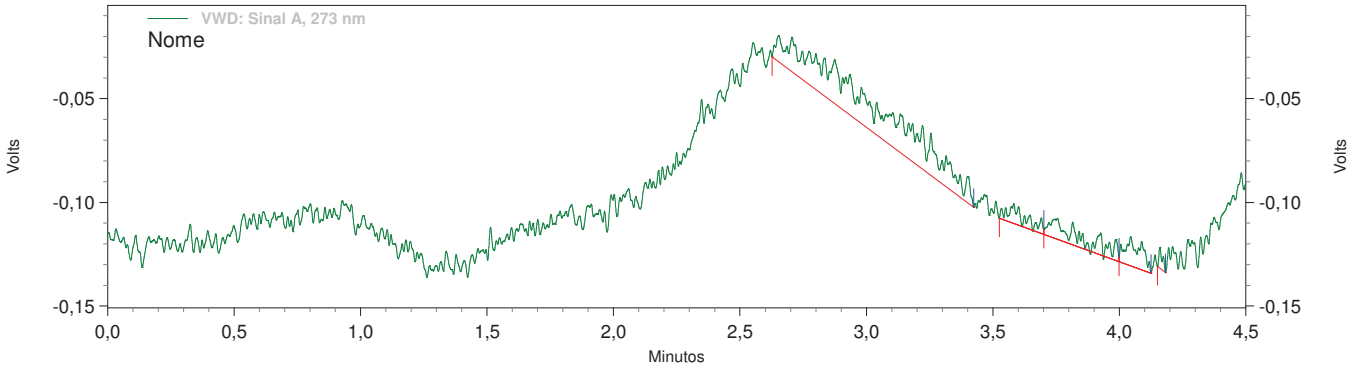


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LDUV 002.rslt\LDUV 001.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:11:32 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:17:05 (GMT -03:00)

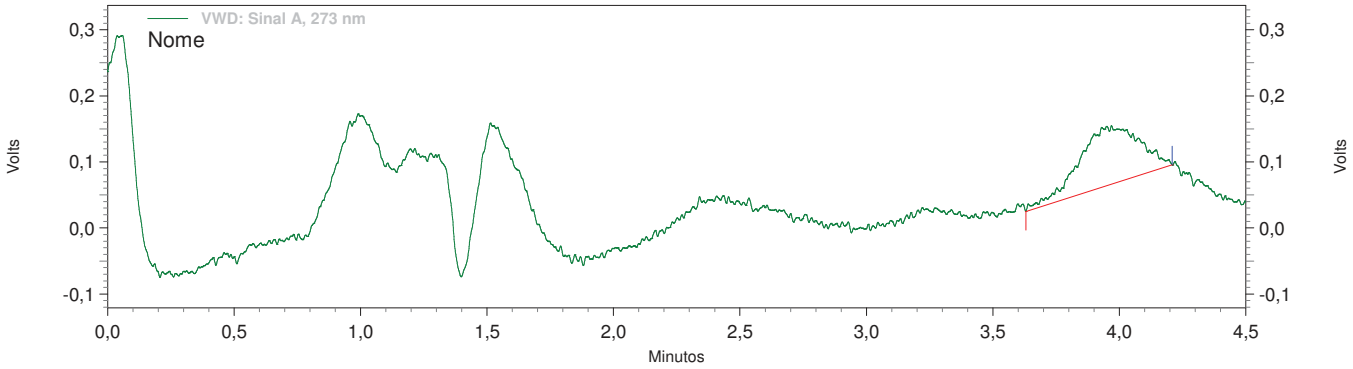


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LDUV 002.rslt\LDUV 002.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:16:58 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:21:45 (GMT -03:00)

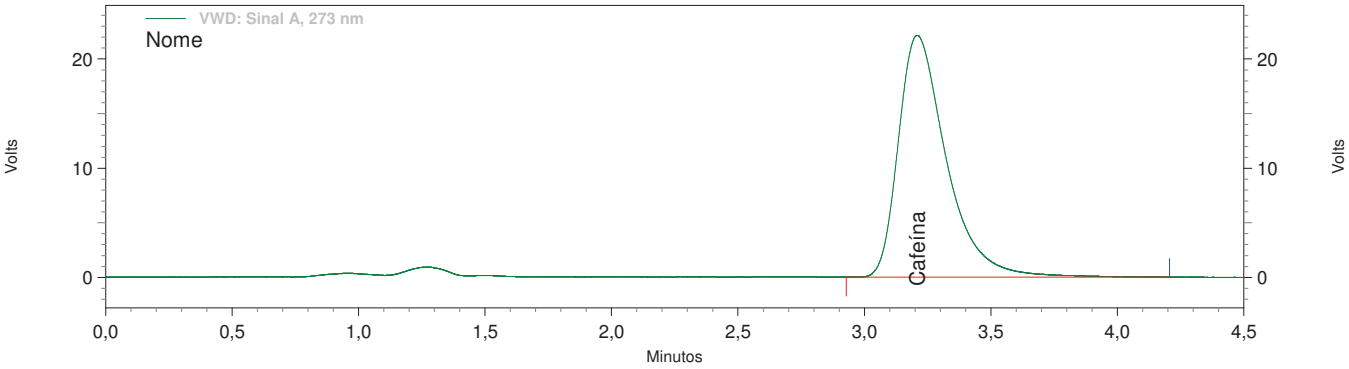


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,208	4903171	**0,000**
Totais			4903171	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LDUV 002.rslt\LDUV 003.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:22:27 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:27:19 (GMT -03:00)

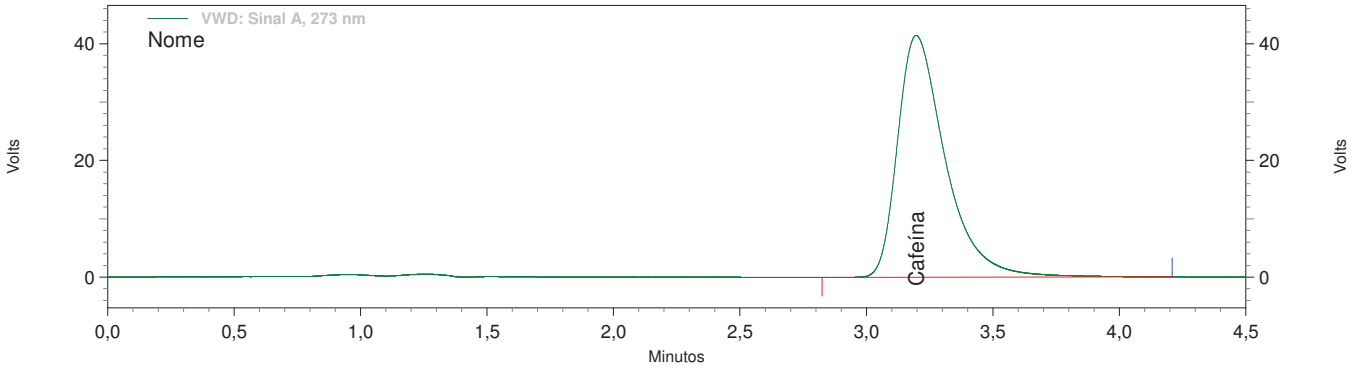


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,197	9120999	**0,000**
Totais			9120999	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LDUV 002.rslt\LDUV 004.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:27:56 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:32:58 (GMT -03:00)

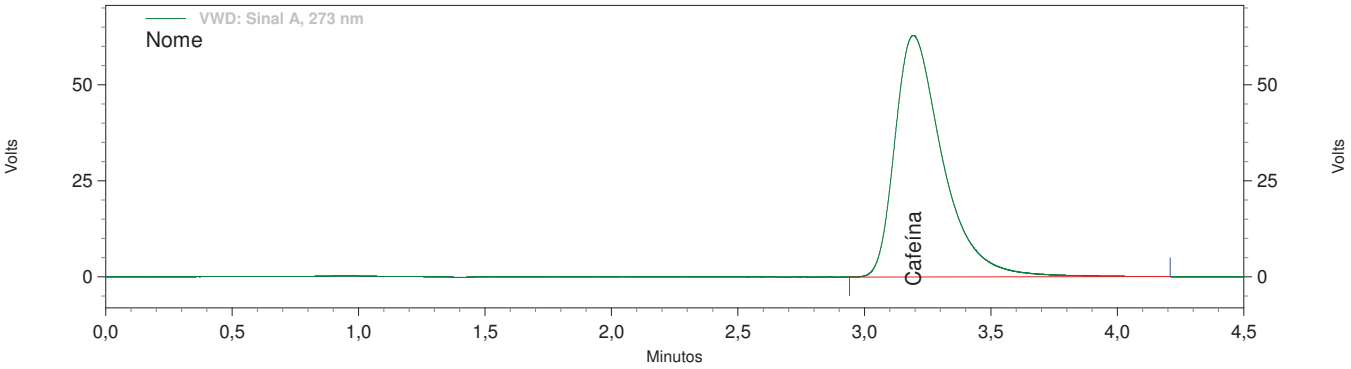


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,193	13825644	**0,000**
Totais			13825644	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LDUV 002.rslt\LDUV 005.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:33:25 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:42:01 (GMT -03:00)

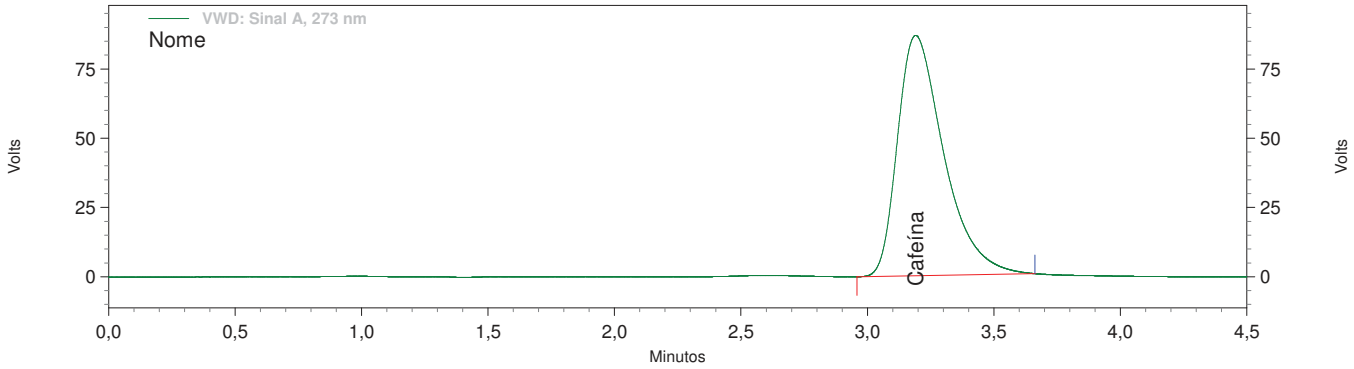


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,191	18501428	**0,000**
Totais			18501428	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LIIN 001.rslt\LIIN 001.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:41:03 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:47:51 (GMT -03:00)

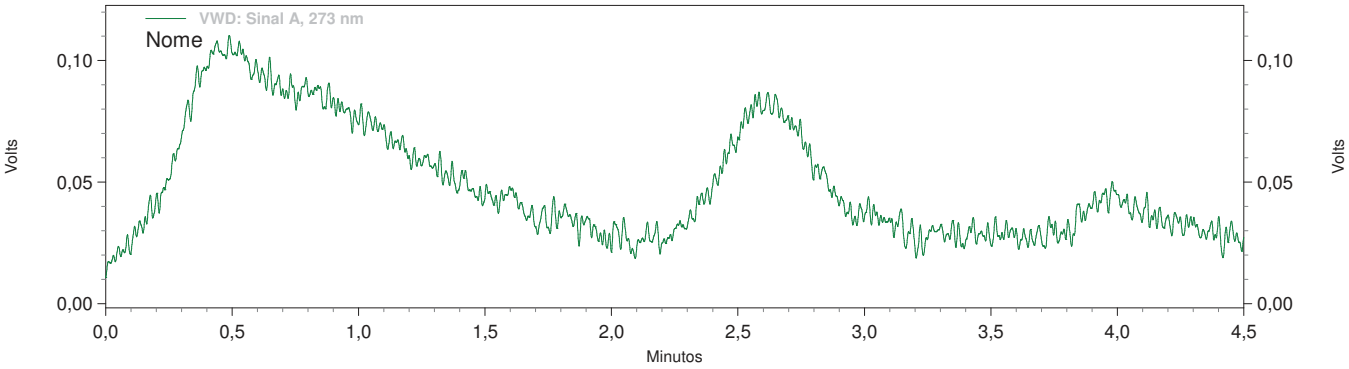


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0,000 BDL**

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LIIN 001.rslt\LIIN 002.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:46:33 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:51:49 (GMT -03:00)

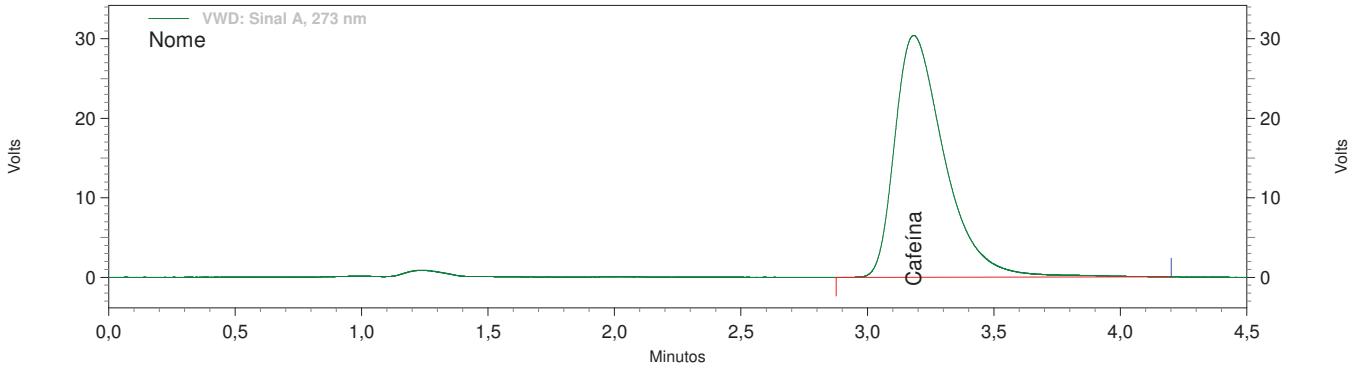


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,183	6979298	**0,000**
Totais			6979298	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LIIN 001.rslt\LIIN 003.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:52:02 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 16:57:25 (GMT -03:00)

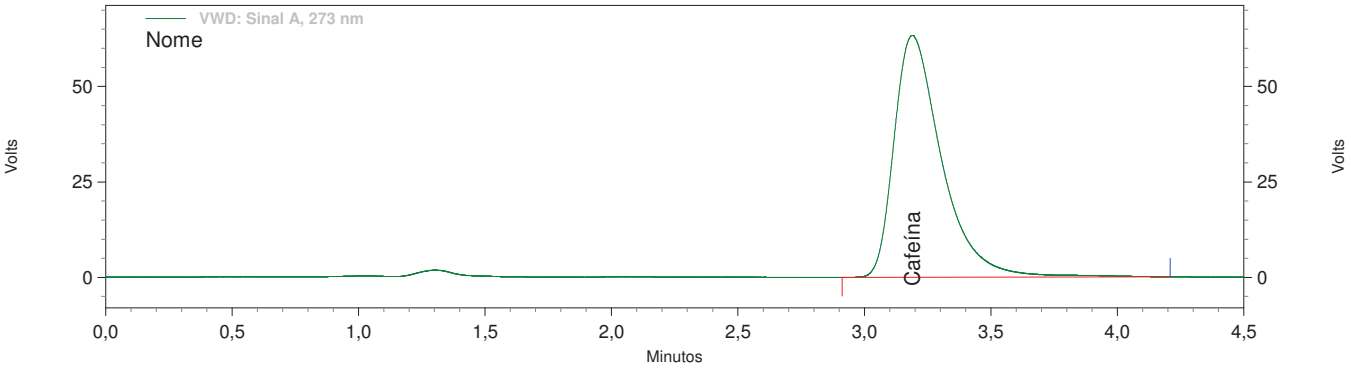


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,189	13914692	**0,000**
Totais			13914692	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LIIN 001.rslt\LIIN 004.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 16:57:32 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 17:02:15 (GMT -03:00)

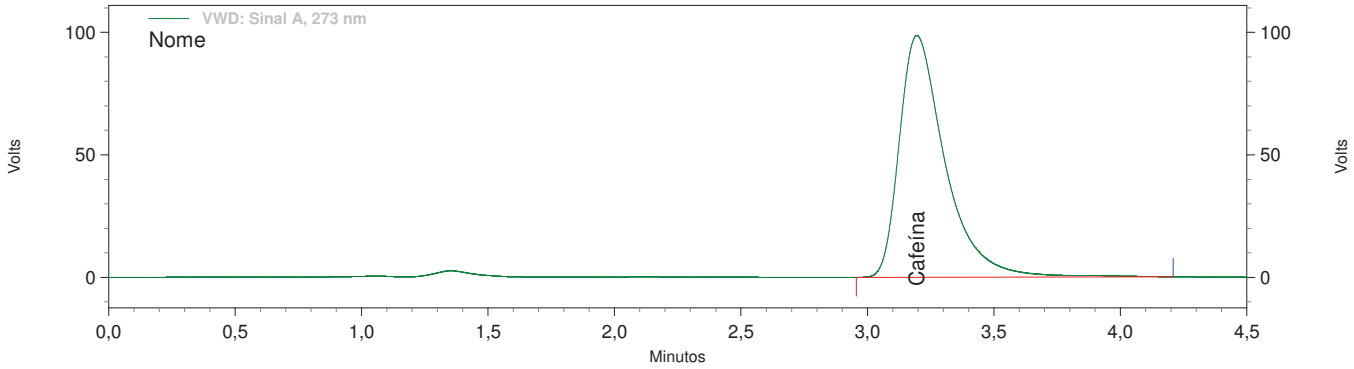


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,195	20821768	**0,000**
Totais			20821768	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\LIIN 001.rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 17:03:08 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 17:08:51 (GMT -03:00)

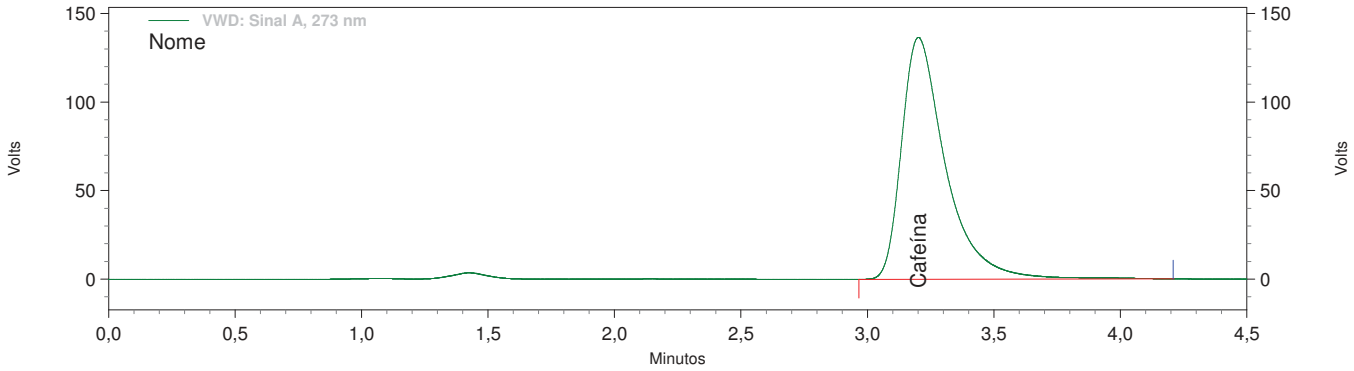


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3,202	27733659	**0,000**
Totais			27733659	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Gradiente AB.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\Gradiente AB 001.rslt\Gradiente AB 001.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 17:21:47 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 17:48:10 (GMT -03:00)

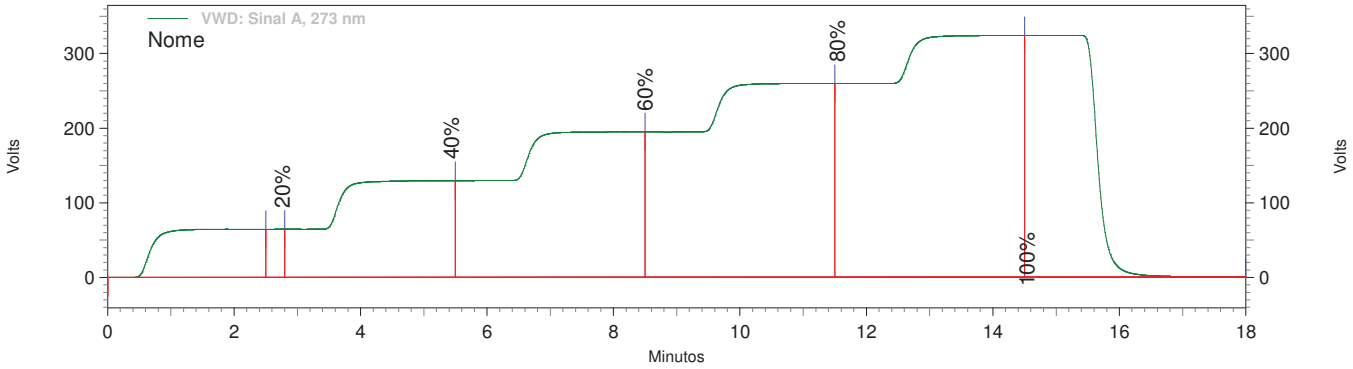


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
2	20%	2,763	1082708
3	40%	5,435	2173840
4	60%	8,499	3268279
6	80%	11,537	4352877
7	100%	14,541	5430400

Totais			16308104

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Gradiente CD.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2021\Gradiente CD 003.rslt\Gradiente CD 003.dat
Usuário: Sistema (Laboratório)
Adquirido: 14/06/2021 18:07:10 (GMT -03:00)
Impresso: 14/06/2021 18:31:02 (GMT -03:00)

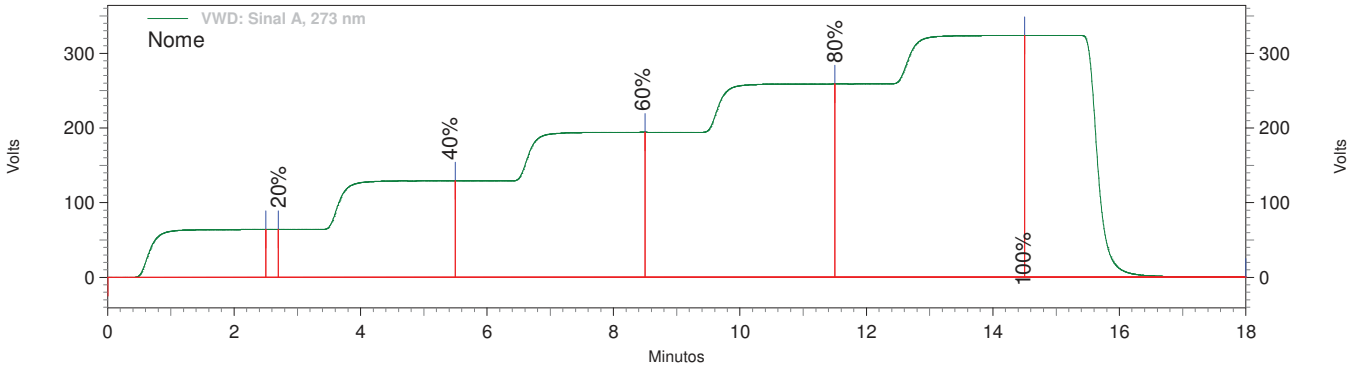

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
2	20%	2,699	1075109
3	40%	5,408	2166730
4	60%	8,457	3257702
5	80%	11,499	4341638
6	100%	14,473	5427821

Totais			16269000