Agilent Lab Advisor — Service & Diagnostics

Tasks

Lab Advisor
- System Overview
- Configuration
- Apps
- Firmware Update
- Logs & Results


0403HP06
- Service & Diagnostics
- Instrument Control
- EMFs
- System Report

Help
- Context Help (F1)
- Help Topics
- What's New?

Spectral Scan — 0403HP06 » 0403HP06 » G1314F:DEABB13551

Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]

UV Lamp On | Blank Scan | Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

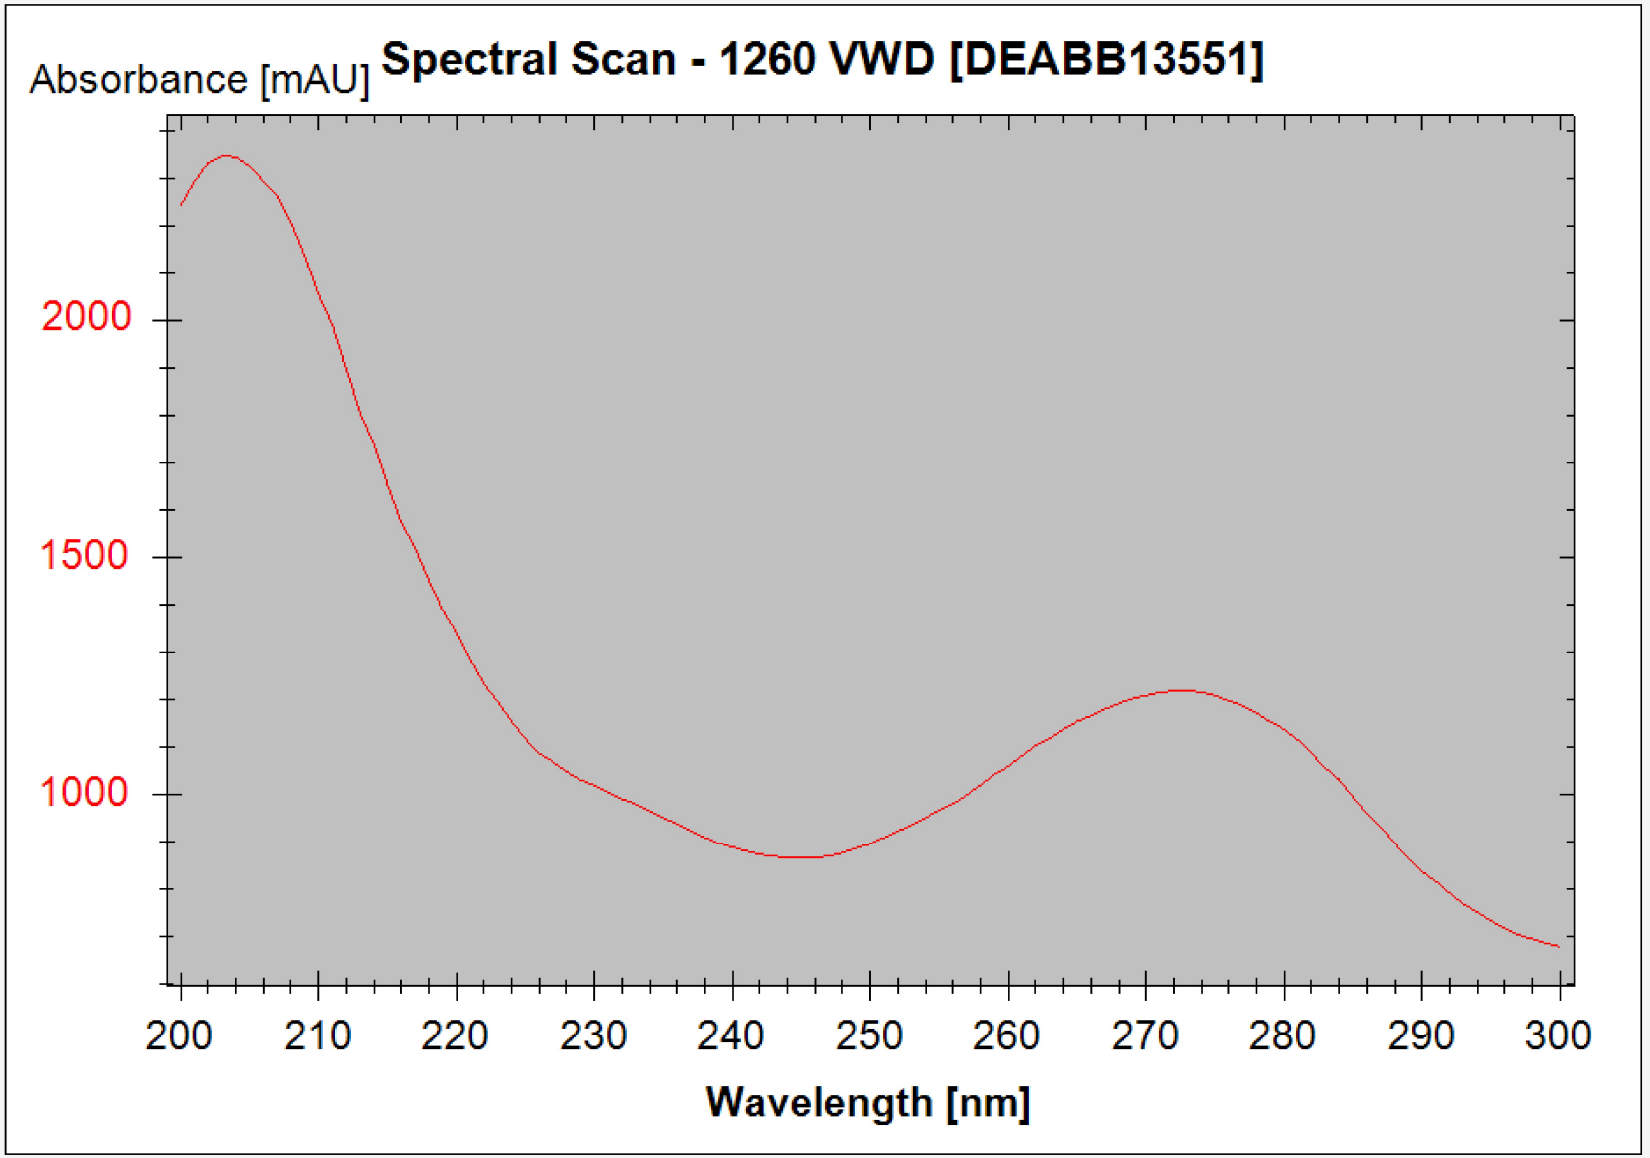

more... | Print Result | Back

Connection Address: 192.168.254.11 — Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10

Agilent Lab Advisor — Service & Diagnostics

Tasks

Lab Advisor
- System Overview
- Configuration
- Apps
- Firmware Update
- Logs & Results


0403HP06
- Service & Diagnostics
- Instrument Control
- EMFs
- System Report

Help
- Context Help (F1)
- Help Topics
- What's New?

Spectral Scan — 0403HP06 » 0403HP06 » G1314F:DEABB13551

Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]

UV Lamp On | Blank Scan | Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

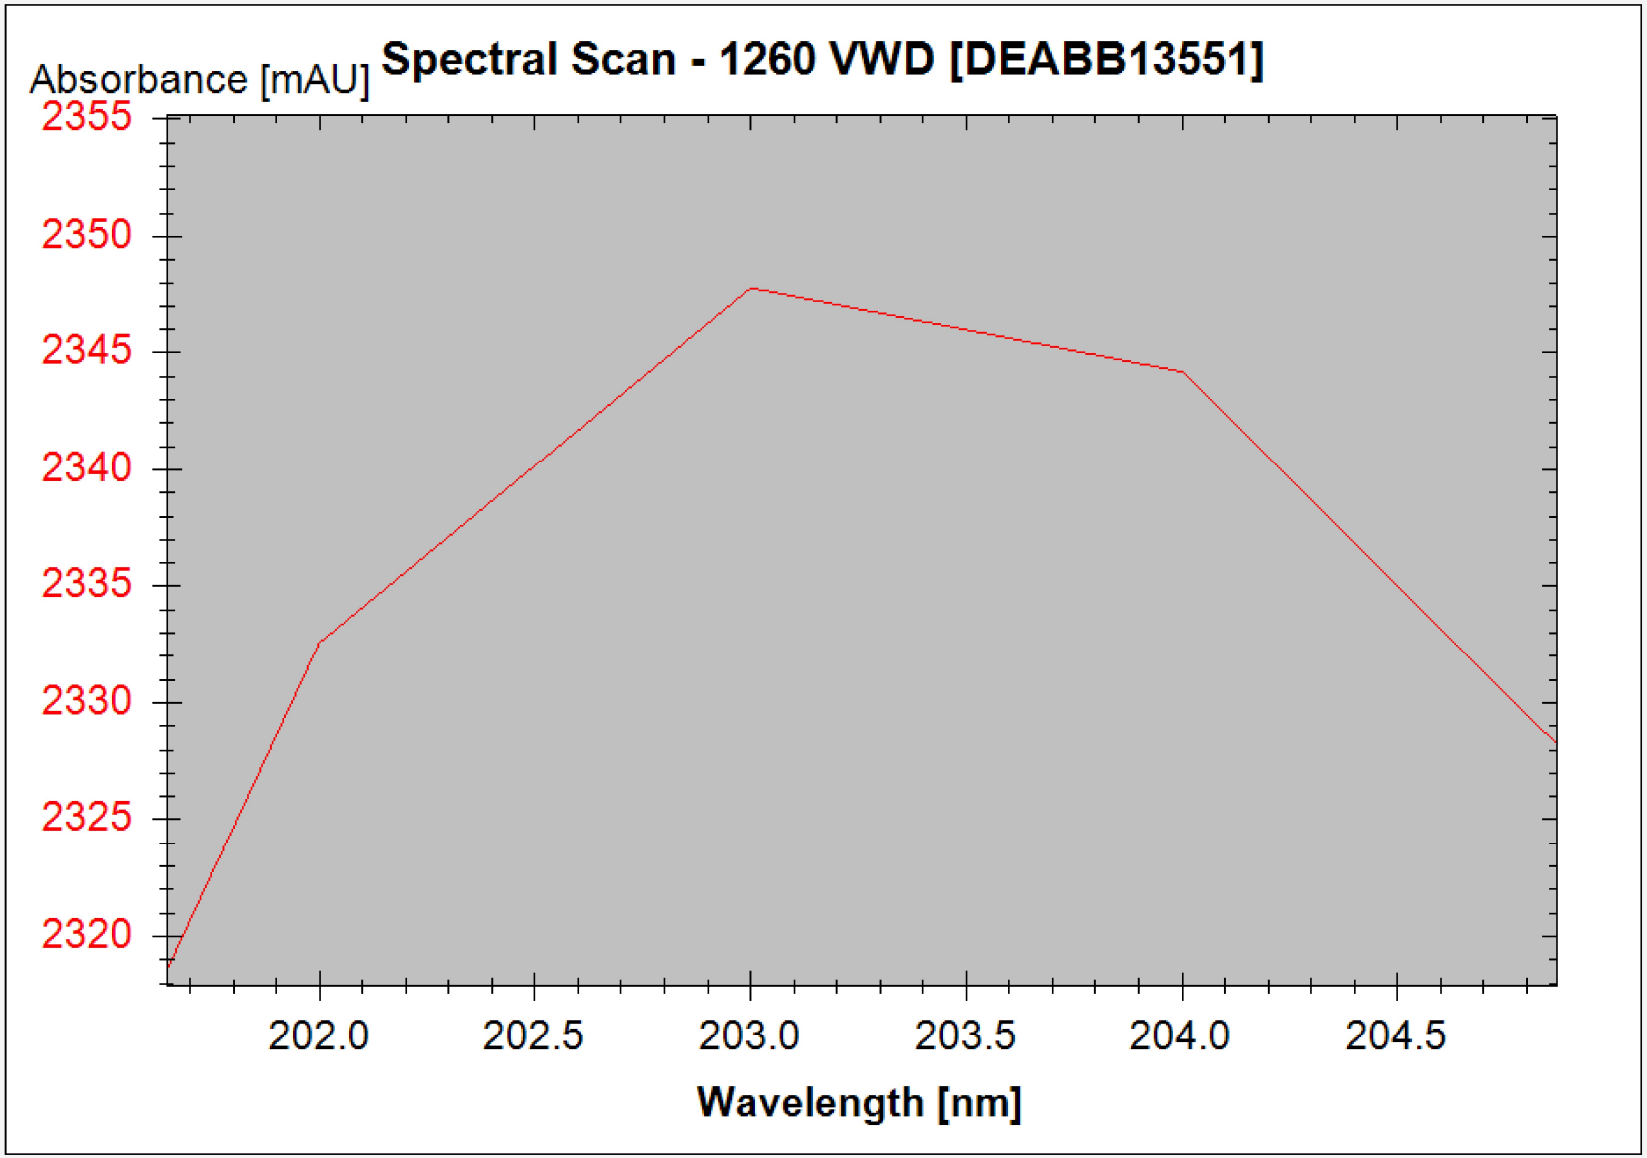


more... | Print Result | Back

Connection Address: 192.168.254.11 — Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10

Tasks
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
0403HP06
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?

Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]

UV Lamp On | Blank Scan | Sample Scan | from 200 | to 300 | step 1 | Export Data

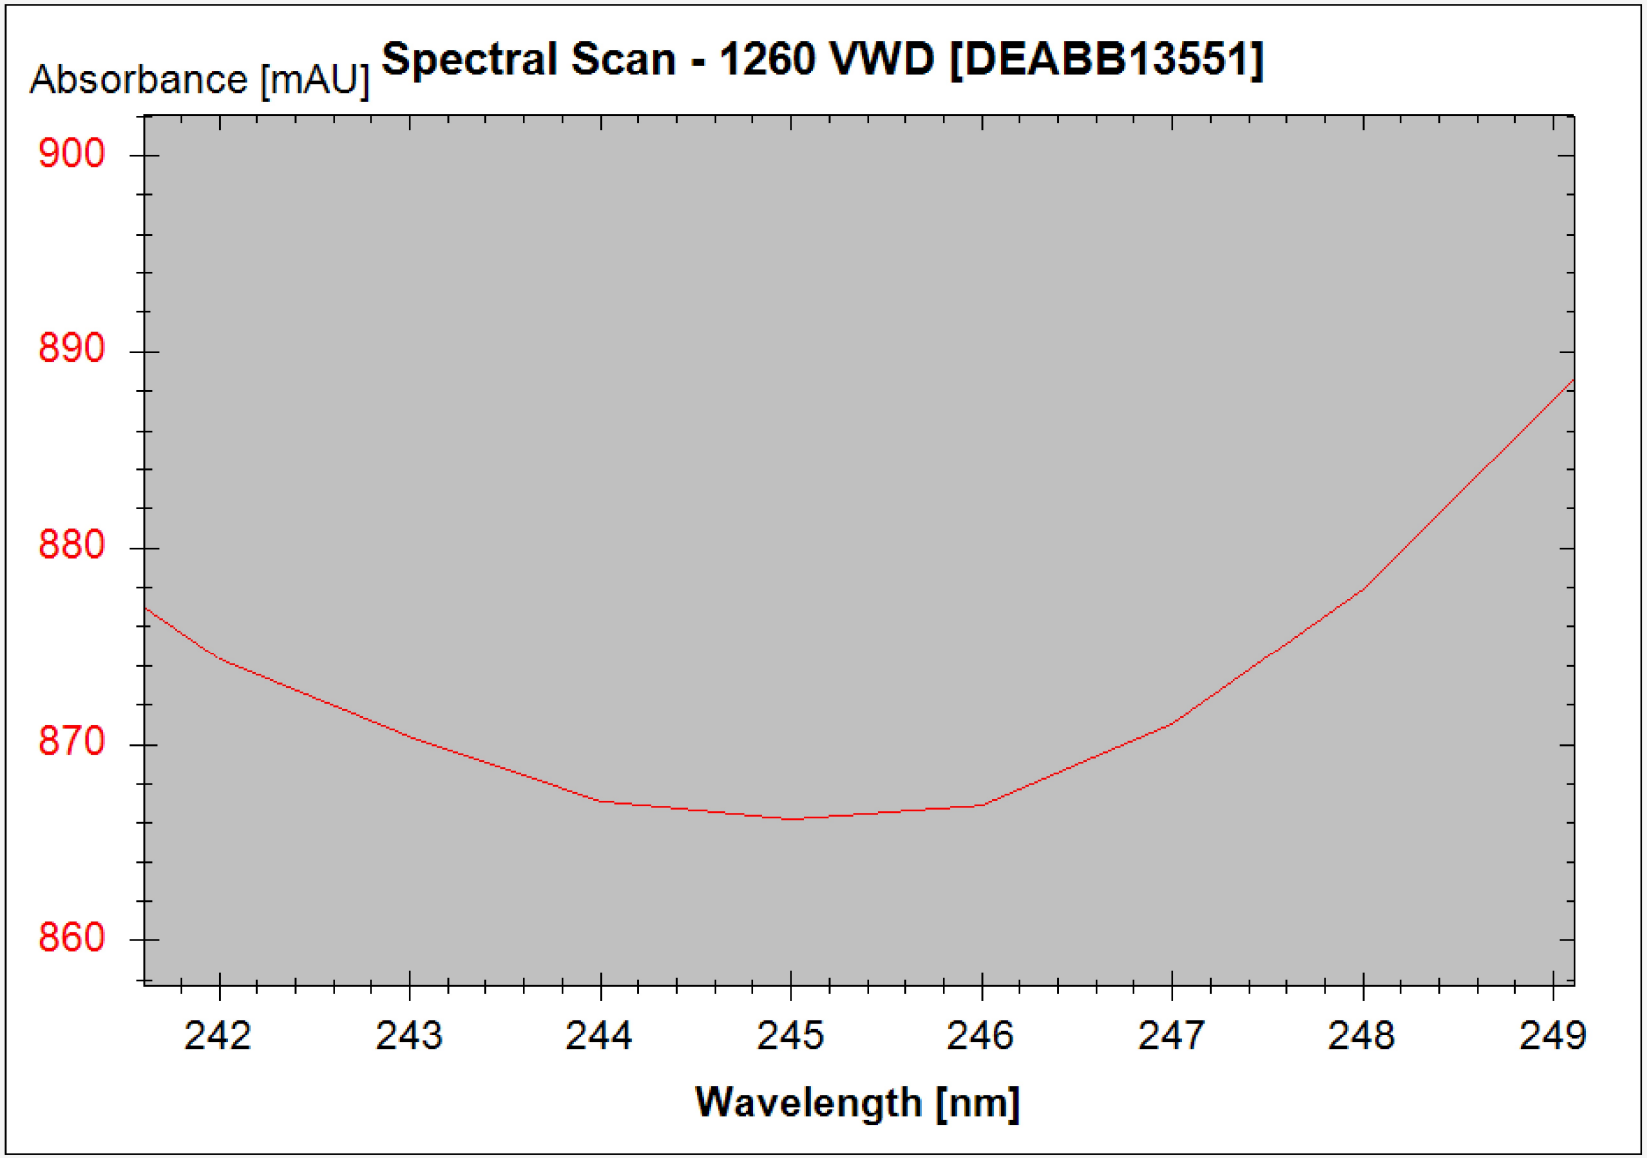

more... | Print Result | Back

Tasks

Lab Advisor
- System Overview
- Configuration
- Apps
- Firmware Update
- Logs & Results

0403HP06
- Service & Diagnostics
- Instrument Control
- EMFs
- System Report


Help
- Context Help (F1)
- Help Topics
- What's New?

Spectral Scan

Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]

UV Lamp On | Blank Scan


Sample Scan from 200 to 300 step 1 | Export Data

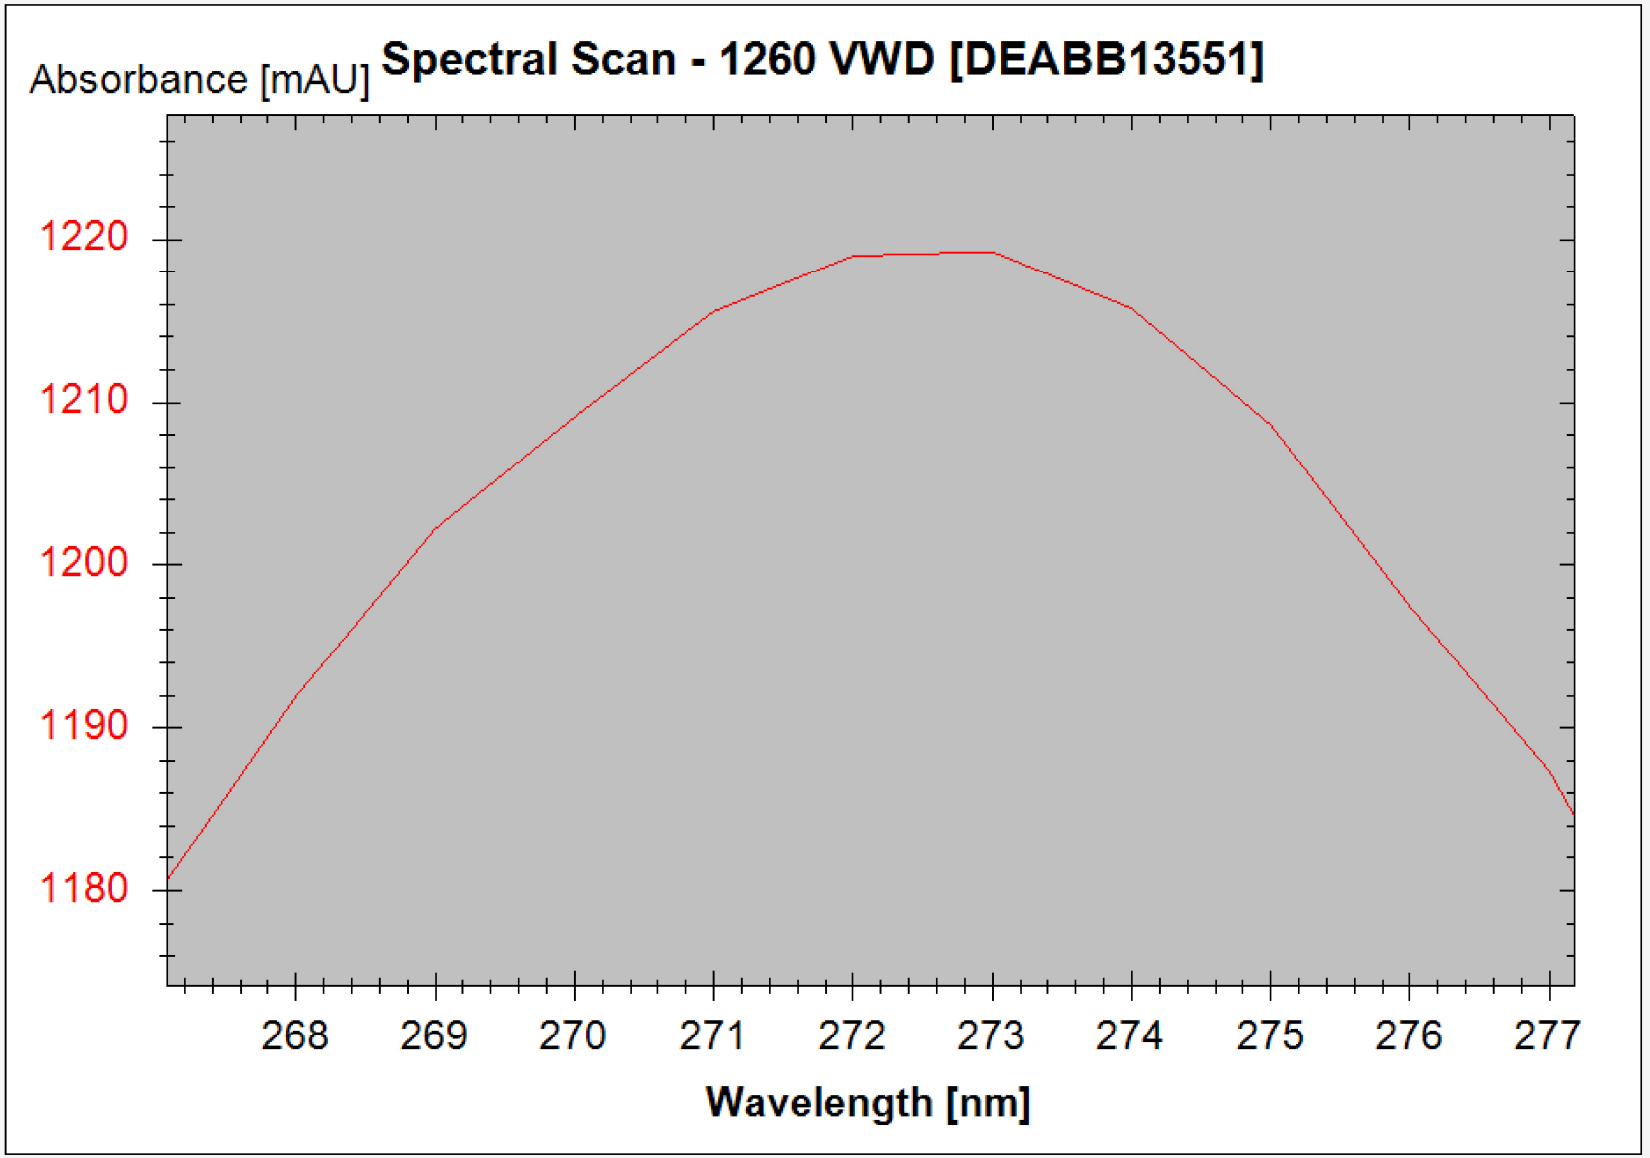

more... | Print Result | Back

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\Branco PCIN 001.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:20:17 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:20 AM (GMT -03:00)

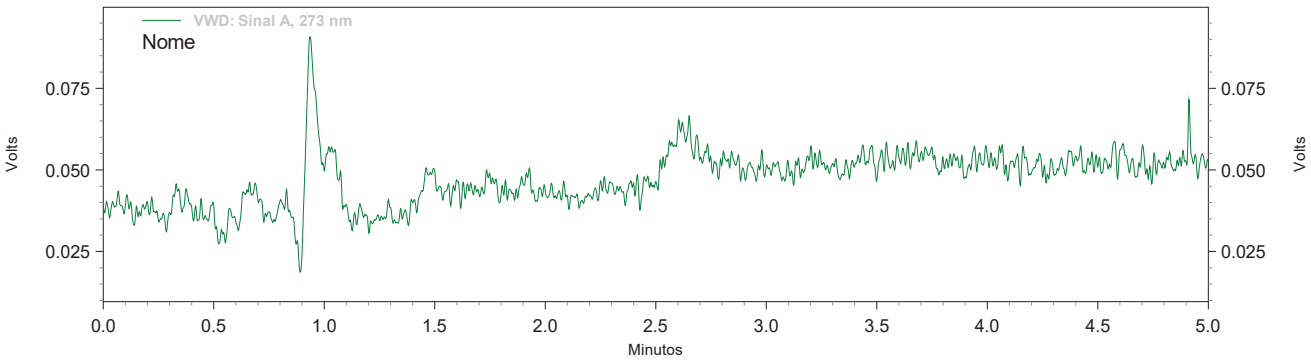


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\PCIN 001.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:26:12 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:21 AM (GMT -03:00)

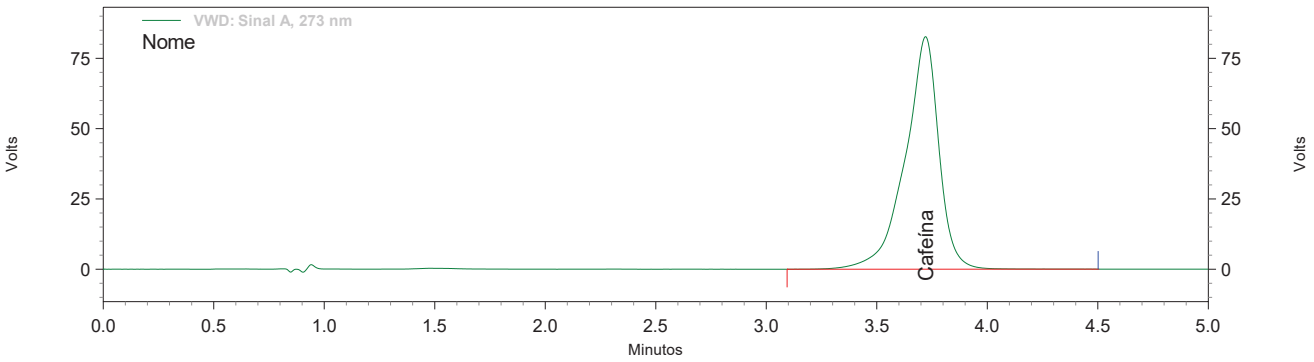


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3.721	14706088	**0.000**
Totais			14706088	**0.000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\PCIN 002.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:32:04 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:23 AM (GMT -03:00)

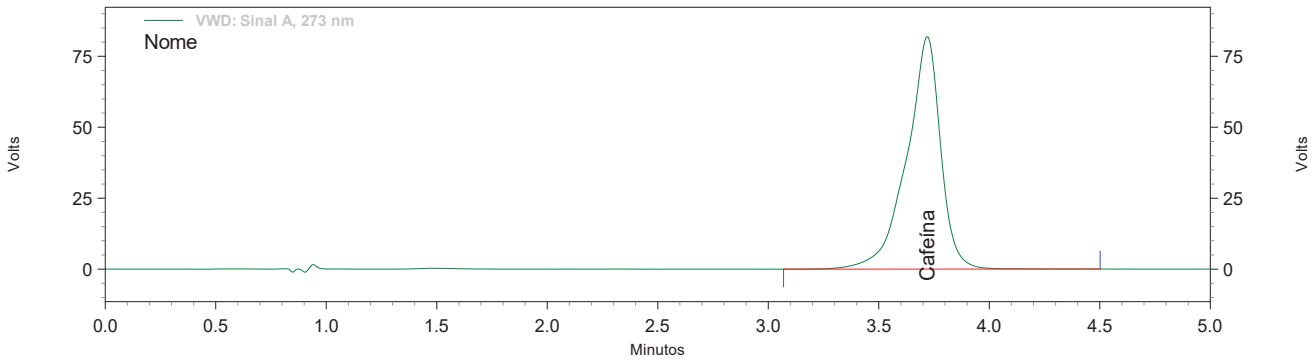


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3.719	14692731	**0.000**
Totais			14692731	**0.000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\Branco PCIN 002.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:43:54 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:26 AM (GMT -03:00)

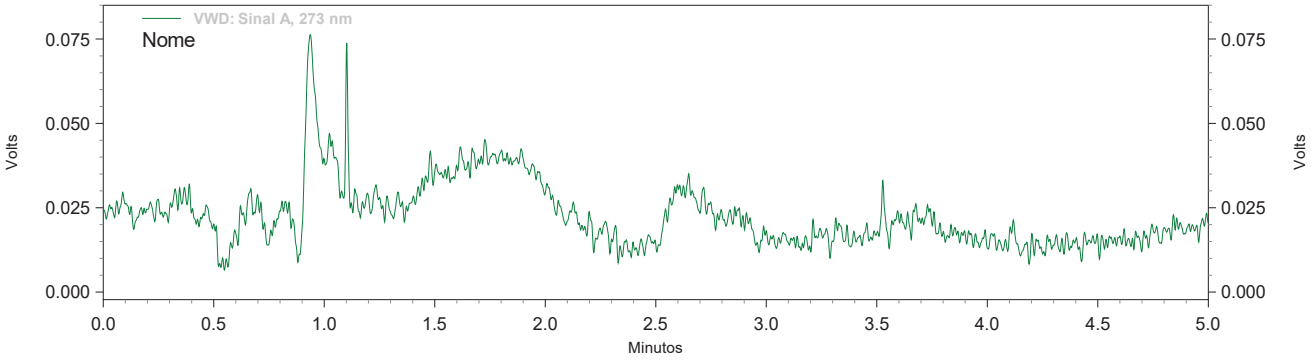


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\PCIN 004.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:49:50 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:27 AM (GMT -03:00)

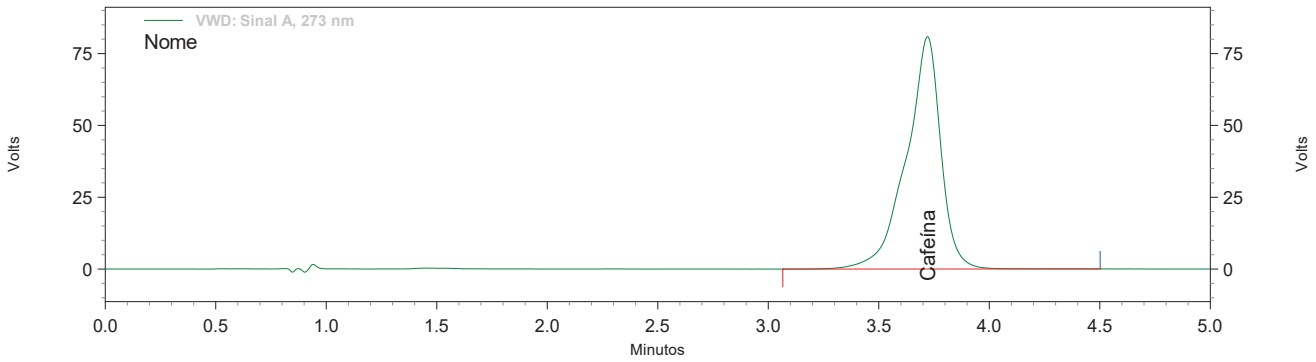


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3.721	14694150	**0.000**
Totais			14694150	**0.000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\PCIN 005.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 3:55:44 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:29 AM (GMT -03:00)

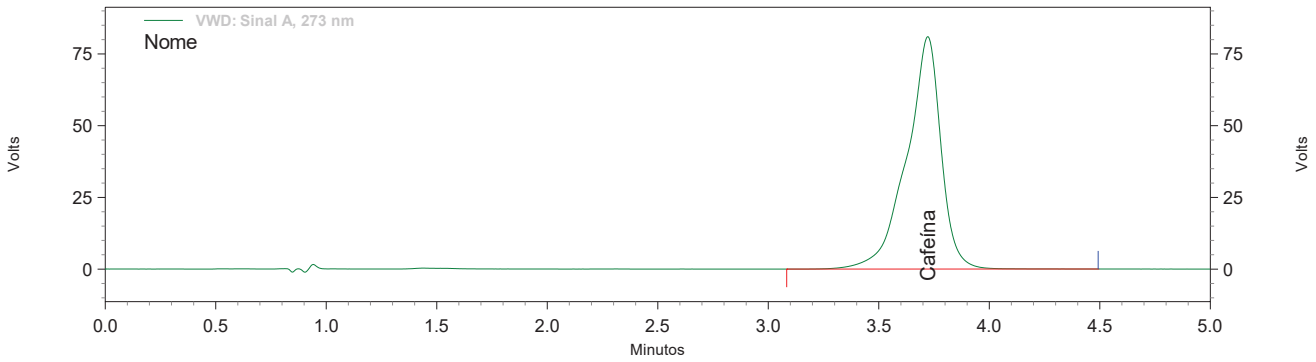


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3.722	14692030	**0.000**
Totais			14692030	**0.000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\PCIN 006.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 4:01:39 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:31 AM (GMT -03:00)

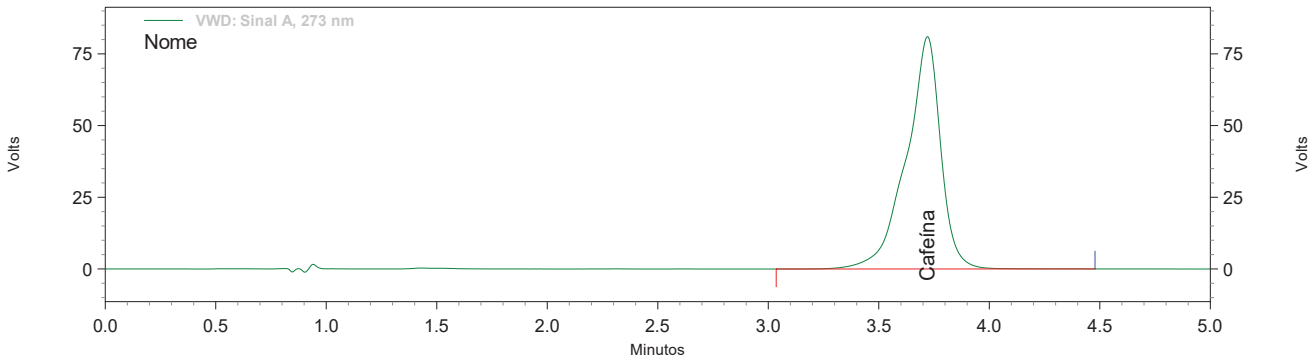


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	3.720	14692188	**0.000**
Totais			14692188	**0.000**

Teste de Precisão e Contaminação Cruzada do Injetor (PCIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\PCIN LDUV LIIN.rslt\Branco PCIN 003.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/16/2022 4:07:35 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 9:21:32 AM (GMT -03:00)

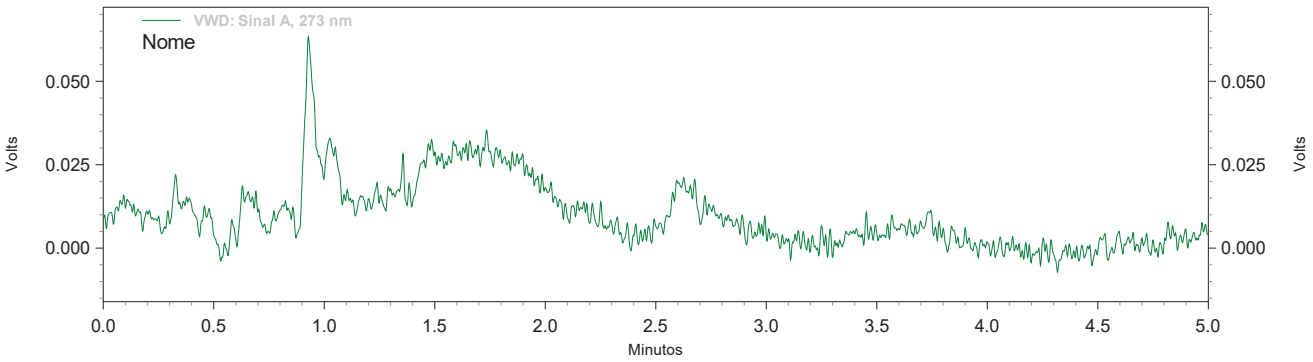


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Teste de Linearidade do Detector UV (LDUV)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LDUV 001.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 10:39:59 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:17:07 AM (GMT -03:00)

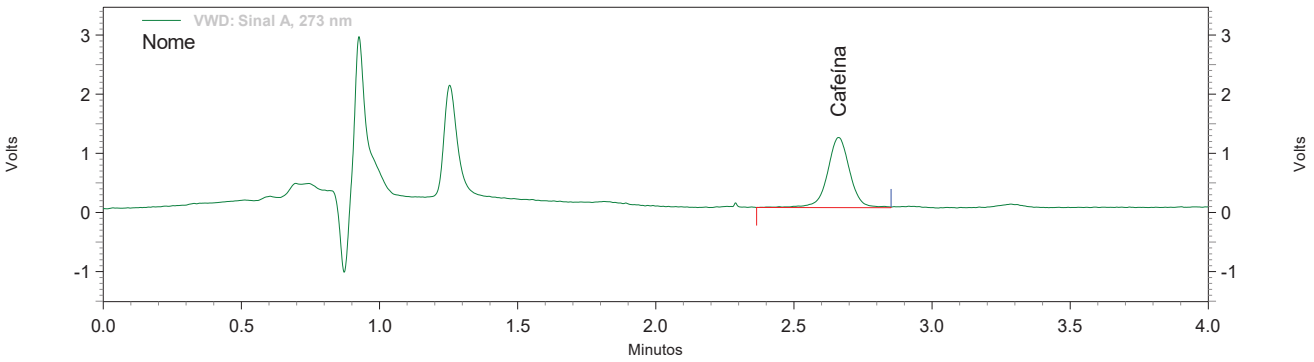


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.662	111444	**0.000 CAL**
Totais			111444	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Detector UV (LDUV)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LDUV 002.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 10:44:59 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:17:09 AM (GMT -03:00)

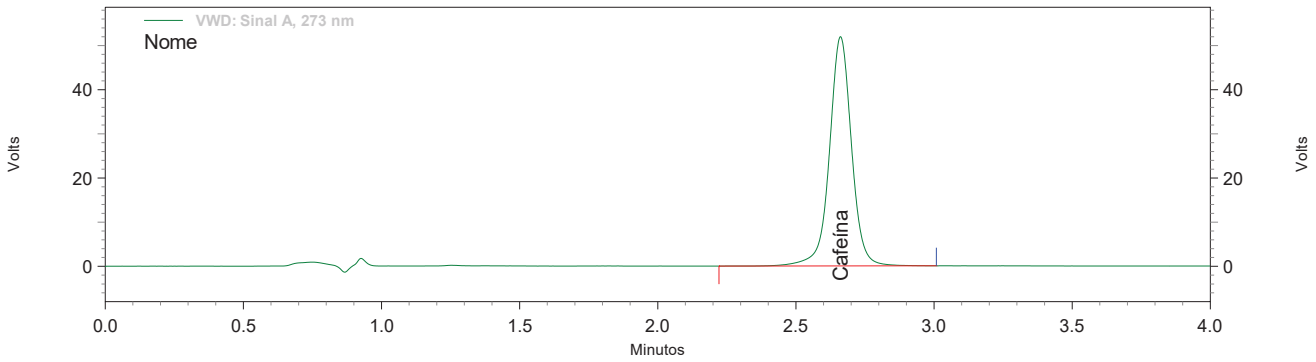


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.662	4847354	**0.000 CAL**
Totais			4847354	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Detector UV (LDUV)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LDUV 003.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 10:49:56 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:17:11 AM (GMT -03:00)

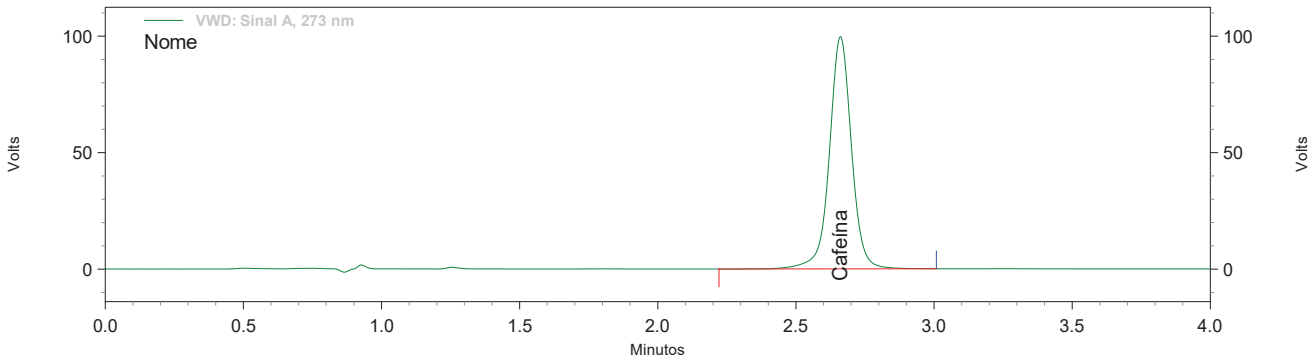


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.661	9315232	**0.000 CAL**
Totais			9315232	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Detector UV (LDUV)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LDUV 004.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 10:54:53 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:17:14 AM (GMT -03:00)

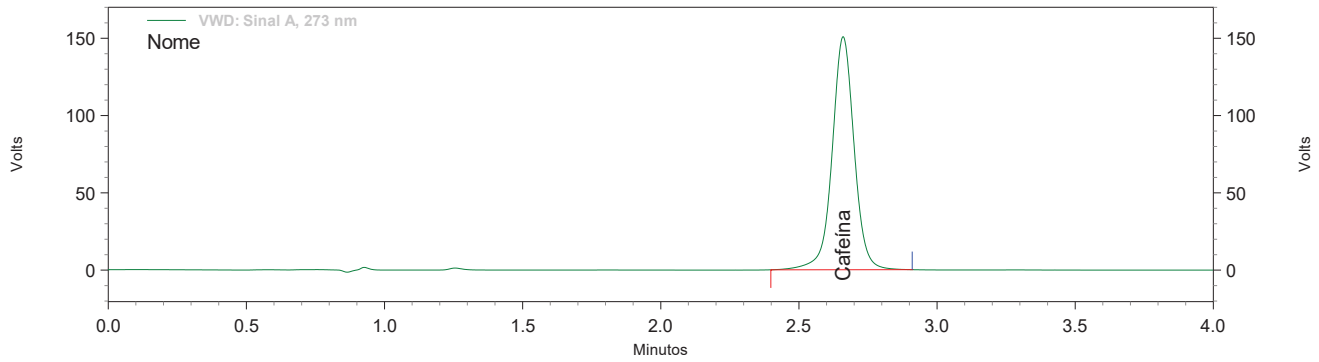


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.660	14036578	**0.000 CAL**
Totais			14036578	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Detector UV (LDUV)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LDUV 005.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 10:59:50 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:17:16 AM (GMT -03:00)

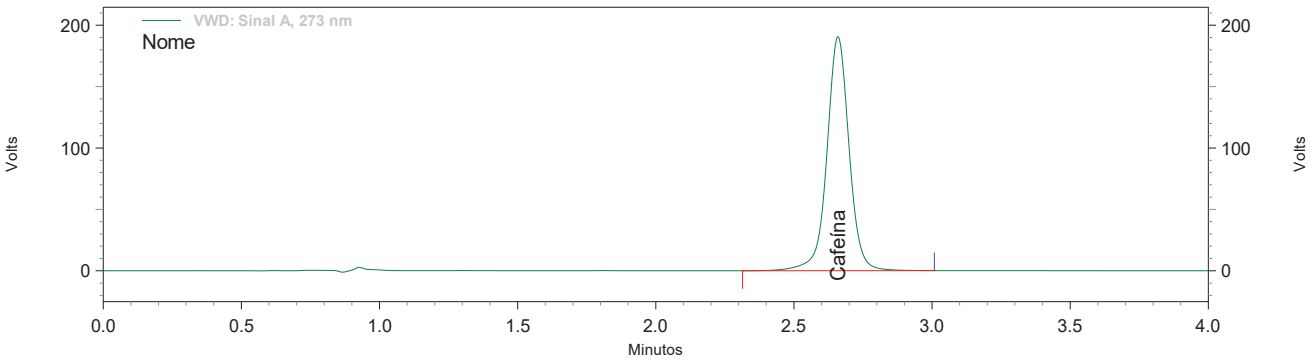


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.659	17883045	**0.000 CAL**
Totais			17883045	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LIIN 001.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:04:07 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:30:22 AM (GMT -03:00)

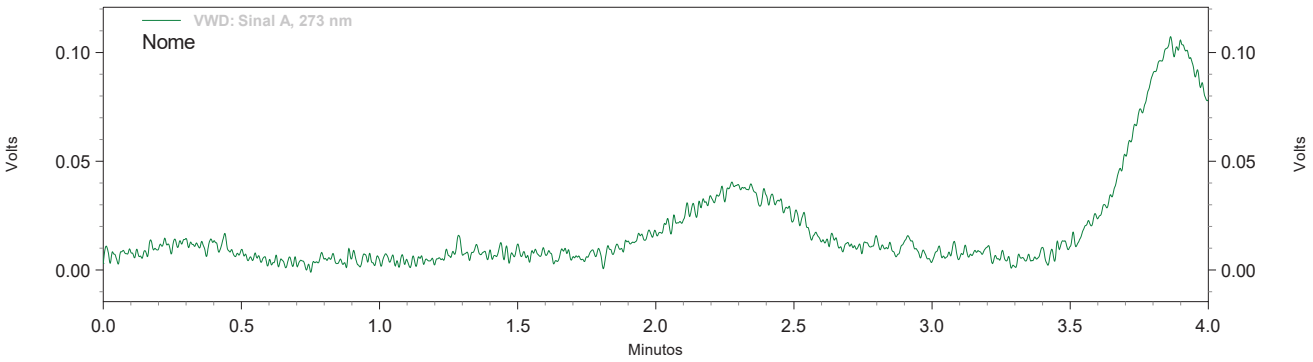


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
	Cafeína			**0.000 BDL**

Totais				

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LIIN 002.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:09:07 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:30:24 AM (GMT -03:00)

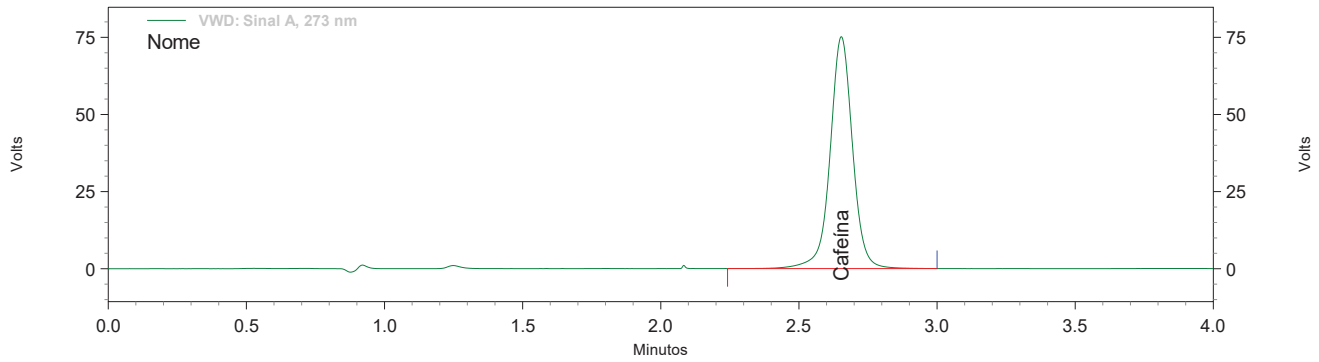


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.653	7136771	**0.000 CAL**
Totais			7136771	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LIIN 003.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:14:02 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:30:27 AM (GMT -03:00)

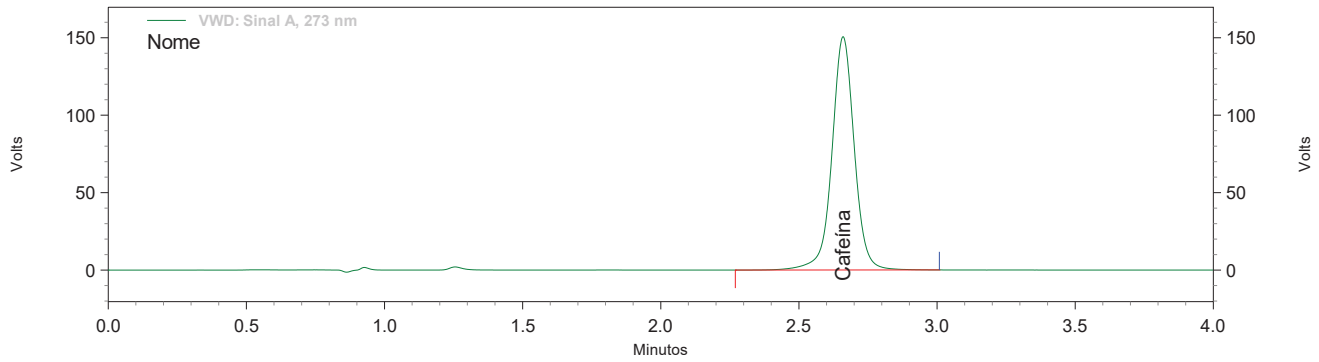


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.660	14237855	**0.000 CAL**
Totais			14237855	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LIIN 004.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:19:05 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:30:29 AM (GMT -03:00)

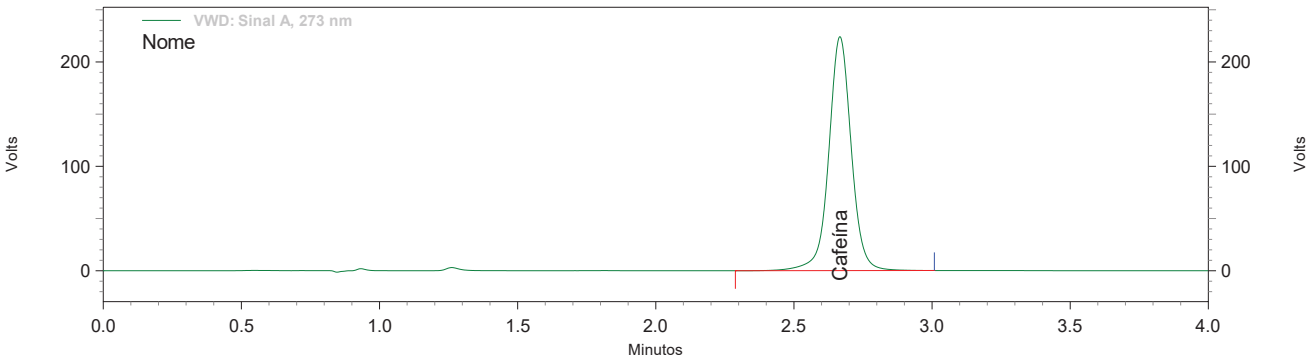


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.667	21331429	**0.000 CAL**
Totais			21331429	**0.000 CAL**

Teste de Linearidade do Injetor (LIIN)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Qualificação.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\LDUV LIIN 002.rslt\LIIN 005.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:24:11 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 11:30:31 AM (GMT -03:00)

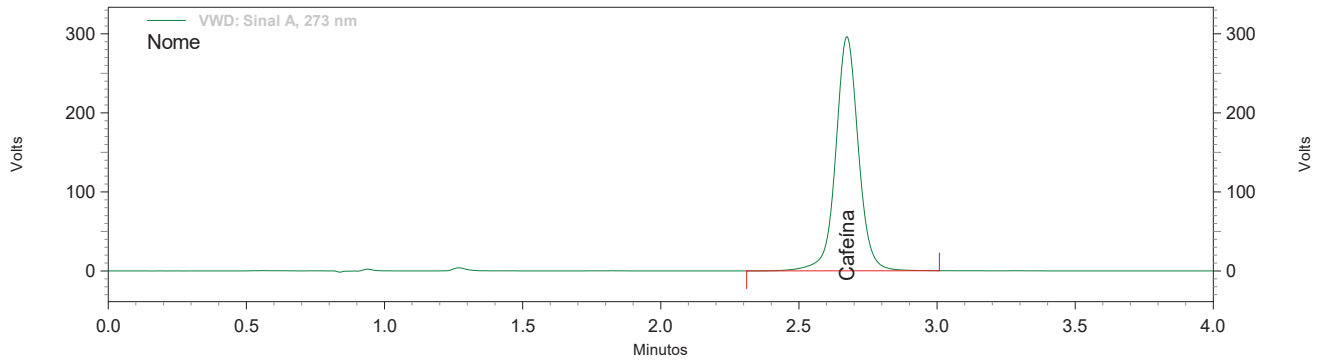


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	2.673	28419744	**0.000 CAL**
Totais			28419744	**0.000 CAL**

Teste de Gradiete da Bomba - Canais A e B (GRAD AB)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Gradiente AB.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\Gradiente 001.rslt\GRAD AB 001.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 11:55:58 AM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 1:44:30 PM (GMT -03:00)

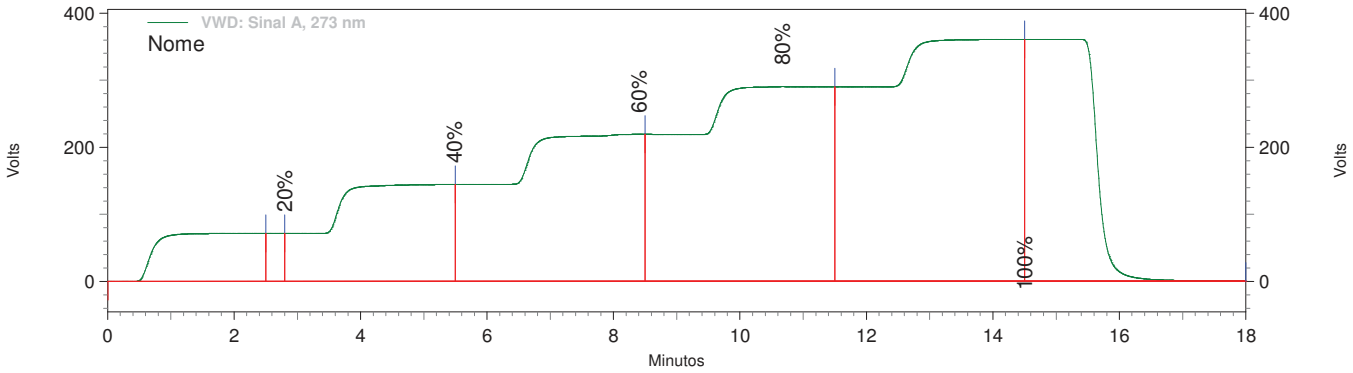


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*	*Concentração ESTD*
2	20%	2.799	1198700	**0.000**
3	40%	5.478	2423559	**0.000**
4	60%	8.400	3676802	**0.000**
5	80%	10.669	4865339	**0.000**
6	100%	14.499	6043229	**0.000**

Totais			18207629	**0.000**

Teste de Gradiente da Bomba - Canais C e D (GRAD CD)

Nome do Método: C:\HP06\Métodos\Qualificação\Gradiente CD.met
Data: C:\HP06\Data\Qualificação 2022\GRAD CD 002.rslt\GRAD CD 002.dat
Usuário: Qpack (QPack)
Adquirido: 5/17/2022 1:11:11 PM (GMT -03:00)
Impresso: 5/17/2022 1:32:56 PM (GMT -03:00)

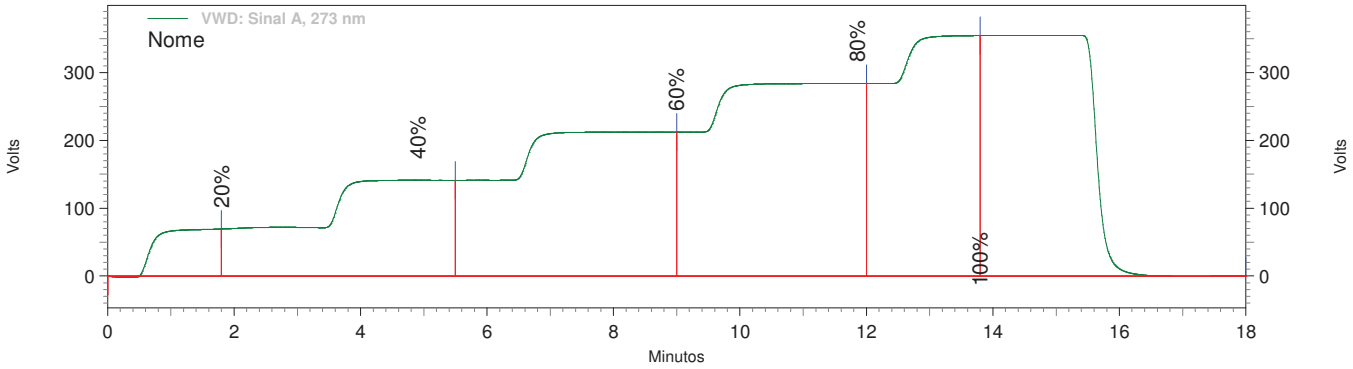

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Altura*
1	20%	1.799	1164631
2	40%	4.910	2371852
3	60%	8.995	3563883
4	80%	11.859	4762361
5	100%	13.795	5947965

Totais			17810692