



Spectral Scan - 1260 MWD VL [DEAAZ00920]
Absorbance [mAU]
600
500
400
300
200
100
0
(204, 616.029249)
(273, 234.430436)
(245, 51.808209)
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
Wavelength [nm]


Relatório SRELB

Detector VWD – G1365D – N/S DEAAZ00920	Data: 24/05/2023
Ruído:	
Valor máximo: 0.0238419 mAU	**Diferença: 0.0133515 mAU**
Valor mínimo: 0.0104904 mAU	

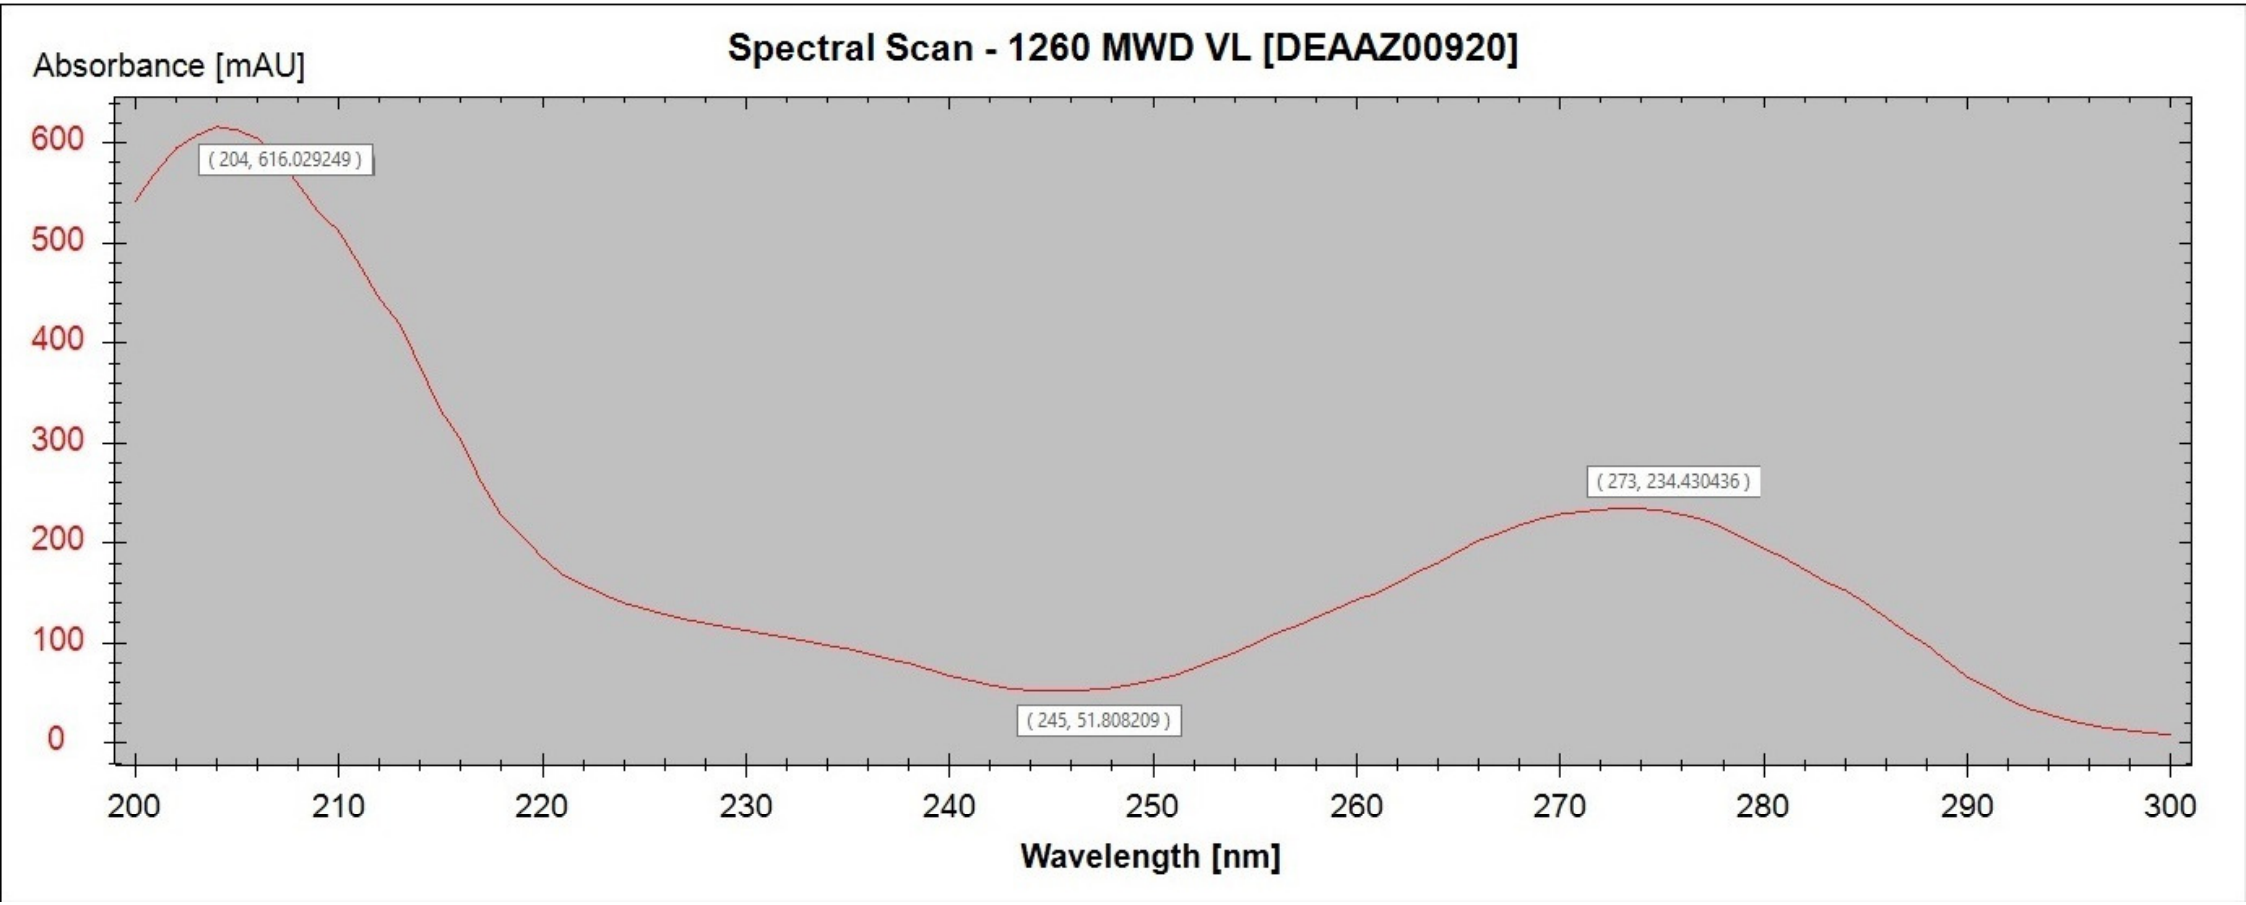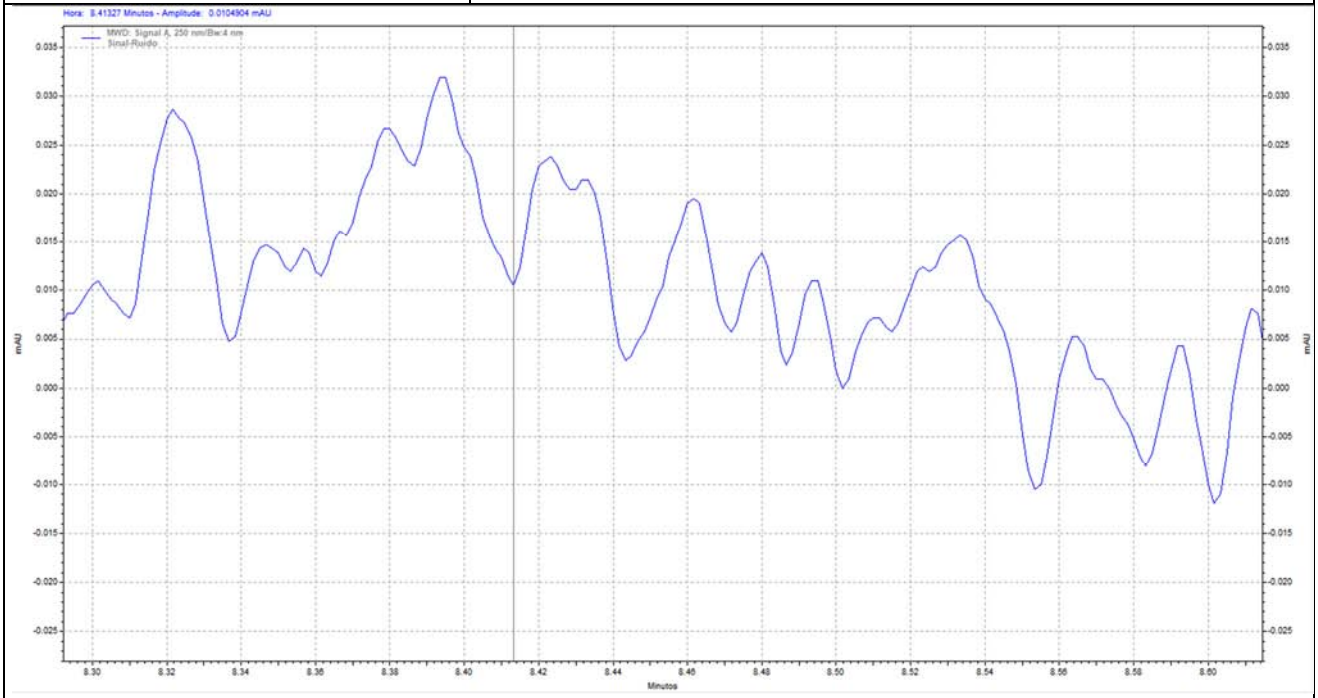

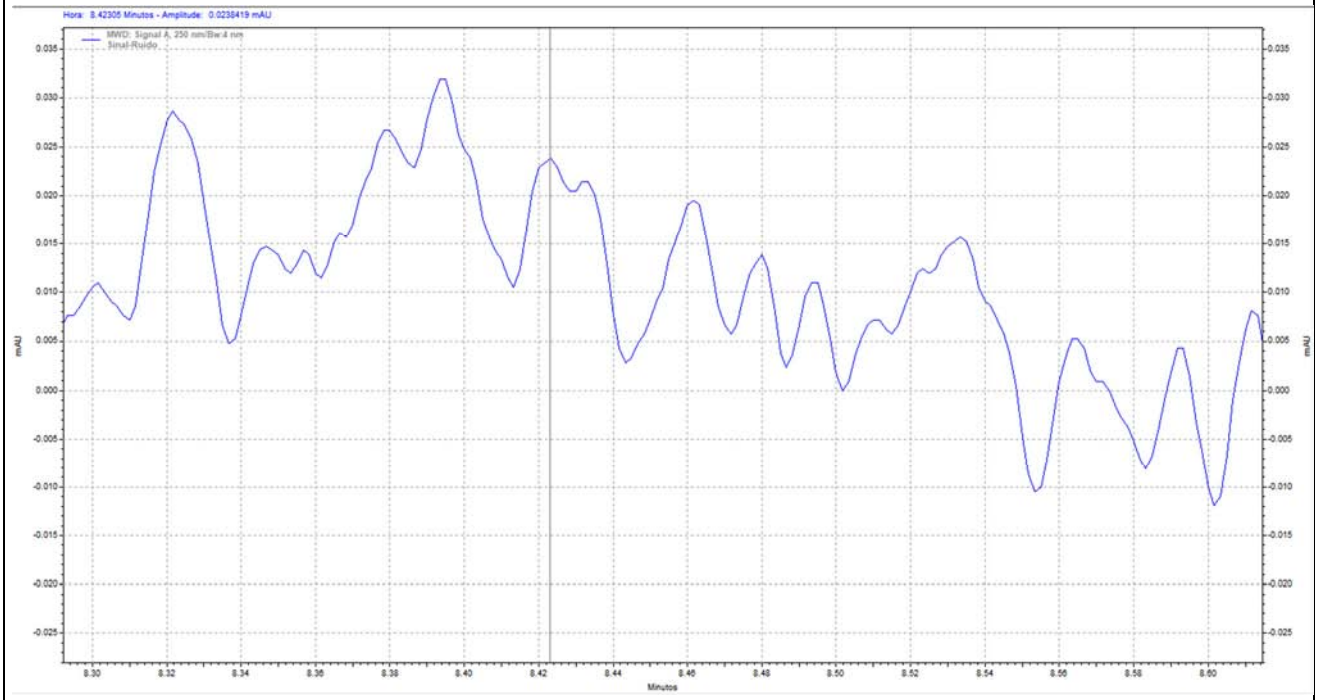


Estabilidade da Linha de Base:		
Valor máximo:	**-0.084877 mAU**	**Diferença (20 minutos): 0.290394 mAU**
Valor mínimo:	**-0.375271 mAU**	**Diferença (60 minutos): 0.290394 x 3 = 0.871182 mAU**

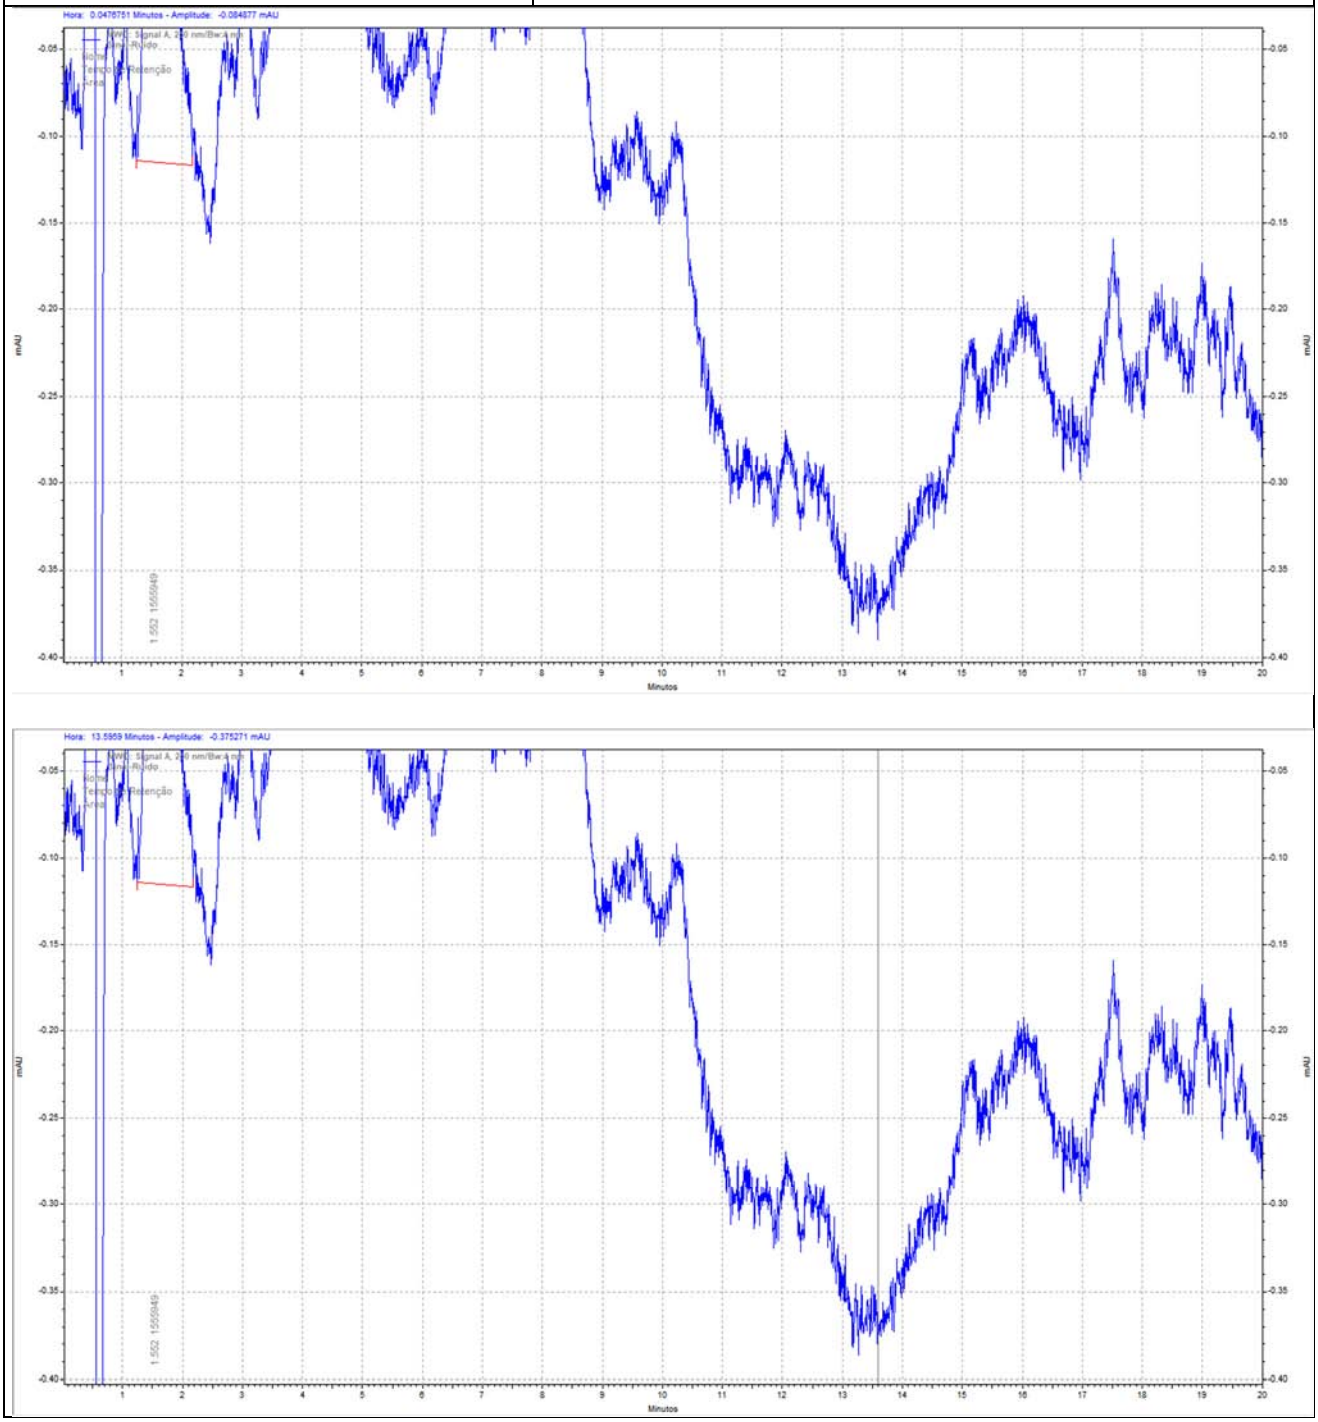


Altura do Pico:

Valor: 114.656 mAU

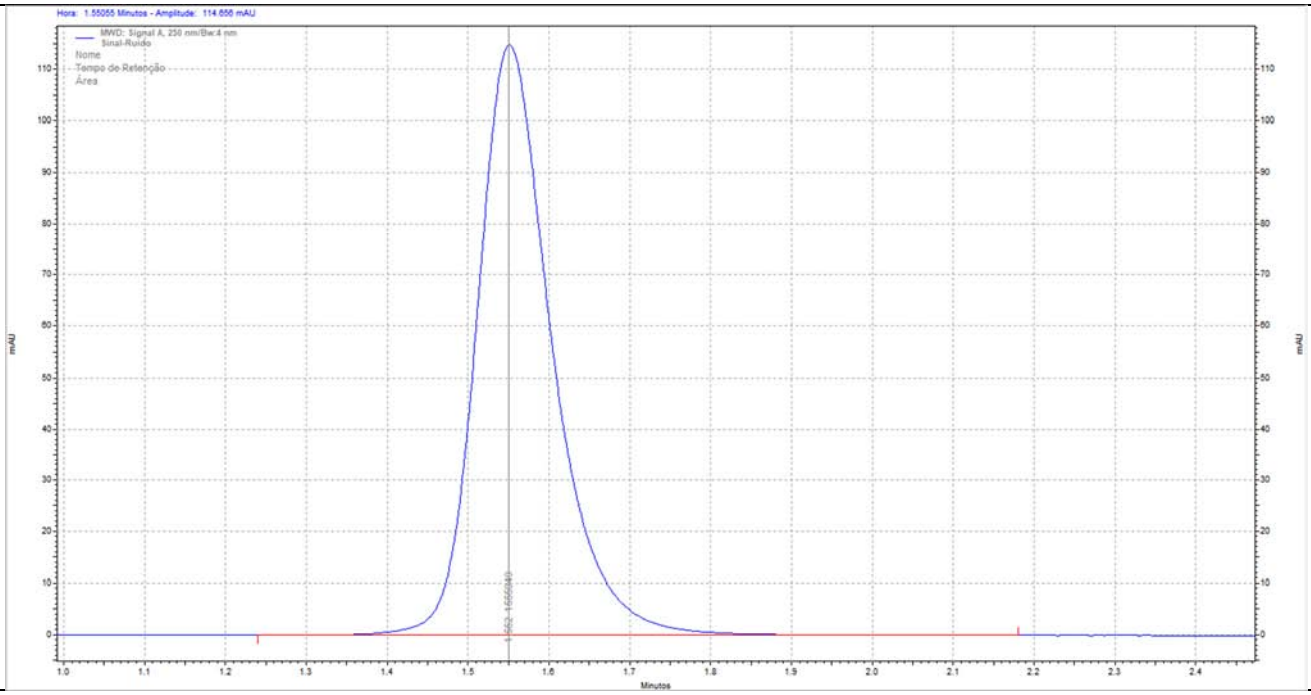

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Sinal-Ruido.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\Sinal-Ruido\Sinal-Ruido 002.rslt\Sinal-Ruido 002.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 11:27:16 (GMT -03:00)**
Impresso: **05/06/2023 12:00:57 (GMT -03:00)**

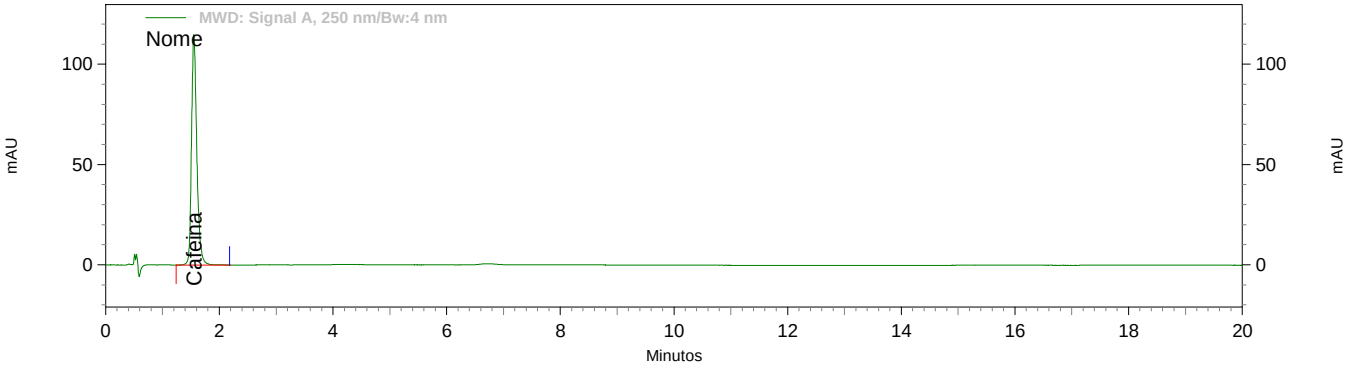


Resultados MWD: Signal A, 250 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.552	1555949	**0.000**

Totais			1555949	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 1.dat**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 10:29:54 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/05/2023 10:57:59 (GMT -03:00)**

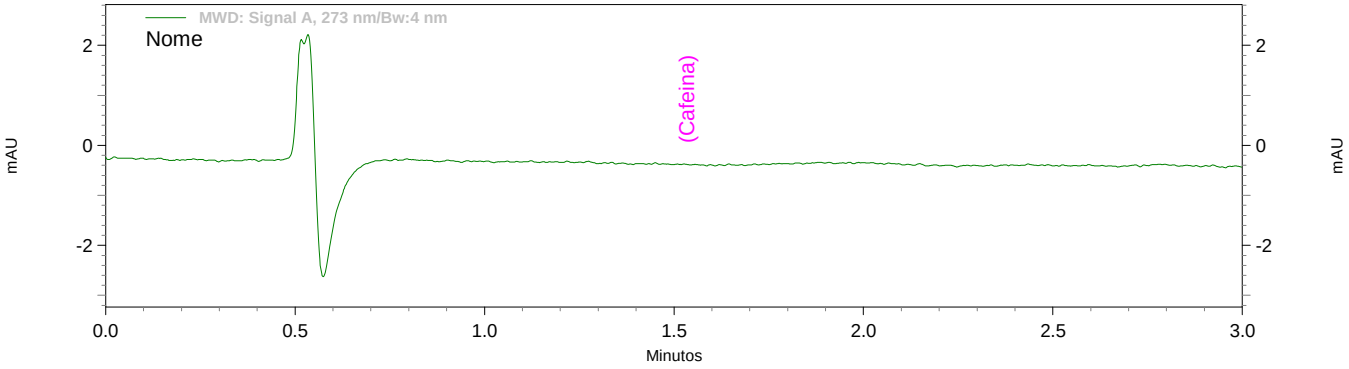


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
	Cafeina			**0.000 BDL**

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 2**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 10:34:36 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/05/2023 10:58:25 (GMT -03:00)**

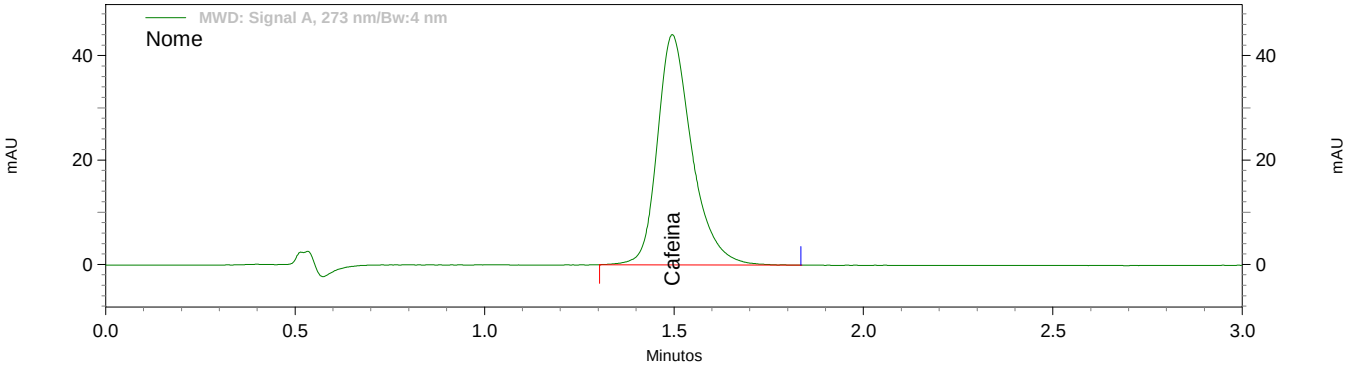


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.495	587614	**0.000**

Totais			587614	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 3**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 10:39:18 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/05/2023 10:58:45 (GMT -03:00)**

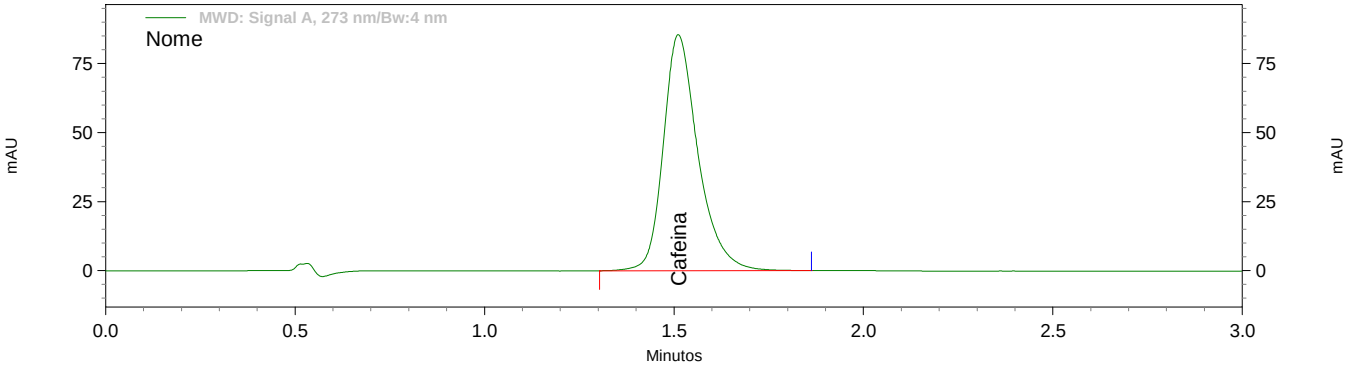


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.512	1144310	**0.000**

Totais			1144310	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 4**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 10:43:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/05/2023 10:58:59 (GMT -03:00)**

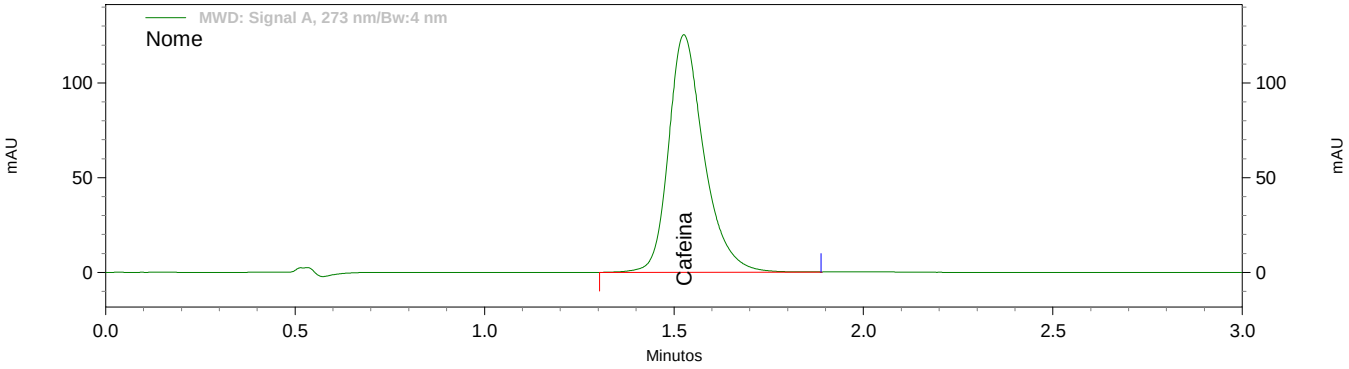


Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.527	1707827	**0.000**

Totais			1707827	**0.000**

Relatório de Normalização

Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met**
Arquivo de dados: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\Qualificação 2023\Sistema 02\LDUV\LDUV.seq 001.rslt\LDUV 5**
Usuário: **SISTEMA (SISTEMA)**
Adquirido: **23/05/2023 10:48:41 (GMT -03:00)**
Impresso: **23/05/2023 10:59:16 (GMT -03:00)**

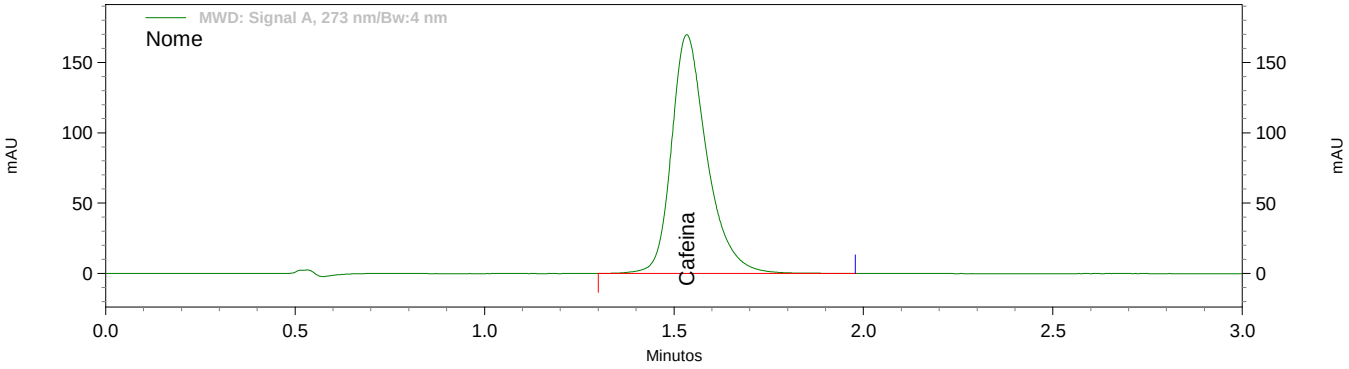

Resultados MWD: Signal A, 273 nm/Bw:4 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração NORM*
1	Cafeina	1.533	2317242	**0.000**

Totais			2317242	**0.000**