
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\Branco 01_2025-06-09 11-17-25-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-06-09 11:18:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

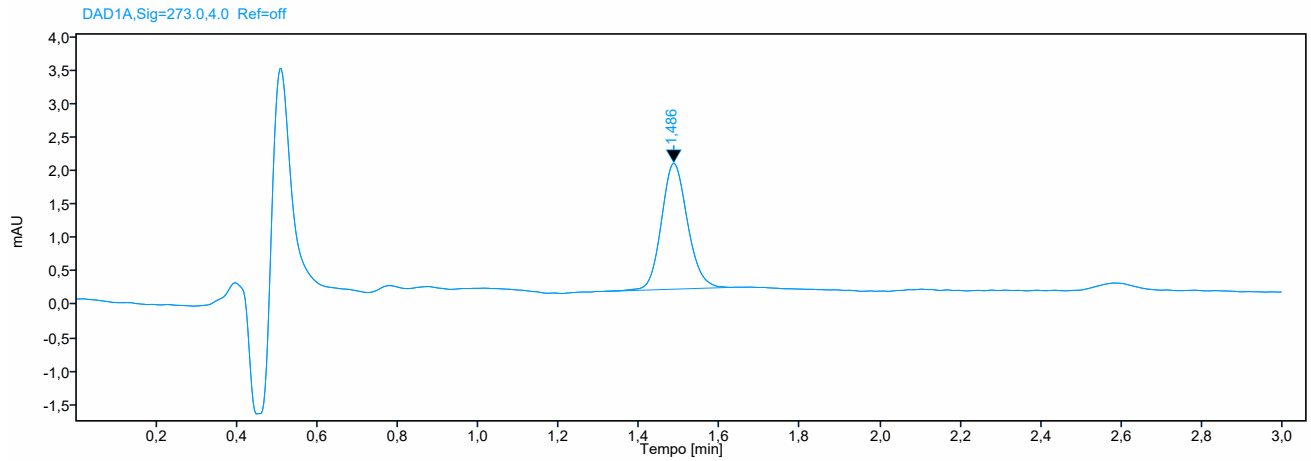


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,486	8,5164	1,8873			
Soma	8,5164				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 01_2025-06-09 11-21-14-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:22:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

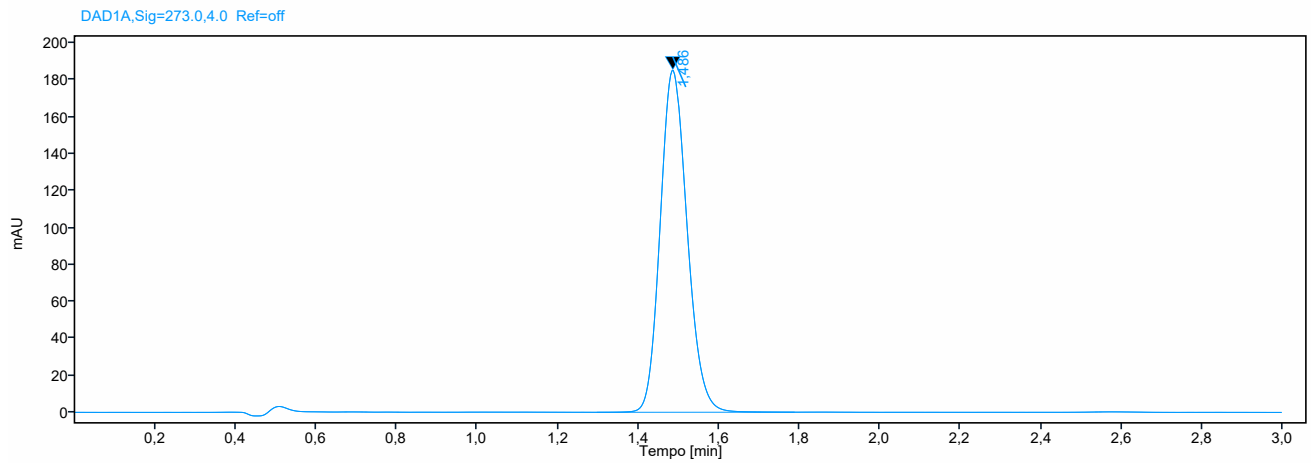


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,486	858,7873	185,5193			
Soma	858,7873				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 02_2025-06-09 11-25-07-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:25:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

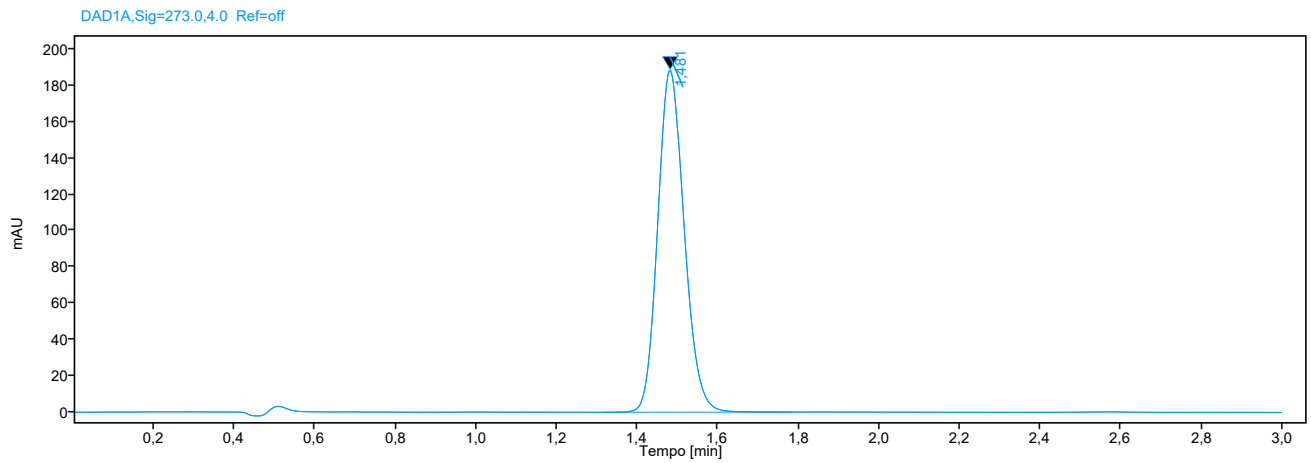


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,481	858,3139	188,7490			
Soma	858,3139				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 03_2025-06-09 11-29-00-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:29:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

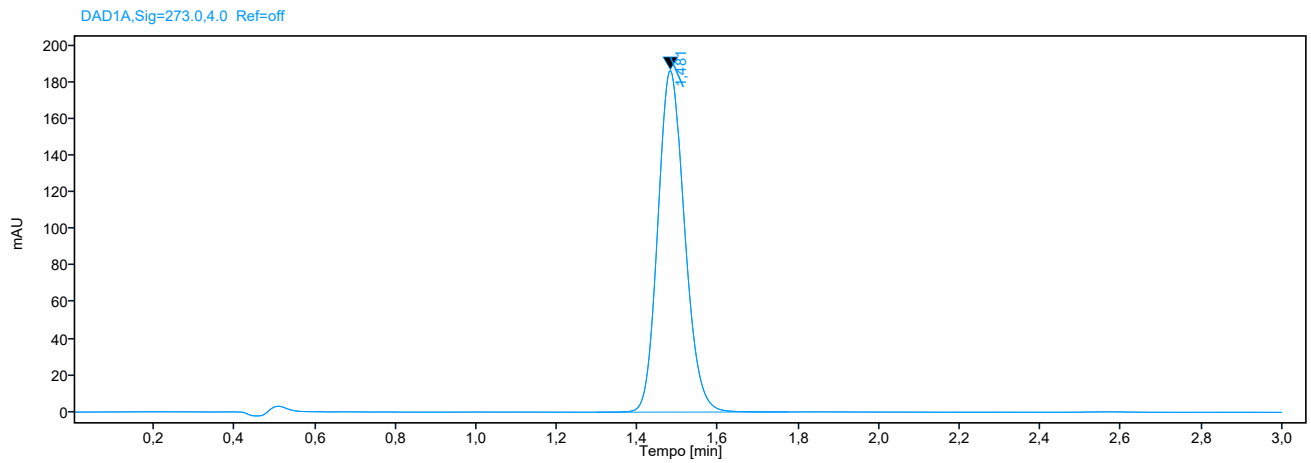


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,481	858,1023	186,6199			
Soma	858,1023				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\Branco 02_2025-06-09 11-32-53-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-06-09 11:33:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

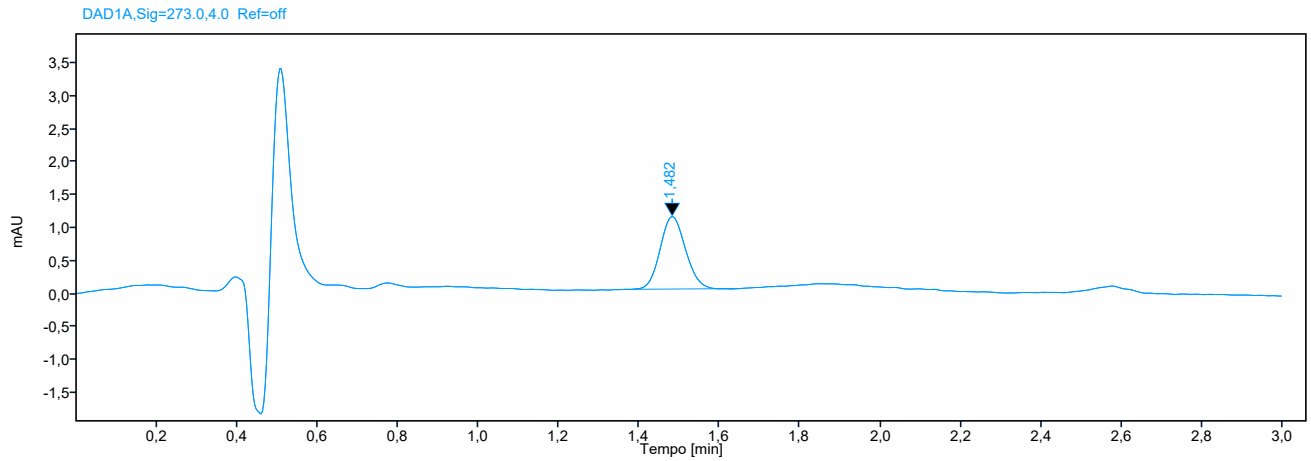


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,482	4,8245	1,1002			
Soma	4,8245				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 04_2025-06-09 11-36-48-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:37:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

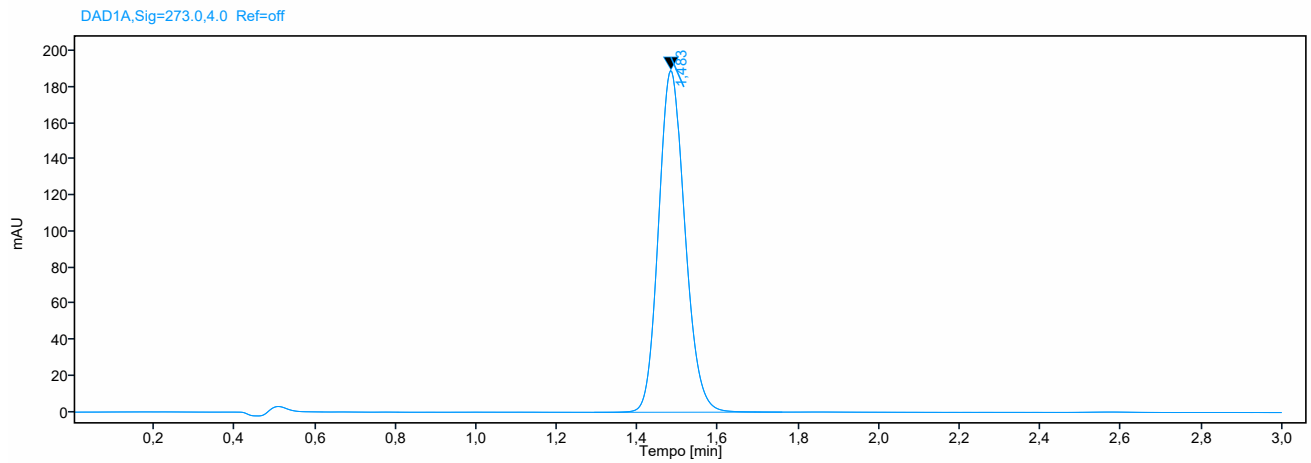


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,483	857,6980	189,4665			
Soma	857,6980				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 05_2025-06-09 11-40-41-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:41:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

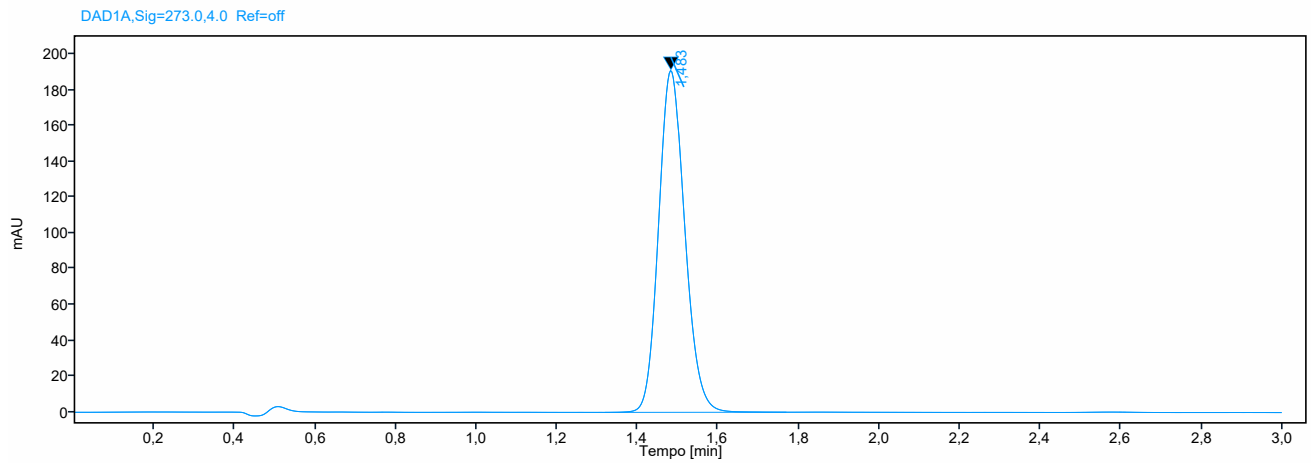


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,483	859,0820	190,8668			
Soma	859,0820				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\PCIN 06_2025-06-09 11-44-33-03-00.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:45:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

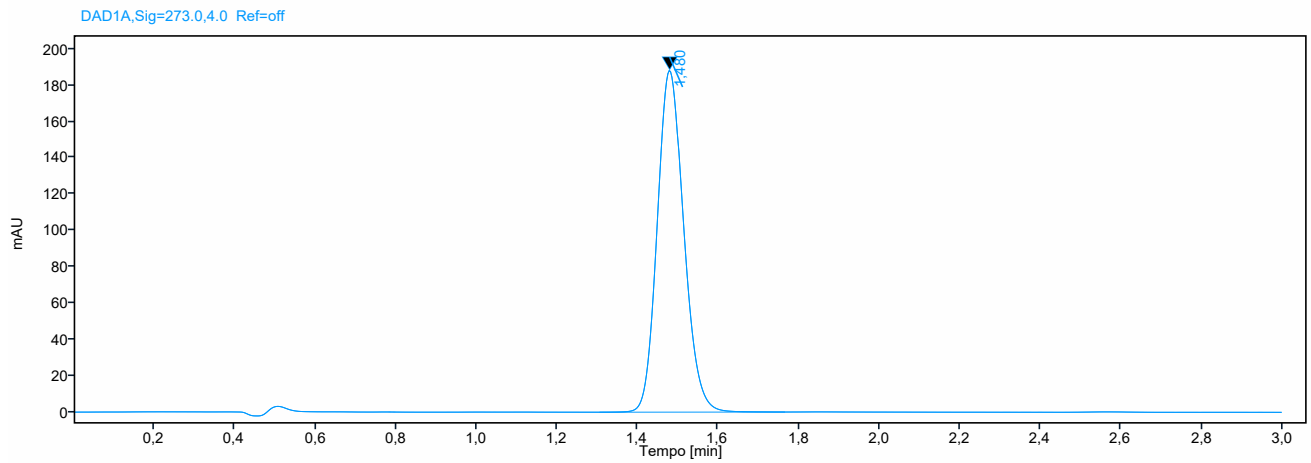


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,480	858,8154	188,2803			
Soma	858,8154				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\Branco 03_2025-06-09 11-48-27-03-00.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2025-06-09 11:49:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

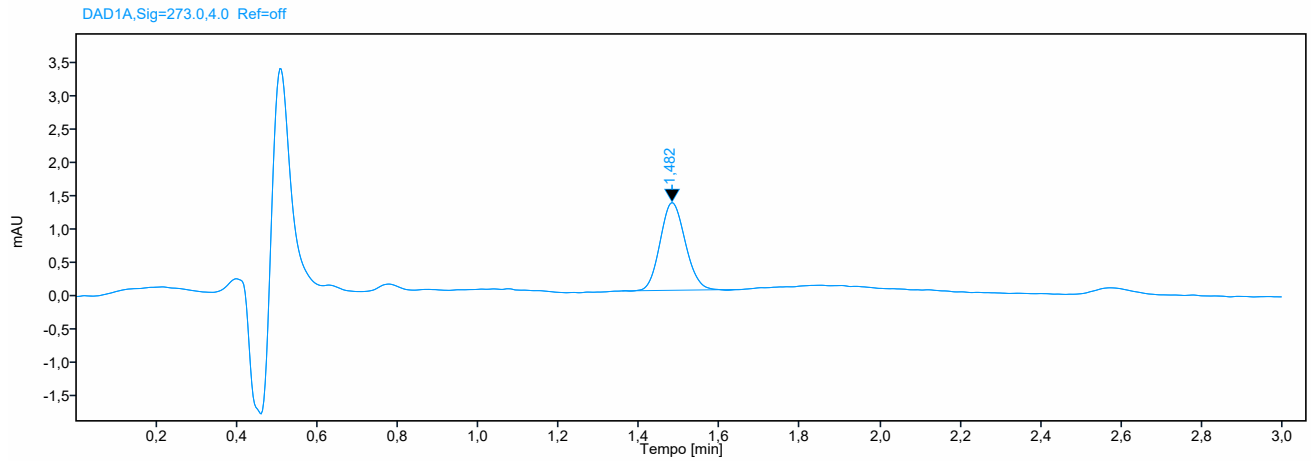


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,482	5,6952	1,3143			
Soma	5,6952				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\LIIN 01_2025-06-09 11-52-20-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:53:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

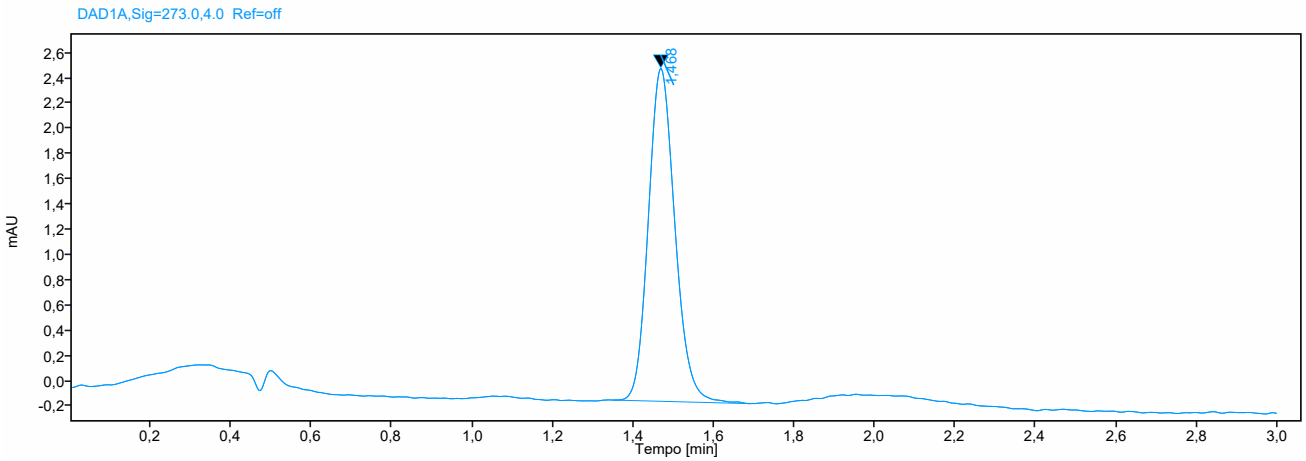


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,468	12,1390	2,6395			
Soma	12,1390				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\LIIN 02_2025-06-09 11-56-06-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 11:56:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

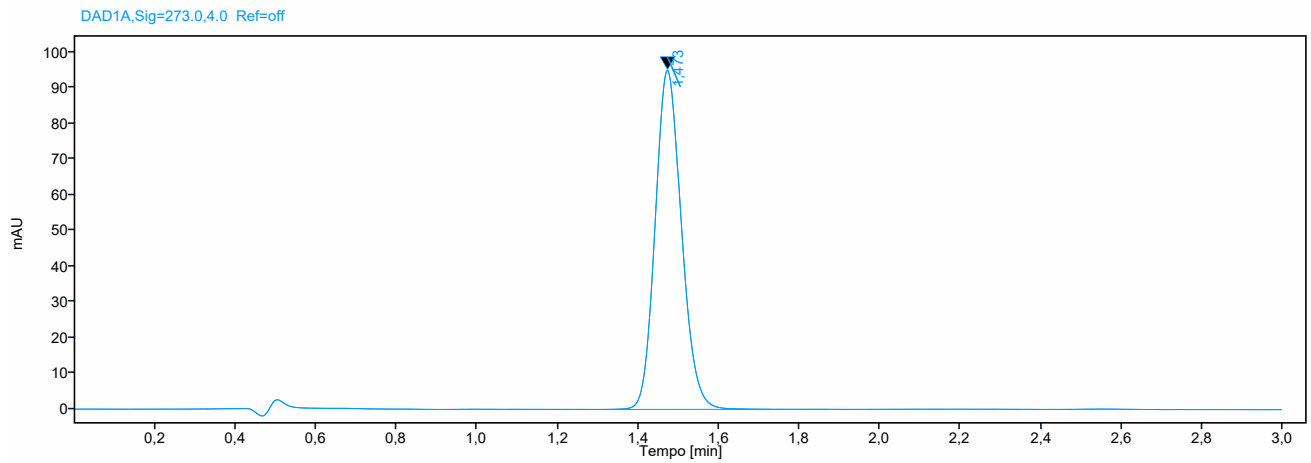


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,473	429,3624	94,9552			
Soma	429,3624				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\LIIN 03_2025-06-09 11-59-49-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 12:00:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

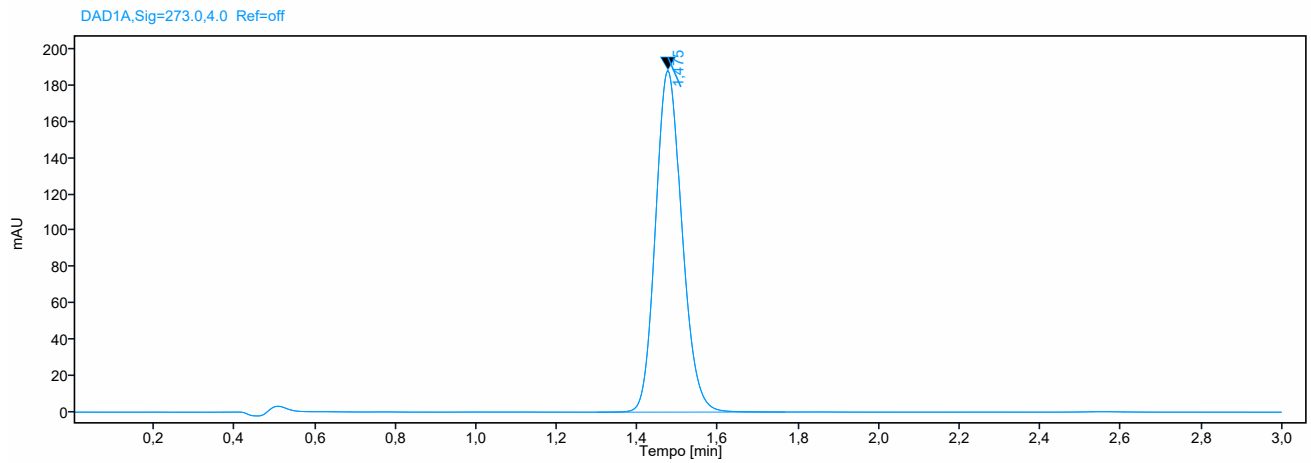


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,475	857,9178	188,4669			
Soma	857,9178				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\LIIN 04_2025-06-09 12-03-37-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 12:04:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

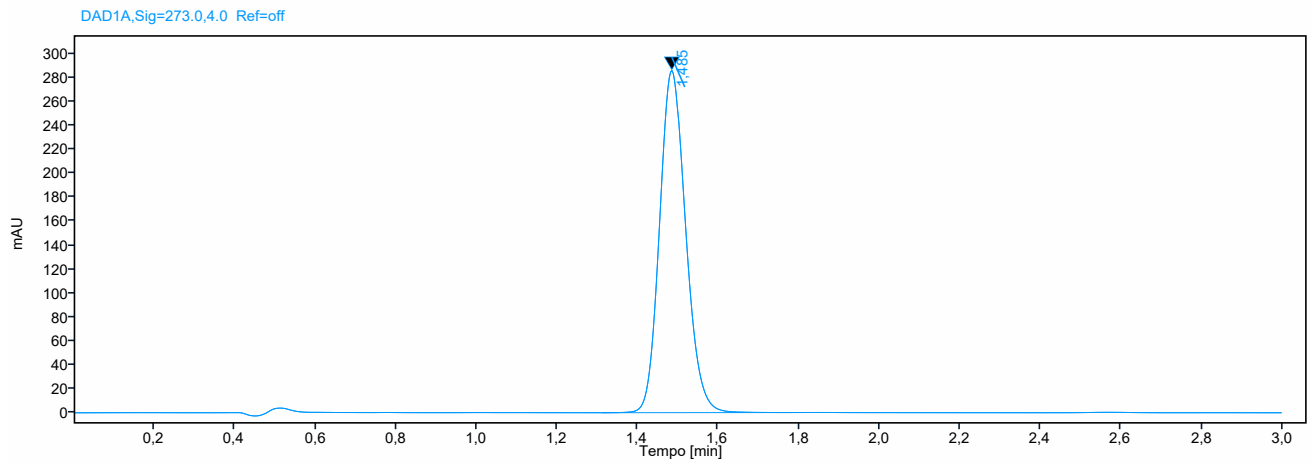


Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,485	1284,9290	286,2015			
Soma	1284,9290				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\Zoetis\HPLC 15\Results\HPLC 15-2025-06-09 11-17-18-03-00.rslt\LIIN 05_2025-06-09 12-07-33-03-00.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC 15	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2025-06-09 12:08:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-06-09 12:16:04-03:00		

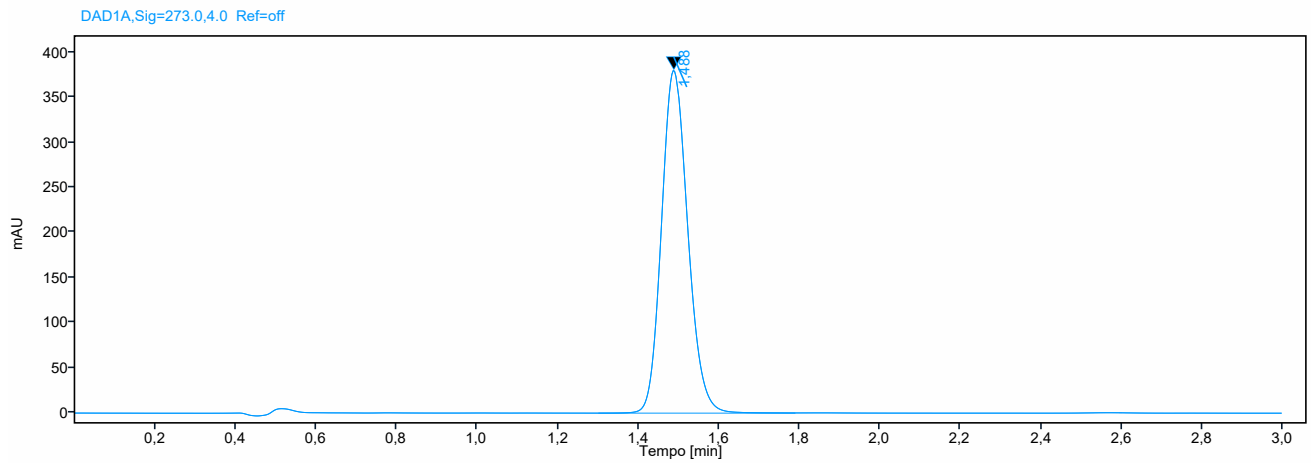

Sinal: DAD1A,Sig=273.0,4.0 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,488	1715,3520	379,5755			
Soma	1715,3520				