
19.2 – EXATIDÃO E PRECISÃO DAS LEITURAS

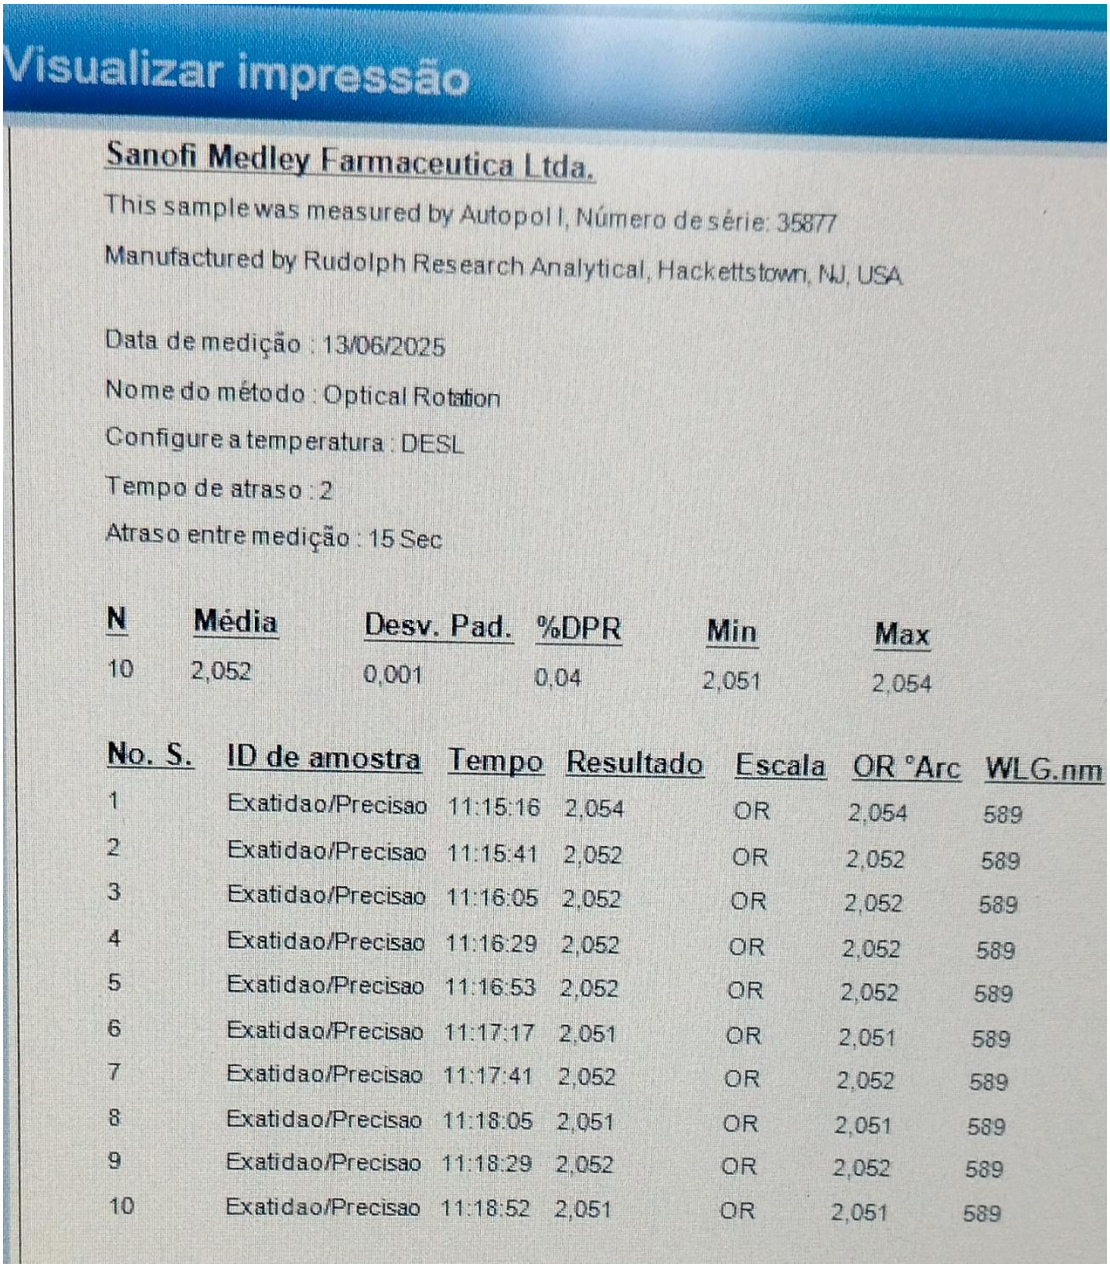

Visualizar impressão

**Sanofi Medley Farmaceutica Ltda.**

This sample was measured by Autopol I, Número de série: 35877

Manufactured by Rudolph Research Analytical, Hackettstown, NJ, USA

Data de medição : 13/06/2025

Nome do método : Optical Rotation

Configure a temperatura : DESL


Tempo de atraso : 2

Atraso entre medição : 15 Sec

| N | Média | Desv. Pad. | %DPR | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2,052 | 0,001 | 0,04 | 2,051 | 2,054 |

| No. S. | ID de amostra | Tempo | Resultado | Escala | OR °Arc | WLG.nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exatidao/Precisao | 11:15:16 | 2,054 | OR | 2,054 | 589 |
| 2 | Exatidao/Precisao | 11:15:41 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 3 | Exatidao/Precisao | 11:16:05 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 4 | Exatidao/Precisao | 11:16:29 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 5 | Exatidao/Precisao | 11:16:53 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 6 | Exatidao/Precisao | 11:17:17 | 2,051 | OR | 2,051 | 589 |
| 7 | Exatidao/Precisao | 11:17:41 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 8 | Exatidao/Precisao | 11:18:05 | 2,051 | OR | 2,051 | 589 |
| 9 | Exatidao/Precisao | 11:18:29 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 10 | Exatidao/Precisao | 11:18:52 | 2,051 | OR | 2,051 | 589 |

19.3 – REPETIBILIDADE DO ZERO

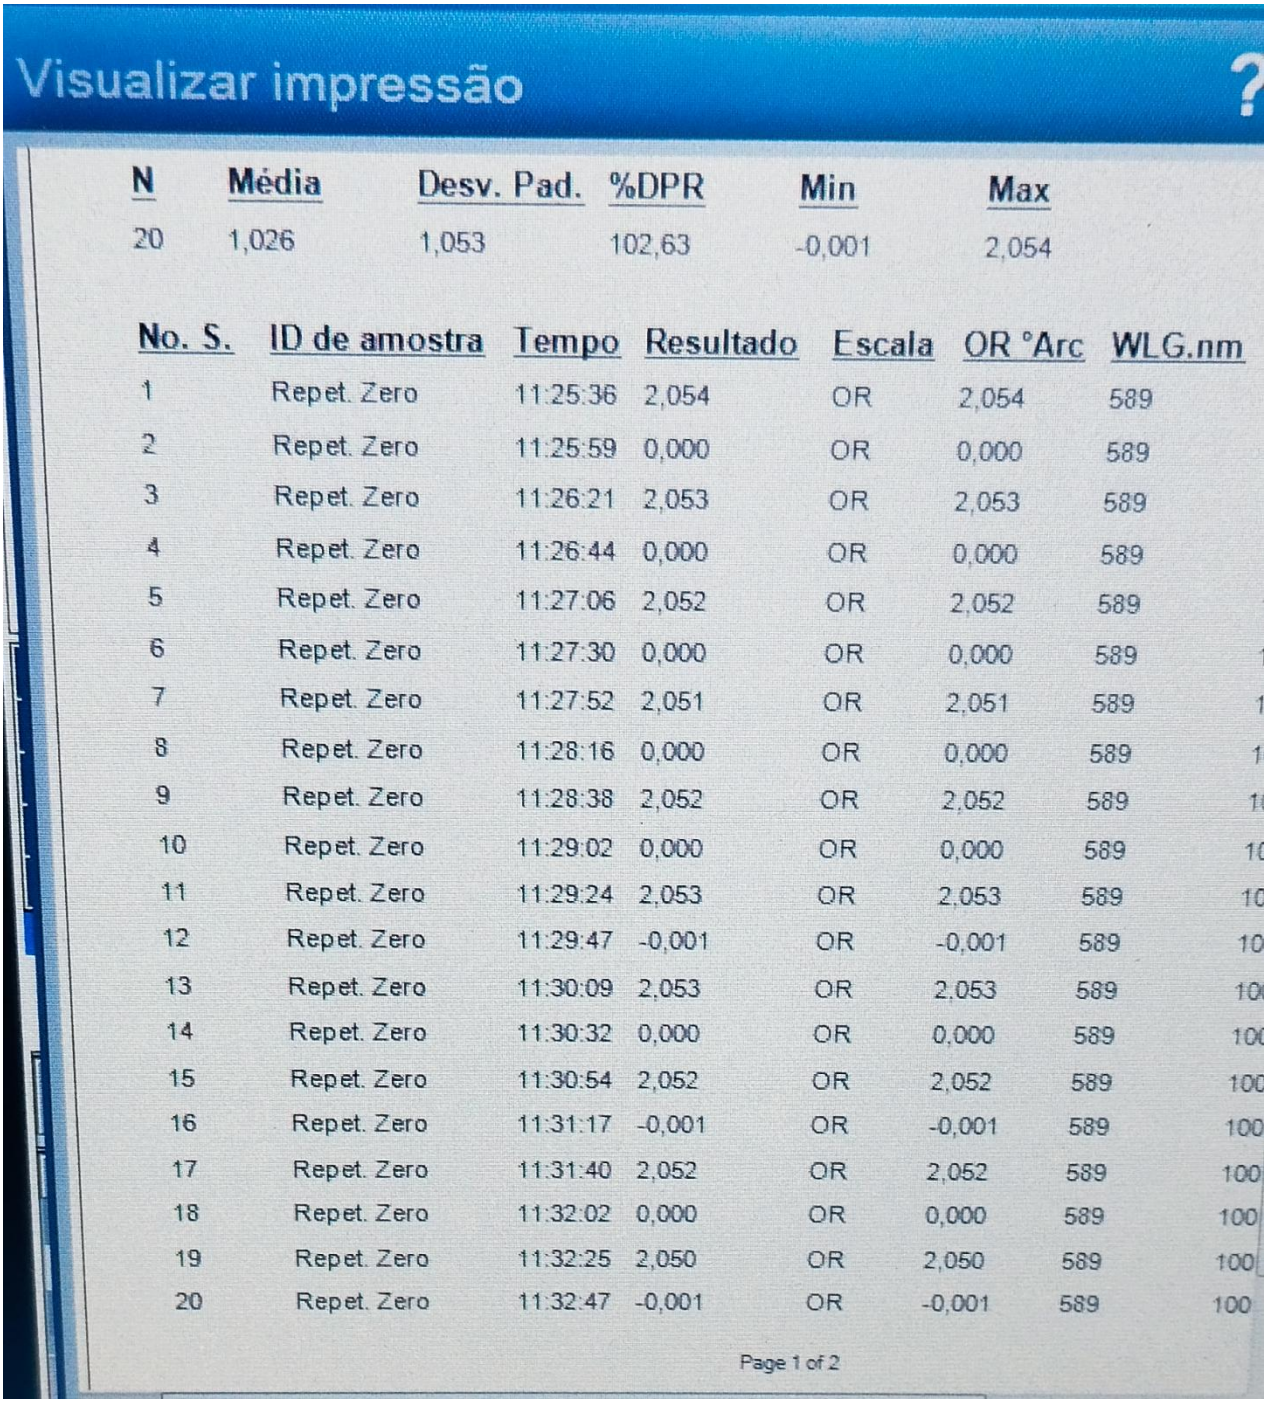

Visualizar impressão

| N | Média | Desv. Pad. | %DPR | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,026 | 1,053 | 102,63 | -0,001 | 2,054 |

| No. S. | ID de amostra | Tempo | Resultado | Escala | OR °Arc | WLG.nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repet. Zero | 11:25:36 | 2,054 | OR | 2,054 | 589 |
| 2 | Repet. Zero | 11:25:59 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 3 | Repet. Zero | 11:26:21 | 2,053 | OR | 2,053 | 589 |
| 4 | Repet. Zero | 11:26:44 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 5 | Repet. Zero | 11:27:06 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 6 | Repet. Zero | 11:27:30 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 7 | Repet. Zero | 11:27:52 | 2,051 | OR | 2,051 | 589 |
| 8 | Repet. Zero | 11:28:16 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 9 | Repet. Zero | 11:28:38 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 10 | Repet. Zero | 11:29:02 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 11 | Repet. Zero | 11:29:24 | 2,053 | OR | 2,053 | 589 |
| 12 | Repet. Zero | 11:29:47 | -0,001 | OR | -0,001 | 589 |
| 13 | Repet. Zero | 11:30:09 | 2,053 | OR | 2,053 | 589 |
| 14 | Repet. Zero | 11:30:32 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 15 | Repet. Zero | 11:30:54 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 16 | Repet. Zero | 11:31:17 | -0,001 | OR | -0,001 | 589 |
| 17 | Repet. Zero | 11:31:40 | 2,052 | OR | 2,052 | 589 |
| 18 | Repet. Zero | 11:32:02 | 0,000 | OR | 0,000 | 589 |
| 19 | Repet. Zero | 11:32:25 | 2,050 | OR | 2,050 | 589 |
| 20 | Repet. Zero | 11:32:47 | -0,001 | OR | -0,001 | 589 |

Page 1 of 2

19.4 – PRECISÃO DA TEMPERATURA

