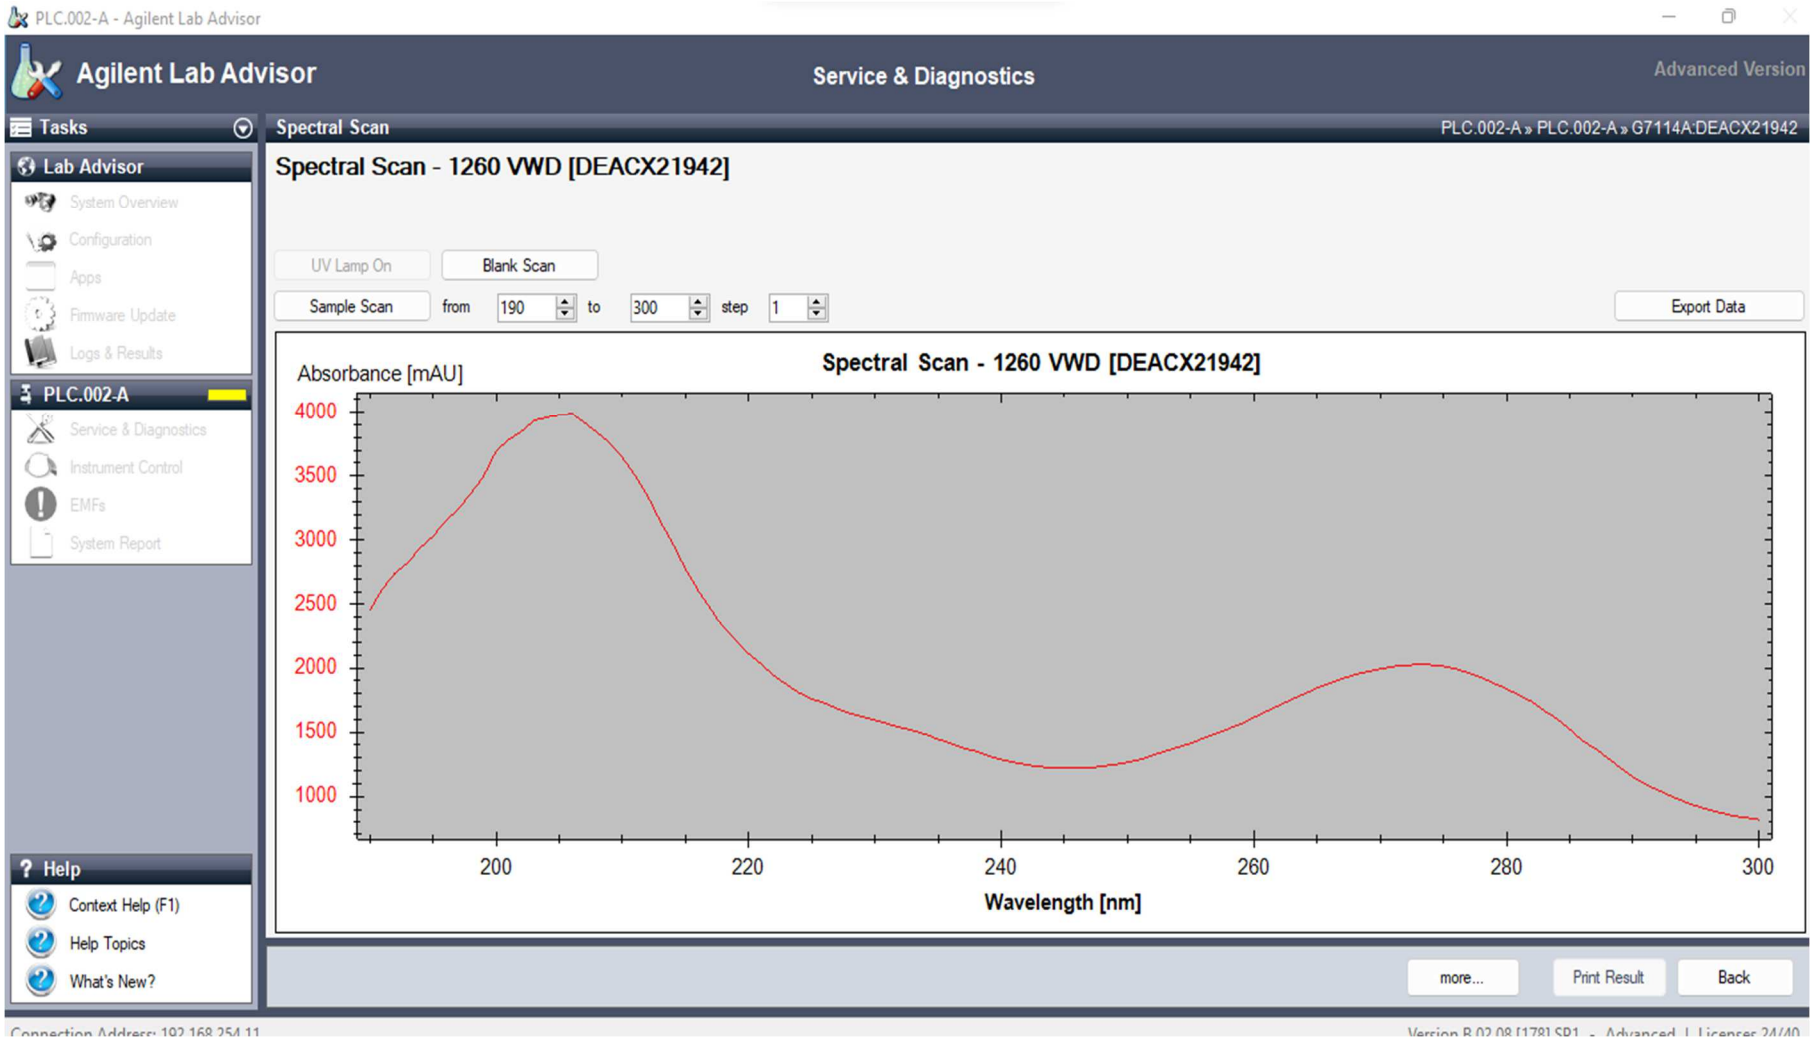

PLC.002-A - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Advanced Version
Tasks
Spectral Scan
PLC.002-A » PLC.002-A » G7114A:DEACX21942
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
PLC.002-A
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from
190
to
300
step
1
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEACX21942]
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
200
220
240
260
280
300
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back


[nm],[mAU]
190,00,2456,328
191,00,2621,104
192,00,2746,253
193,00,2825,601
194,00,2942,248
195,00,3030,806
196,00,3149,174
197,00,3241,579
198,00,3364,950
199,00,3496,715
200,00,3695,032
201,00,3783,359
202,00,3846,912
203,00,3932,877
204,00,3958,369
205,00,3976,243
206,00,3989,056
207,00,3916,328
208,00,3838,190
209,00,3756,901
210,00,3642,808
211,00,3504,115
212,00,3344,089
213,00,3147,177
214,00,2972,690
215,00,2775,022
216,00,2610,812
217,00,2466,107
218,00,2317,159
219,00,2212,254
220,00,2108,675
221,00,2028,661
222,00,1937,378
223,00,1870,539
224,00,1806,225
225,00,1758,636
226,00,1725,541
227,00,1682,031
228,00,1647,396
229,00,1619,060
230,00,1592,886
231,00,1565,545
232,00,1537,257
233,00,1512,636
234,00,1483,762
235,00,1445,754
236,00,1412,565
237,00,1376,310
238,00,1352,580
239,00,1315,707
240,00,1288,406
241,00,1264,526
242,00,1247,908
243,00,1232,371
244,00,1223,899
245,00,1219,206
246,00,1218,484
247,00,1223,680
248,00,1234,827
249,00,1249,433
250,00,1266,474
251,00,1288,699
252,00,1322,108
253,00,1353,043
254,00,1384,178
255,00,1413,890
256,00,1455,532
257,00,1490,094
258,00,1527,743
259,00,1564,143
260,00,1614,905
261,00,1663,521
262,00,1709,129
263,00,1755,988
264,00,1799,521
265,00,1843,859
266,00,1881,788
267,00,1916,633
268,00,1947,405
269,00,1972,269
270,00,1991,556
271,00,2010,170
272,00,2021,332
273,00,2026,070
274,00,2023,510
275,00,2013,232
276,00,1990,353
277,00,1961,360
278,00,1926,056
279,00,1879,926
280,00,1838,577
281,00,1786,405
282,00,1738,329
283,00,1667,671
284,00,1603,379
285,00,1524,328
286,00,1433,420
287,00,1373,959
288,00,1301,557

289,00,1223,976
290,00,1151,972
291,00,1094,983
292,00,1050,295
293,00,1004,224
294,00,963,409
295,00,928,288
296,00,898,462
297,00,873,018
298,00,848,242
299,00,834,826
300,00,820,896

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\Branco 01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2022-08-30 11:05:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

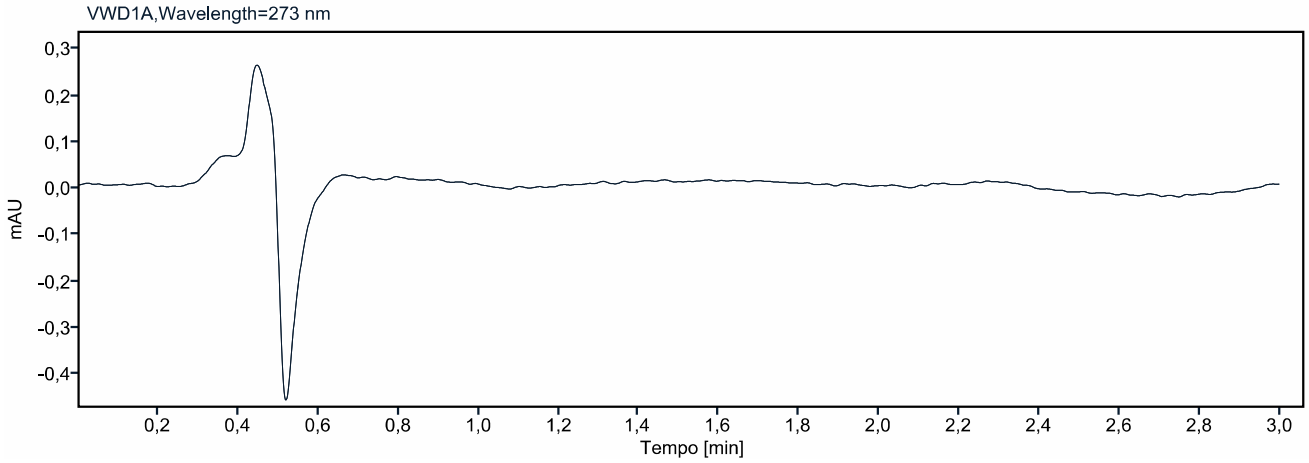

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:09:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

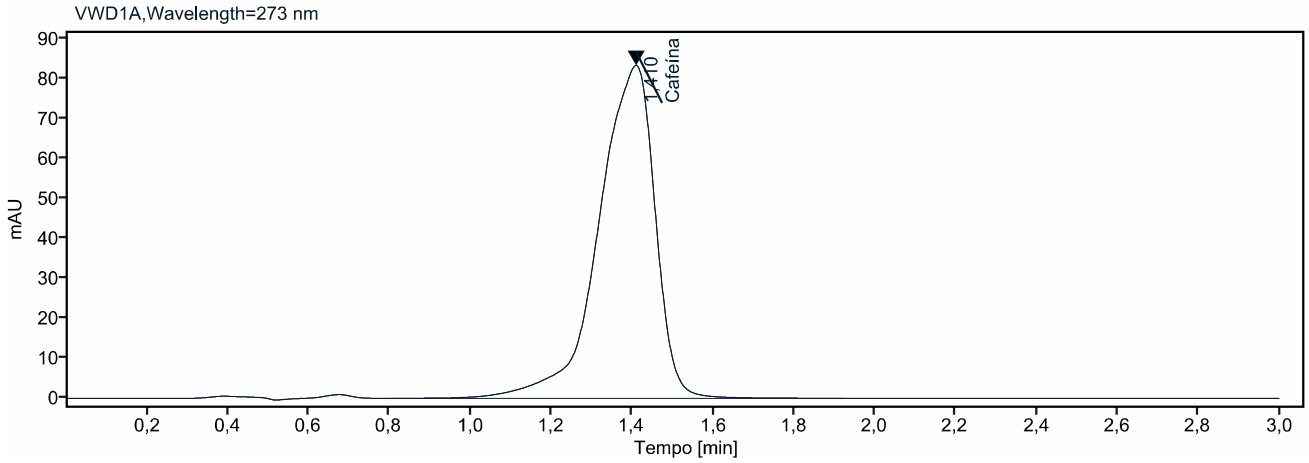


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,410	BB	1,1217	807,3683	83,3107	100,0000	Cafeína
		Soma	**807,3683**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:12:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

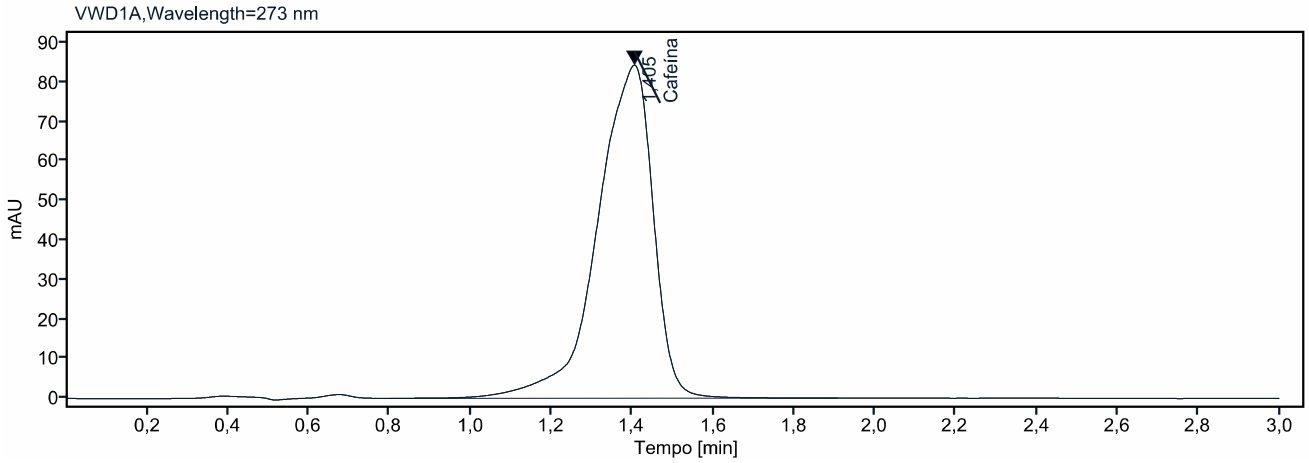


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,405	BB	1,1061	807,3384	84,2424	100,0000	Cafeína
		Soma	**807,3384**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:16:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

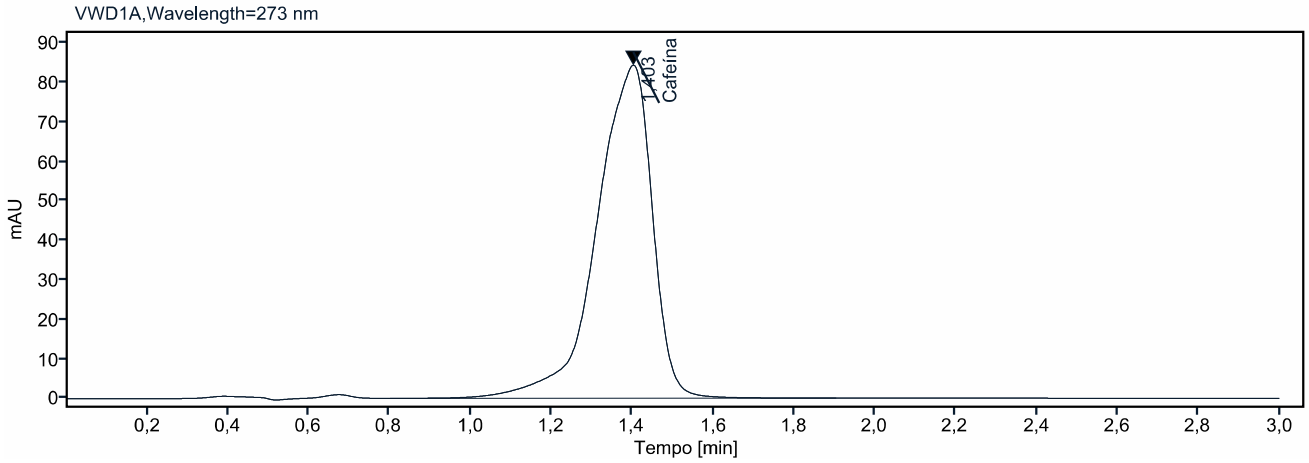


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,403	BB	1,1025	807,7904	84,4859	100,0000	Cafeína
		Soma	**807,7904**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\Branco 02.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2022-08-30 11:20:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

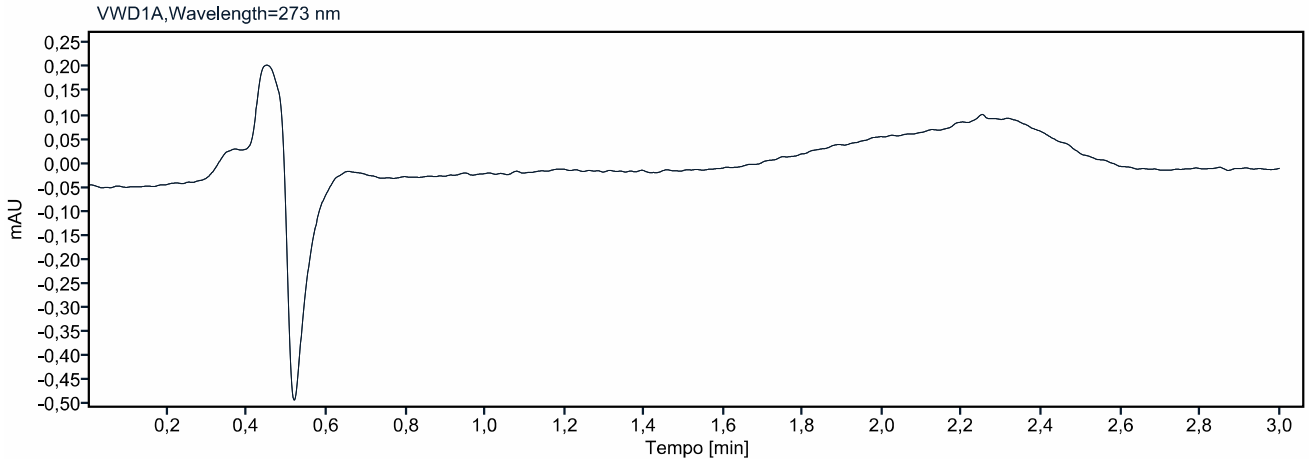

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:24:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

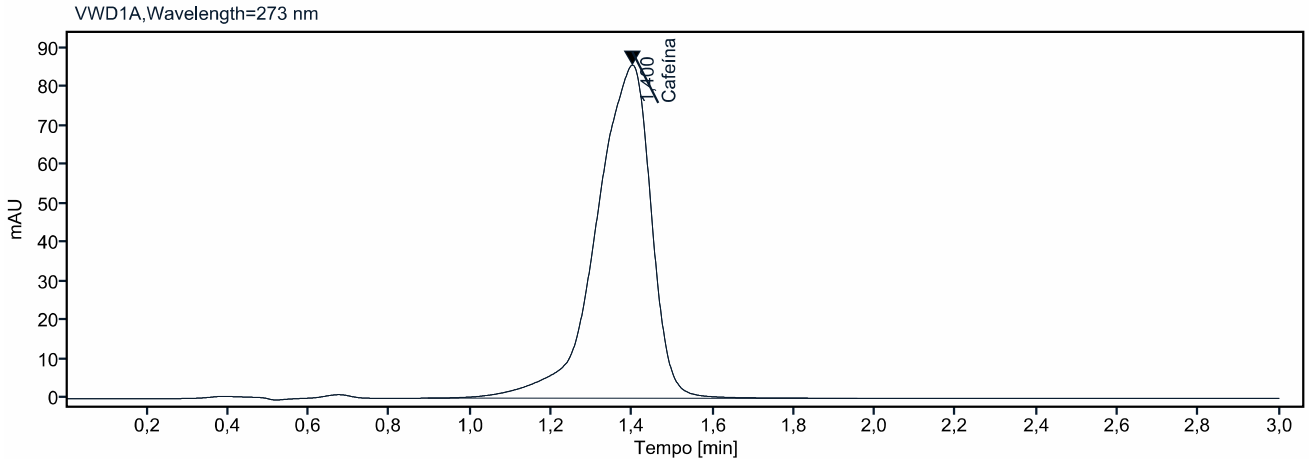


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,400	BB	1,0617	807,9356	85,5166	100,0000	Cafeína
		Soma	**807,9356**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:28:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

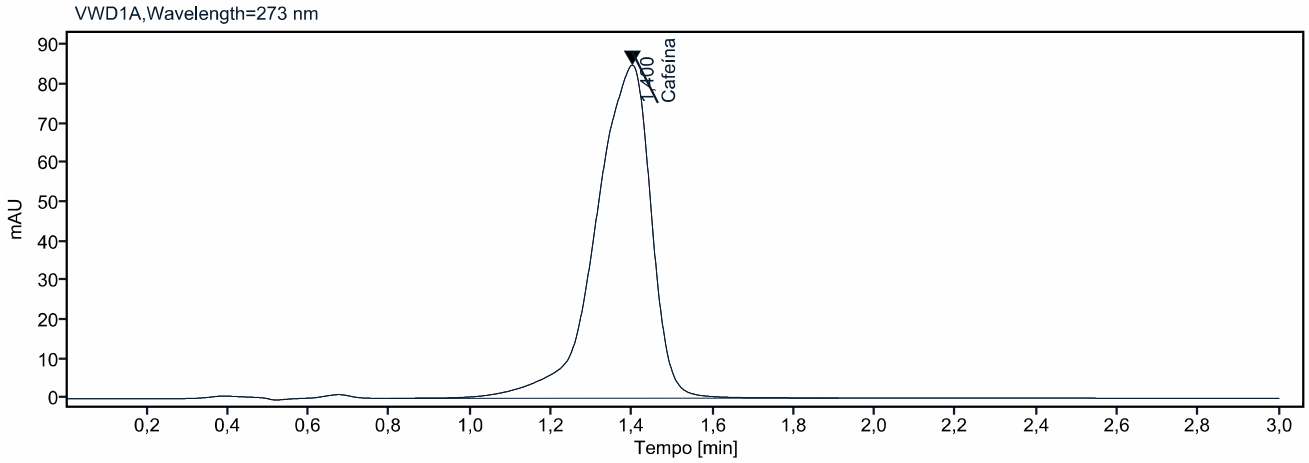


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,400	BB	1,1088	808,3423	84,7417	100,0000	Cafeína
		Soma	**808,3423**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2022-08-30 11:31:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

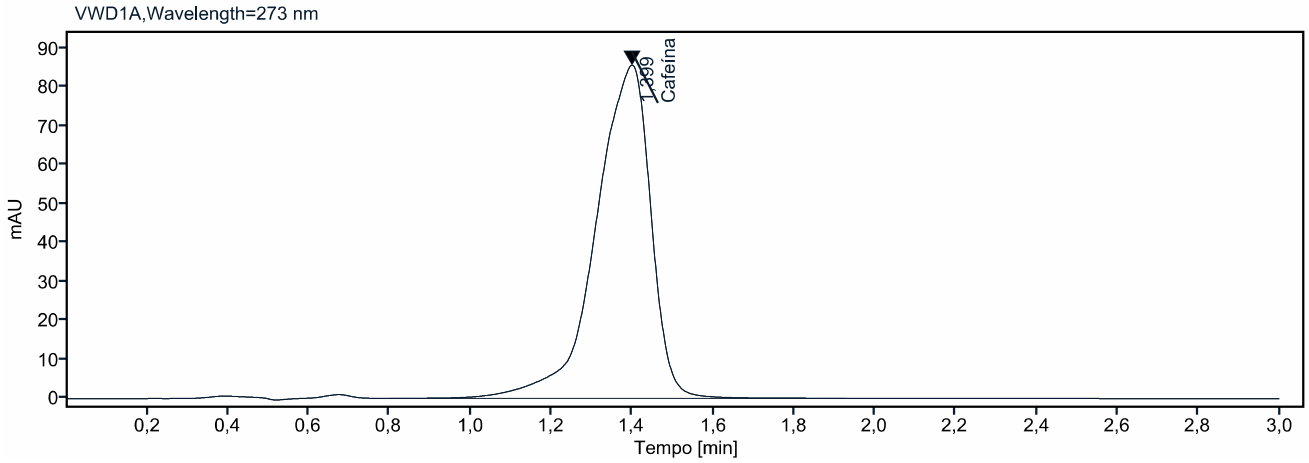


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,399	BB	1,1267	808,0439	85,5237	100,0000	Cafeína
		Soma	**808,0439**			

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-04-22-03-00.rslt\Branco 03.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2022-08-30 11:35:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

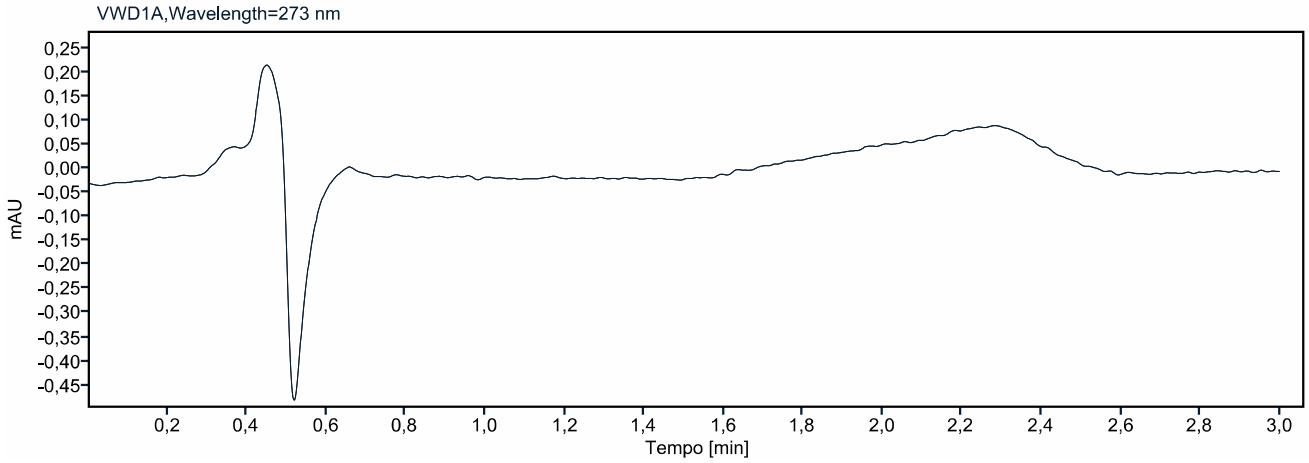

Relatório de Injeção Única

Agilent


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-04-03-00.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A3
Data da injeção:	2022-08-30 11:39:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

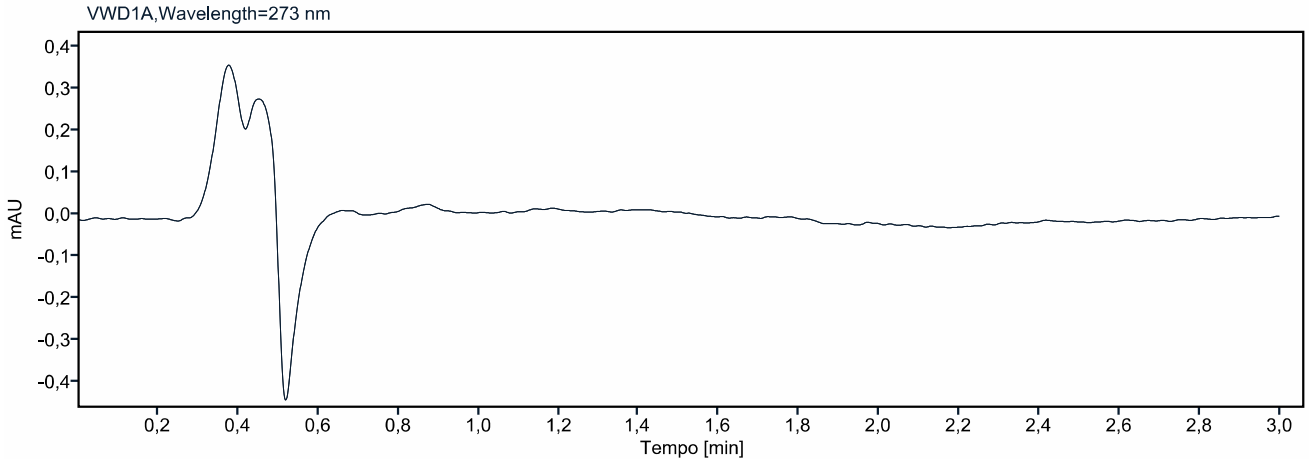

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-04-03-00.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A4
Data da injeção:	2022-08-30 11:43:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

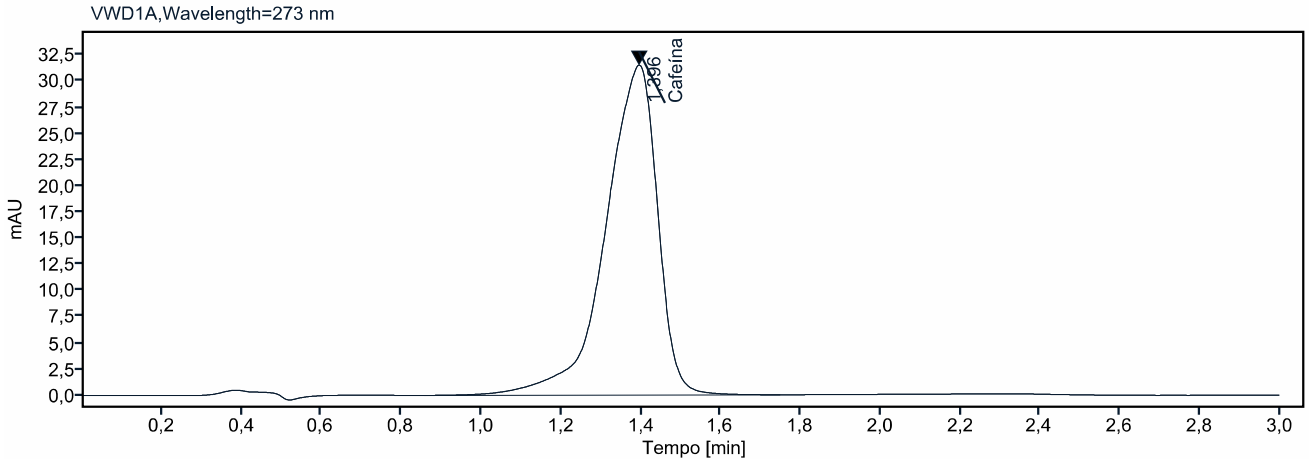


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,396	BB	0,8917	284,7872	31,5332	100,0000	Cafeína
		Soma	**284,7872**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-04-03-00.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2022-08-30 11:47:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

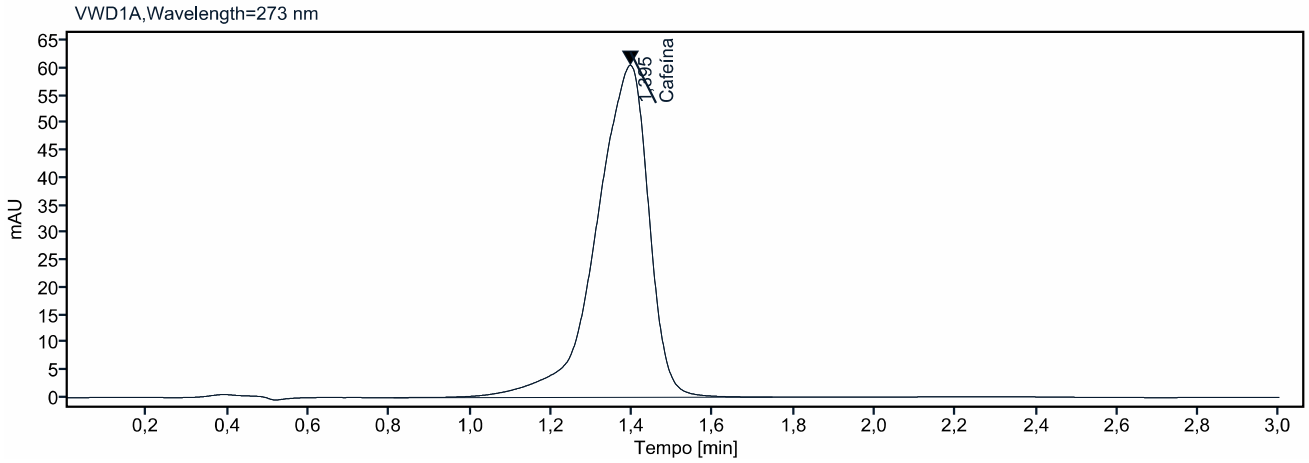


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,395	BB	0,9363	545,3326	60,5017	100,0000	Cafeína
		Soma	**545,3326**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-04-03-00.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2022-08-30 11:51:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

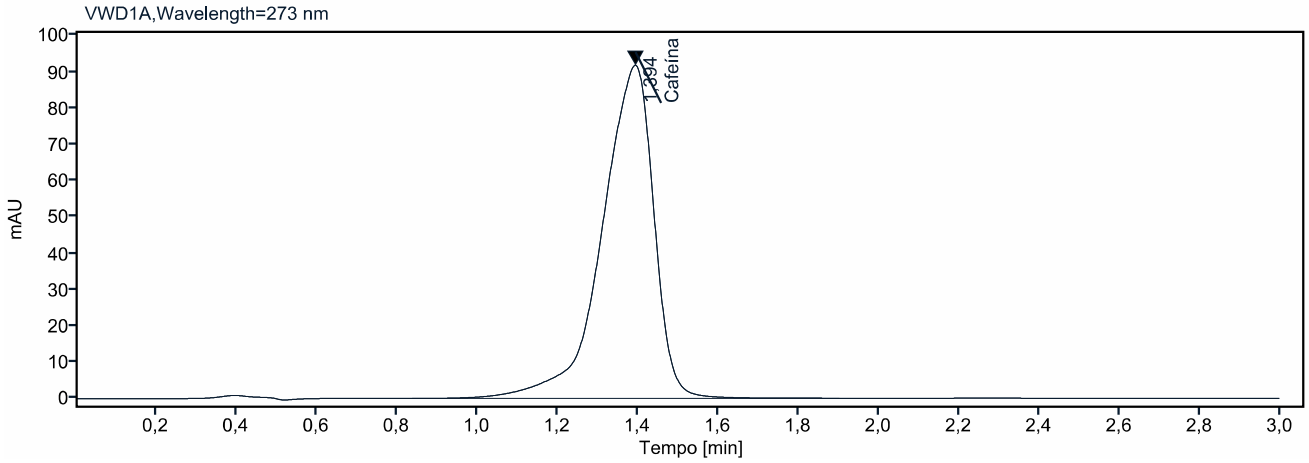


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,394	BB	1,0639	823,9790	91,7978	100,0000	Cafeína
		Soma	**823,9790**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-04-03-00.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A7
Data da injeção:	2022-08-30 11:54:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

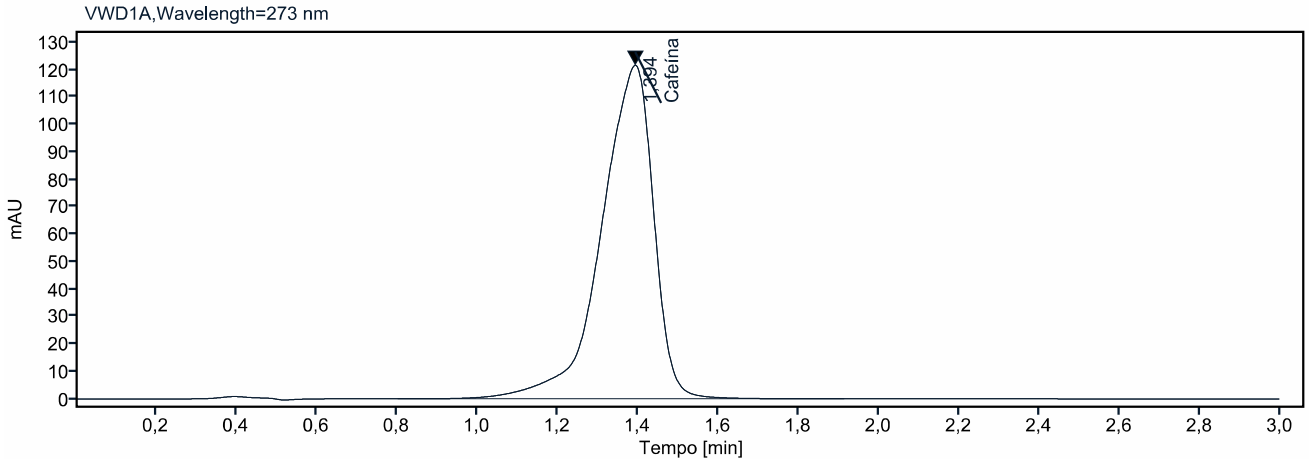


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,394	BB	1,1125	1101,0152	121,7332	100,0000	Cafeína
		Soma	**1101,0152**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-12-03-00.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A8
Data da injeção:	2022-08-30 11:58:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

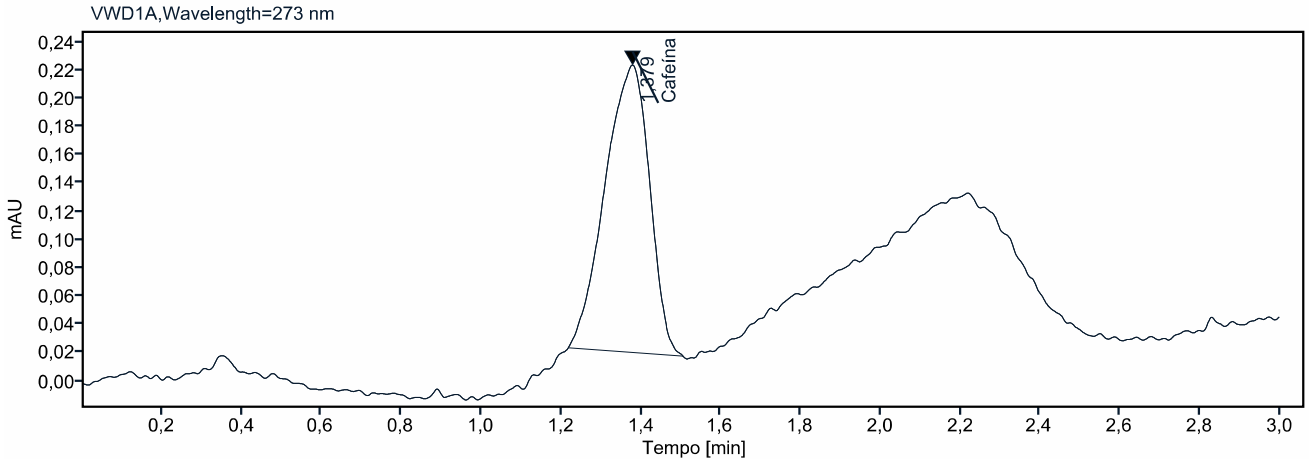


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,379	MM m	0,2878	1,5799	0,2036	100,0000	Cafeína
		Soma	**1,5799**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-12-03-00.rslt\LIIN 02.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A8
Data da injeção:	2022-08-30 12:02:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

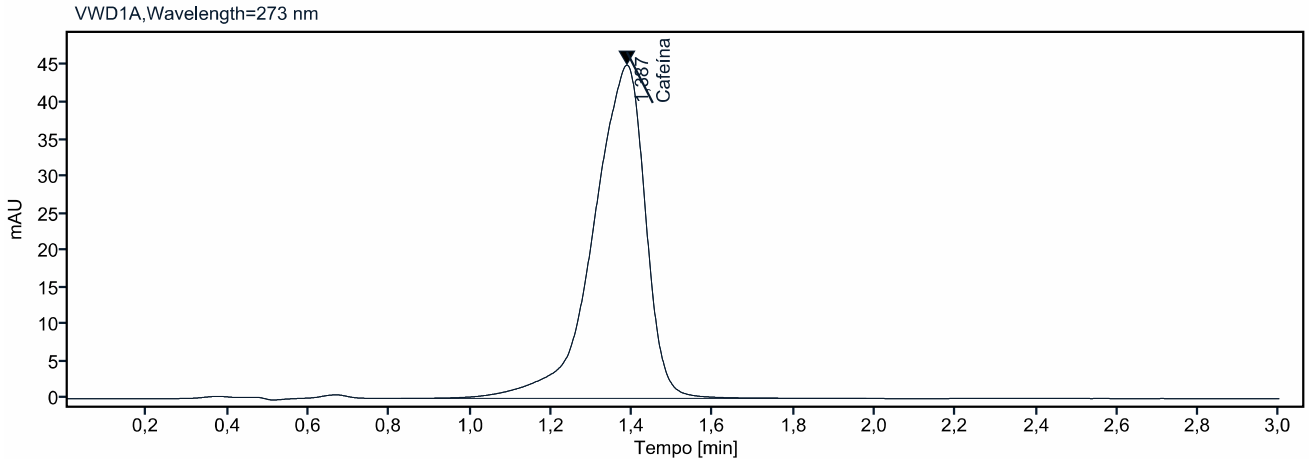


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,387	BB	1,1500	404,5237	45,0243	100,0000	Cafeína
		Soma	**404,5237**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-12-03-00.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A8
Data da injeção:	2022-08-30 12:06:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

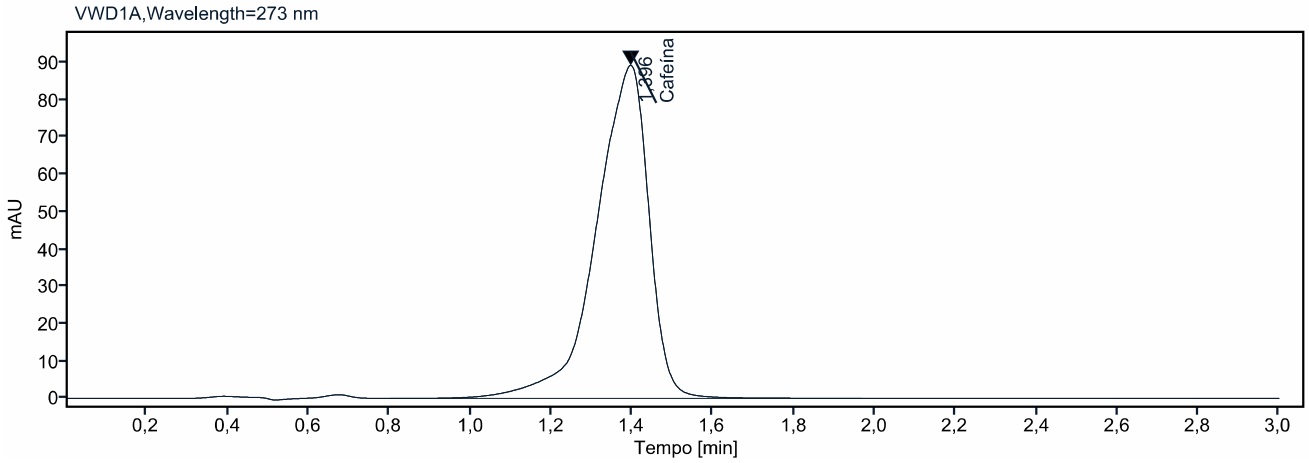


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,396	BB	1,1650	808,4281	89,3087	100,0000	Cafeína
		Soma	**808,4281**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-12-03-00.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A8
Data da injeção:	2022-08-30 12:10:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

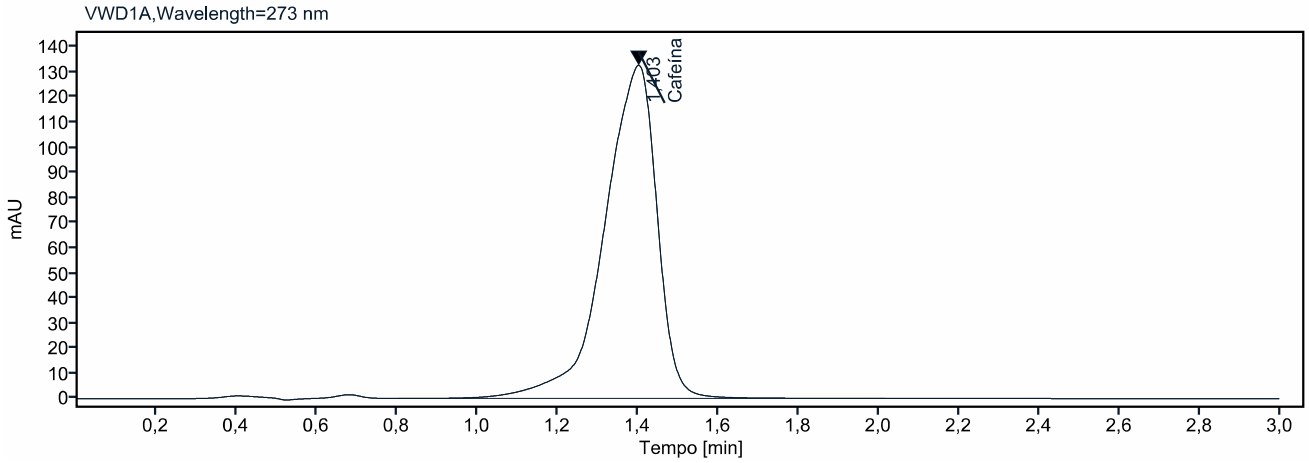


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,403	BB	1,2133	1212,1438	132,8514	100,0000	Cafeína
		Soma	**1212,1438**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 11-05-12-03-00.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A8
Data da injeção:	2022-08-30 12:14:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000
Método de análise:	Qualificação.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 10:55:39-03:00		

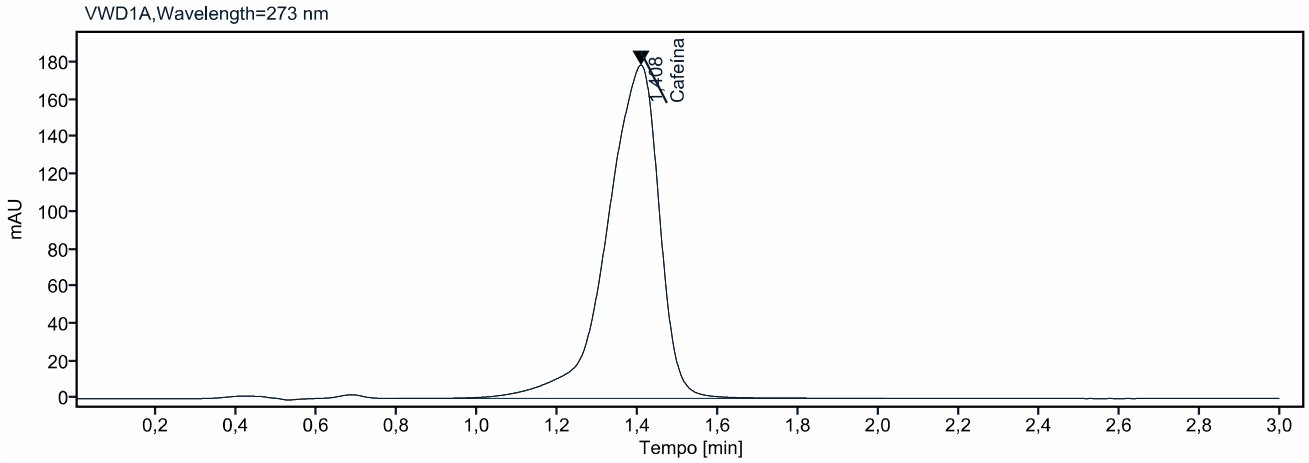


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,408	BB	1,2108	1616,0584	178,5731	100,0000	Cafeína
		Soma	**1616,0584**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 13-59-13-03-00.rslt\20220830 143103.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2022-08-30 14:31:44-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 15:12:09-03:00		

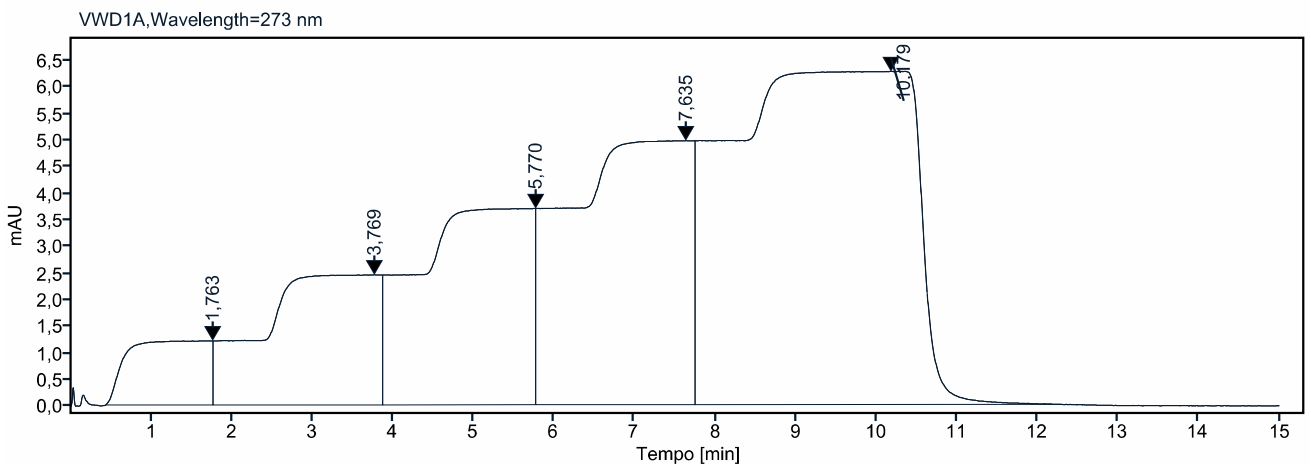


Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,763	MM m	1,3349	83,1879	1,2065	3,7375	
3,769	MM m	2,1071	246,1810	2,4430	11,0606	
5,770	MM m	1,8977	364,4813	3,6860	16,3757	
7,635	MM m	1,9762	523,6822	4,9575	23,5284	
10,179	MM m	4,5283	1008,2115	6,2552	45,2977	
		Soma	**2225,7438**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2022\PLC.002-A-2022-08-30 13-59-13-03-00.rslt\20220830 144648.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC_03	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2022-08-30 14:47:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-30 15:12:09-03:00		

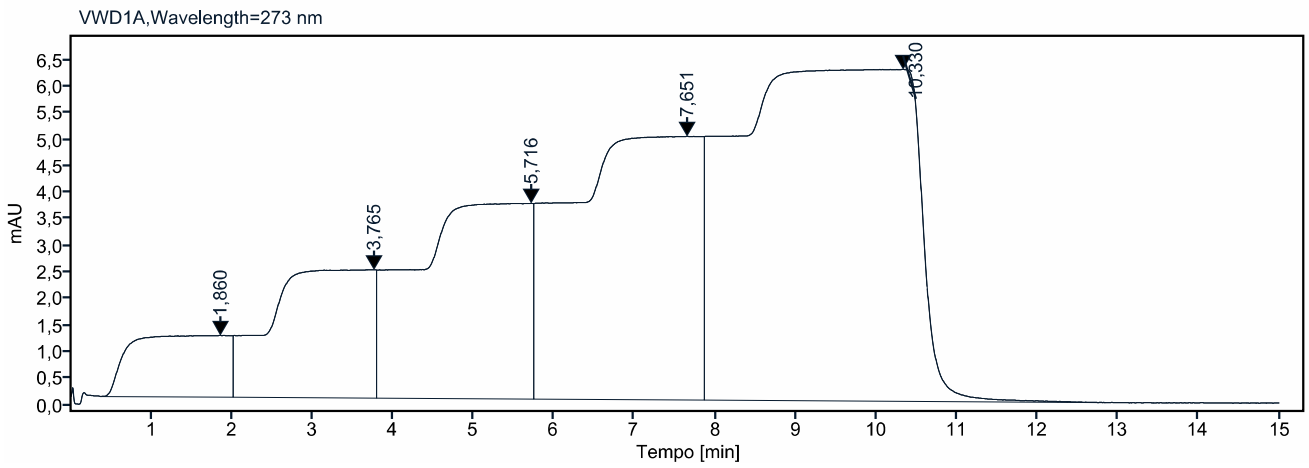

Sinal: VWD1A,Wavelength=273 nm

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,860	MM m	1,6359	96,2706	1,1624	4,3382	
3,765	MM m	1,7799	213,1279	2,4198	9,6040	
5,716	MM m	1,9500	369,0500	3,6896	16,6302	
7,651	MM m	2,1202	565,6852	4,9713	25,4910	
10,330	MM m	4,9733	975,0207	6,2580	43,9366	
		Soma	**2219,1543**			