
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 092120.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:22:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

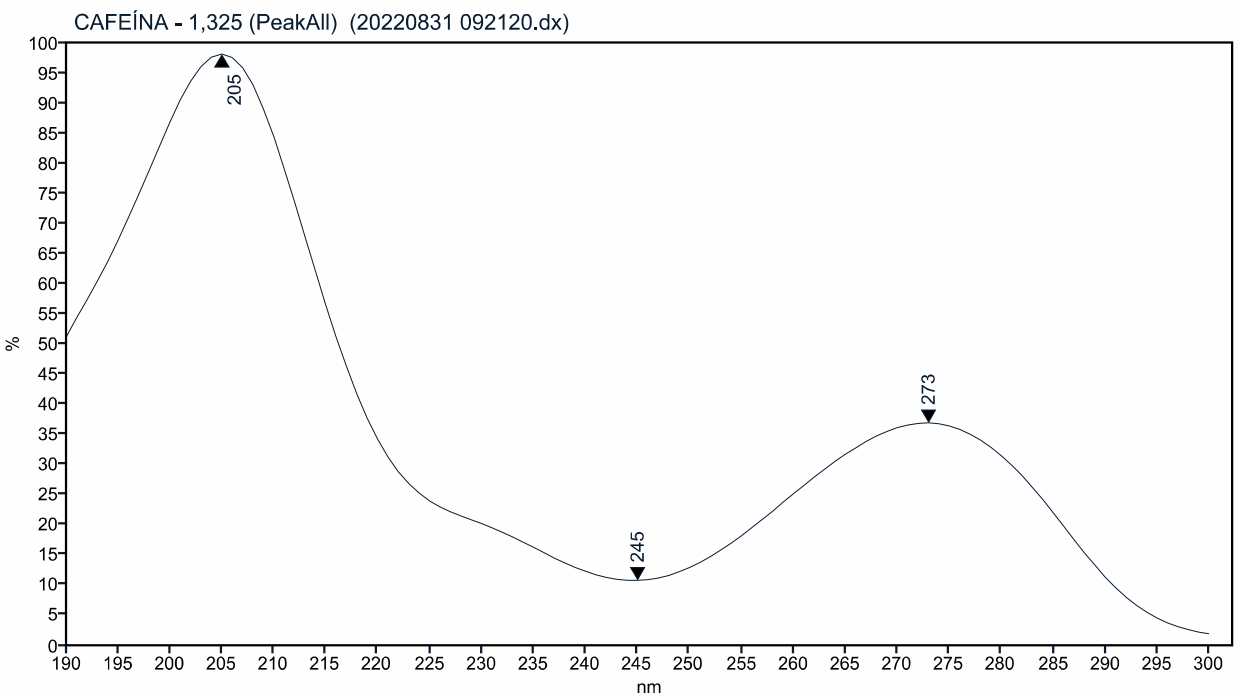

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 092520.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2022-08-31 09:26:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

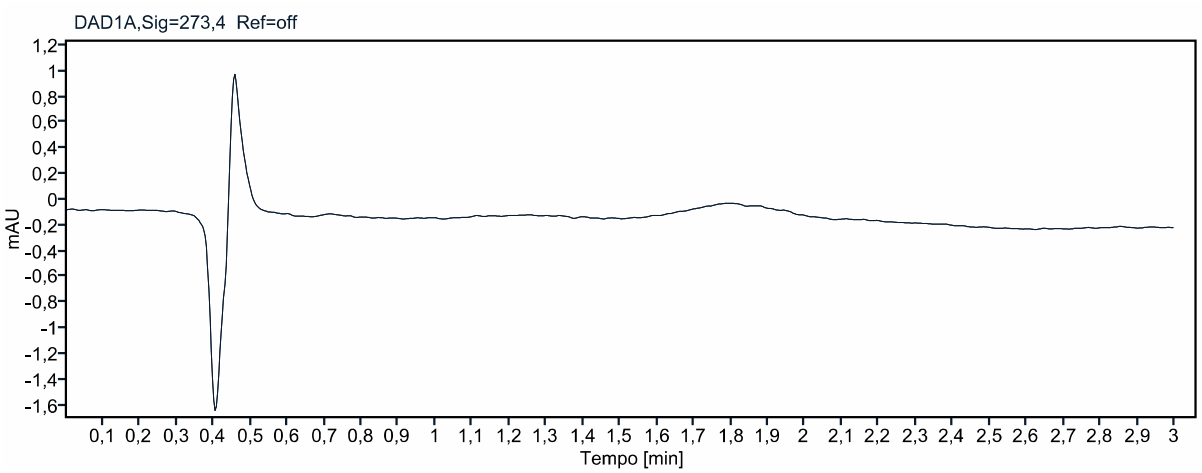

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 092922.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:30:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

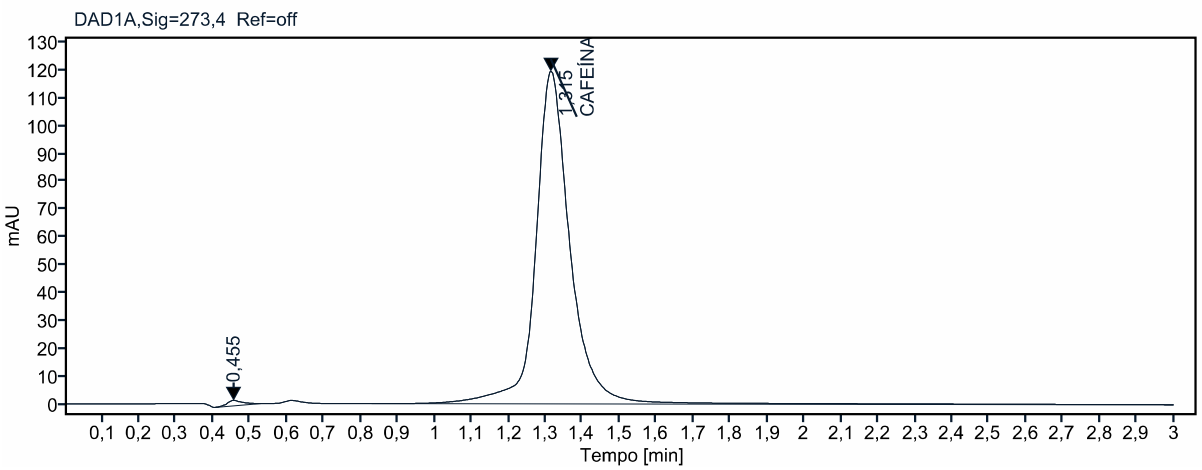


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,455	BB	0,1234	5,8318	1,9814	0,7411	
1,315	BBA	2,1700	781,0544	119,6484	99,2589	CAFEÍNA
		Soma	786,8862			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 093323.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:34:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

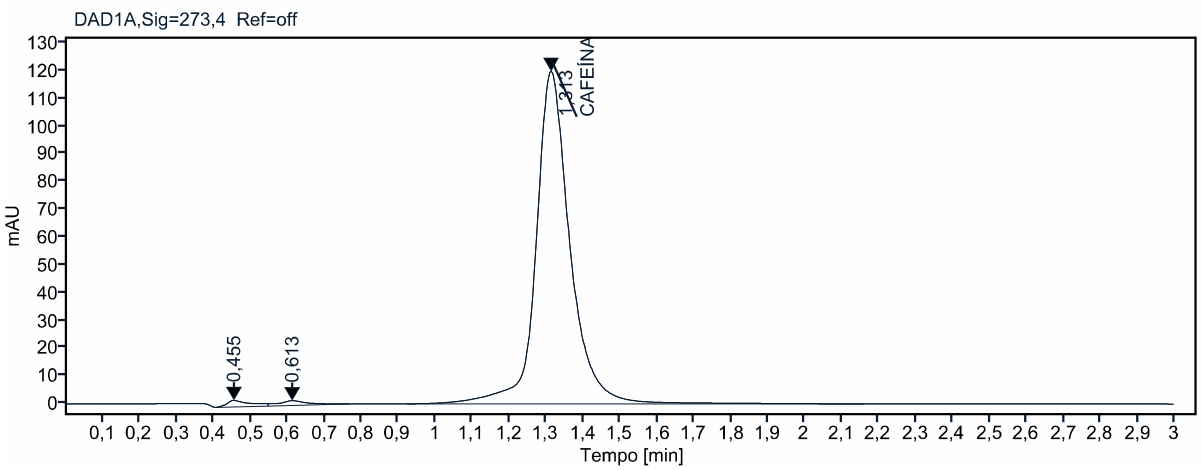


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,455	BV	0,1439	10,3113	2,3992	1,3103	
0,613	VB	0,2172	9,2606	1,7172	1,1767	
1,313	BB	1,2367	767,3946	119,7247	97,5130	CAFEÍNA
		Soma	786,9664			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 093723.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:38:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

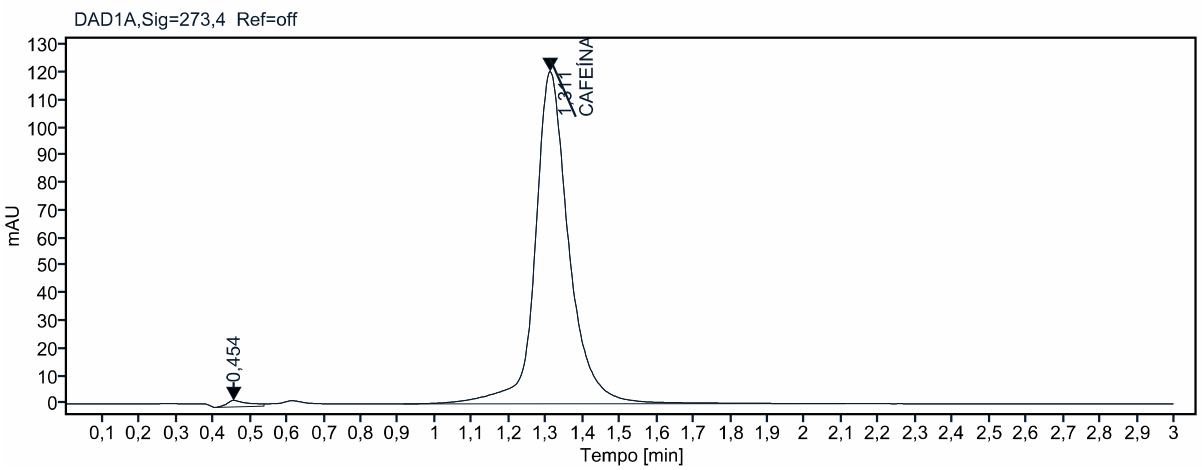


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,454	BV	0,1321	9,6025	2,3894	1,2371	
1,311	BB	1,1953	766,6245	120,5230	98,7629	CAFEÍNA
		Soma	776,2270			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 094122.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2022-08-31 09:42:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

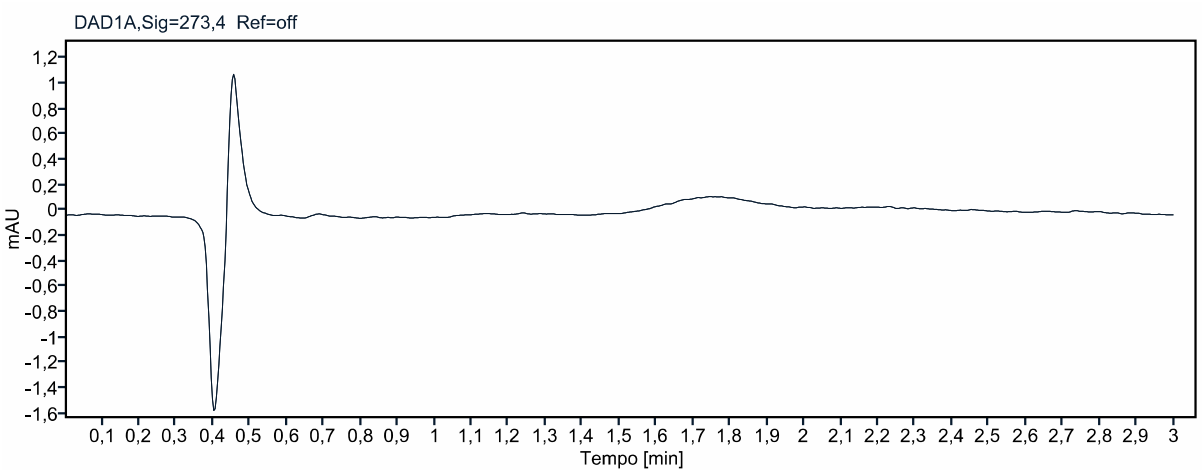

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 094523.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:46:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

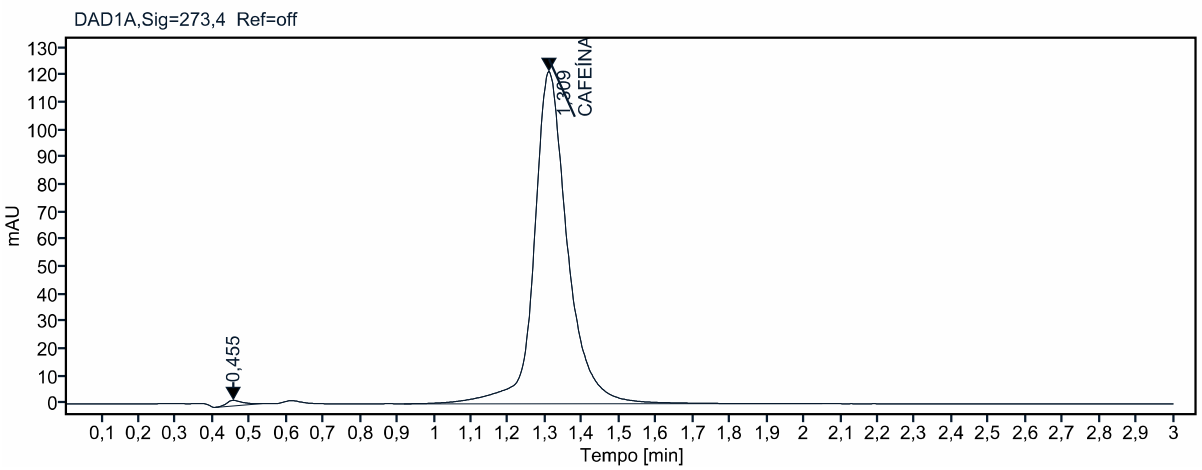


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,455	BB	0,1272	6,3103	2,0959	0,8176	
1,309	VB	1,1310	765,5077	121,4394	99,1824	CAFEÍNA
		Soma	771,8180			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 094923.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:50:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

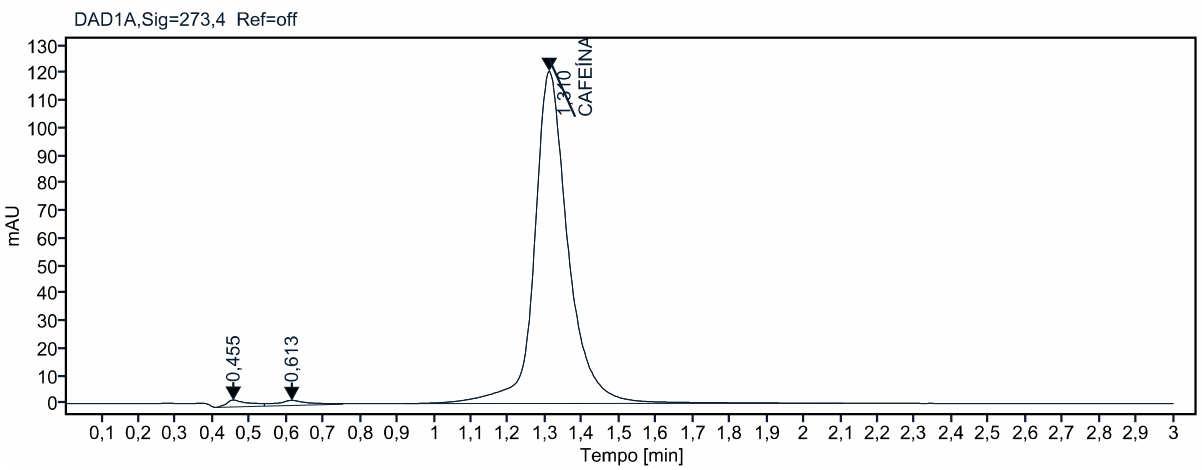


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,455	BV	0,1329	10,6900	2,5107	1,3532	
0,613	VV	0,2124	11,7354	1,8867	1,4855	
1,310	BB	1,1819	767,5673	120,8091	97,1613	CAFEÍNA
		Soma	789,9927			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 095323.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A2
Data da Injeção:	2022-08-31 09:54:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

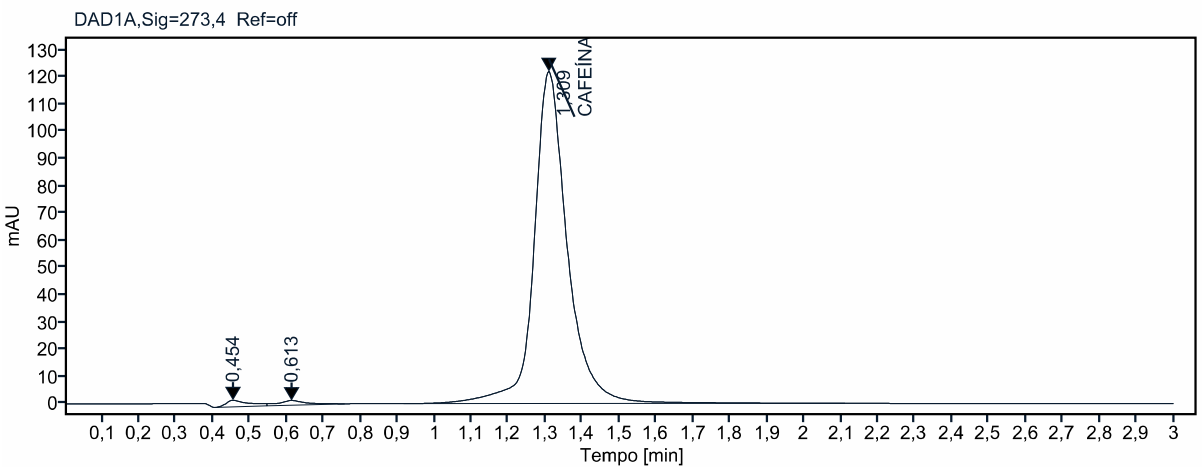


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,454	BV	0,1404	10,6285	2,4646	1,3520	
0,613	VB	0,2096	9,2553	1,7566	1,1773	
1,309	BB	1,1941	766,2419	122,0516	97,4707	CAFEÍNA
		Soma	786,1256			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-20-11-03-00.rslt\20220831 095723.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2022-08-31 09:58:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 10:38:16-03:00		

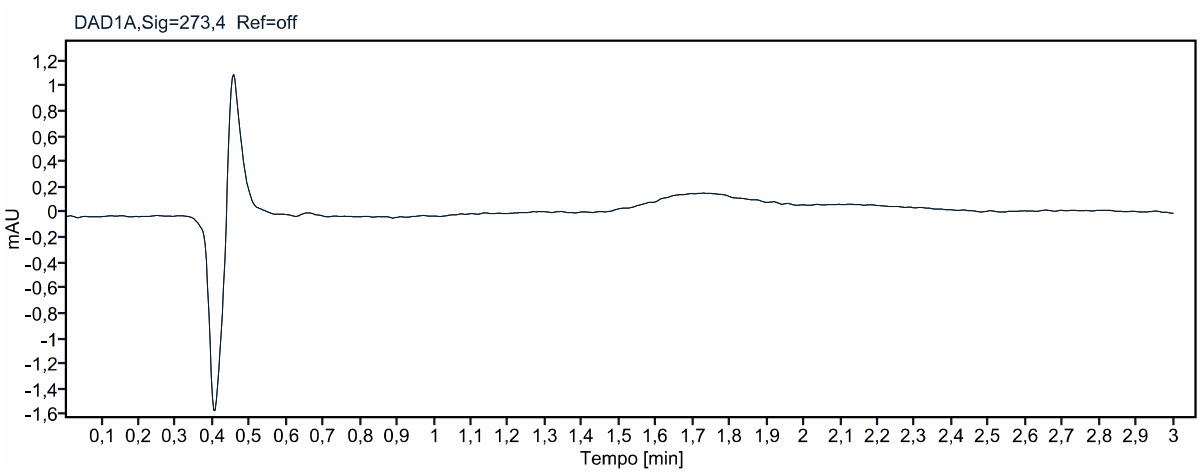

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-09-01 11-54-32-03-00.rslt\20220901 115441.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A3
Data da Injeção:	2022-09-01 11:56:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-09-01 13:05:32-03:00		

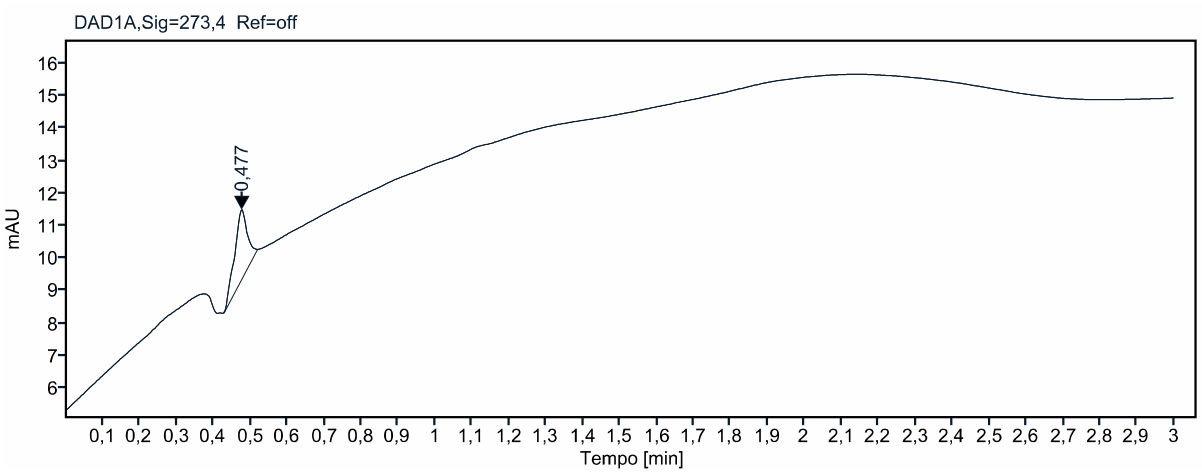


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,477	BB	0,0918	5,1667	2,1457	100,0000	
		Soma	5,1667			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-09-01 11-54-32-03-00.rslt\20220901 115913.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A4
Data da Injeção:	2022-09-01 12:00:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-09-01 13:05:32-03:00		

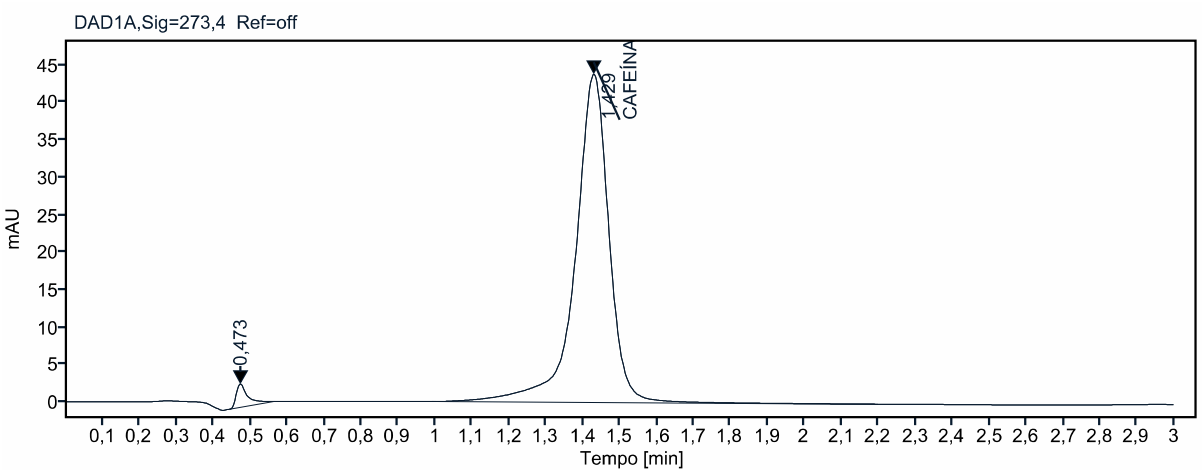


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,473	BB	0,1195	6,9617	3,1364	2,4384	
1,429	BB	1,2067	278,5431	43,8378	97,5616	CAFEÍNA
		Soma	285,5048			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-09-01 11-54-32-03-00.rslt\20220901 120320.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A5
Data da Injeção:	2022-09-01 12:04:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-09-01 13:05:32-03:00		

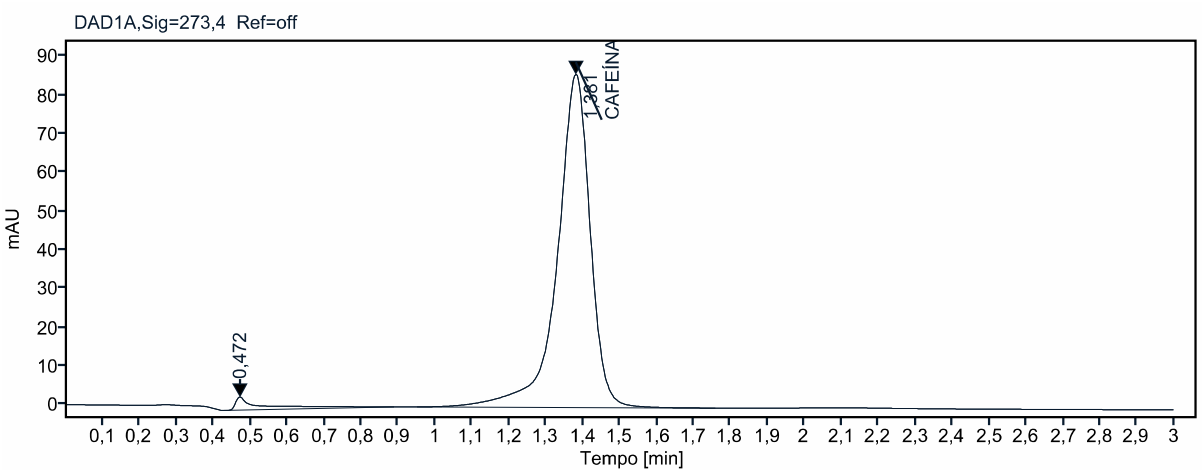


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,472	BB	0,4605	18,0034	3,3963	3,2578	
1,381	BB	0,8067	534,6248	86,1583	96,7422	CAFEÍNA
		Soma	552,6282			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-09-01 11-54-32-03-00.rslt\20220901 120724.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A6
Data da Injeção:	2022-09-01 12:08:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-09-01 13:05:32-03:00		

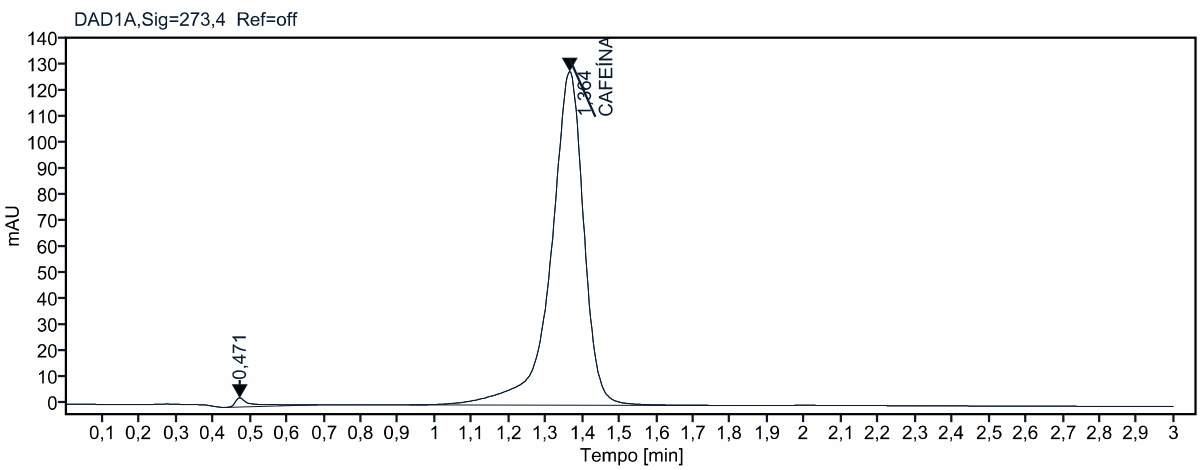


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,471	BB	0,2498	11,3834	3,5302	1,4147	
1,364	BB	0,8233	793,2508	128,3515	98,5853	CAFEÍNA
		Soma	804,6343			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-09-01 11-54-32-03-00.rslt\20220901 121126.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A7
Data da Injeção:	2022-09-01 12:12:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-09-01 13:05:32-03:00		

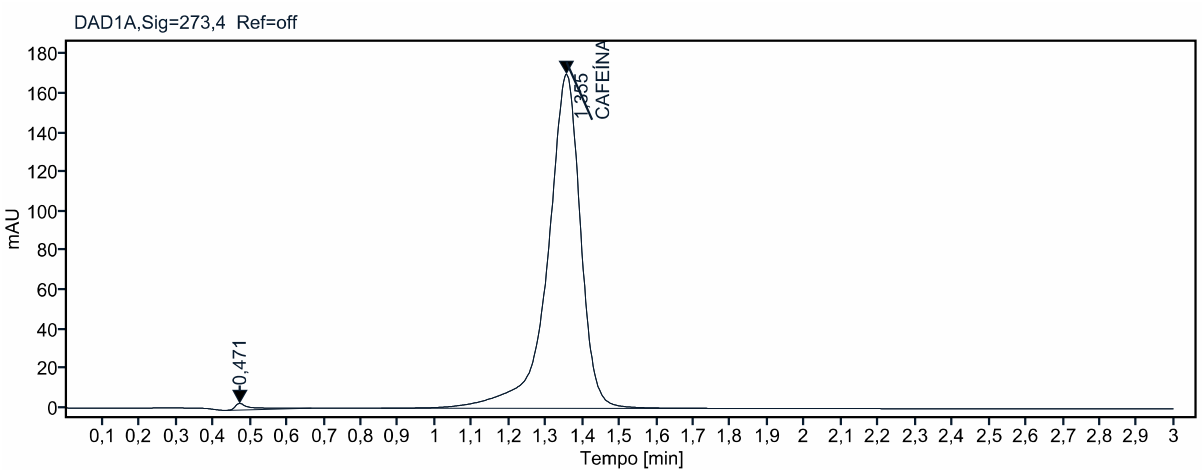


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,471	BB	0,2296	11,2721	3,3976	1,0563	
1,355	BB	0,9400	1055,8864	170,1944	98,9437	CAFEÍNA
		Soma	1067,1585			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-21-11-03-00.rslt\20220831 102133.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2022-08-31 10:22:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 11:01:42-03:00		

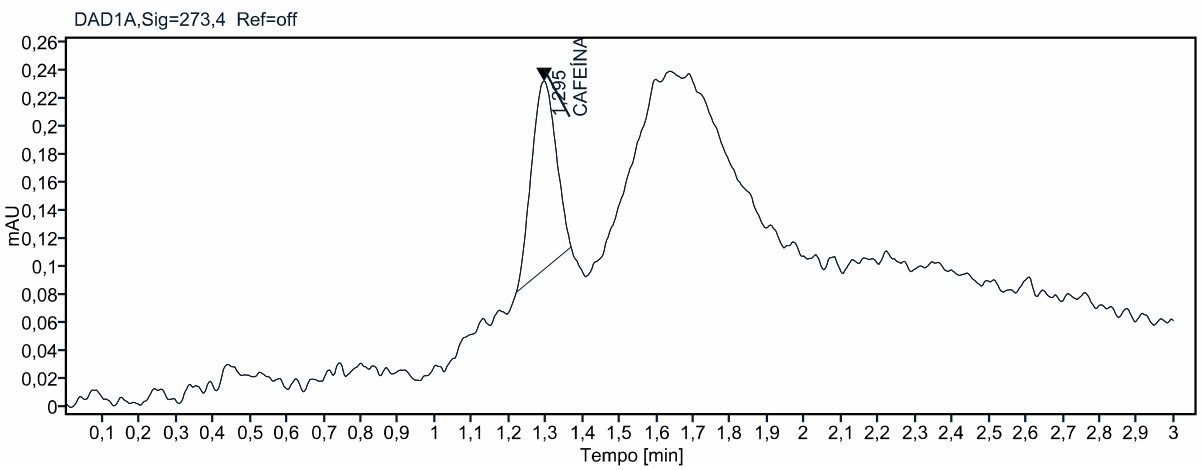


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,295	MM m	0,1479	0,6174	0,1339	100,0000	CAFEÍNA
		Soma	0,6174			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-21-11-03-00.rslt\20220831 102527.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2022-08-31 10:26:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 11:01:42-03:00		

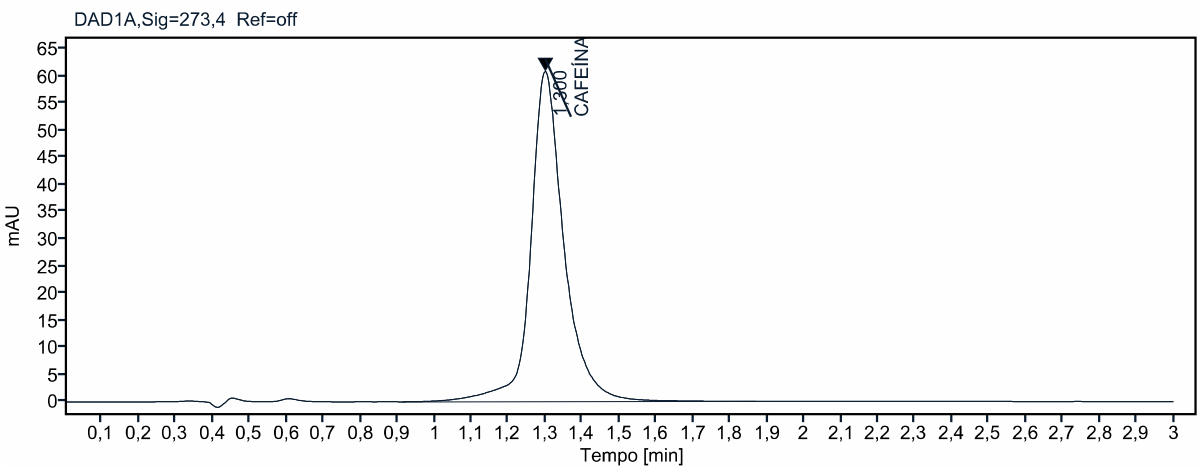


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,300	BB	0,9572	382,7192	60,8418	100,0000	CAFEÍNA
		Soma	382,7192			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-21-11-03-00.rslt\20220831 102921.dx
Nome da amostra:	LIIN 03
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-A8
Data da Injeção:	2022-08-31 10:30:14-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 11:01:42-03:00

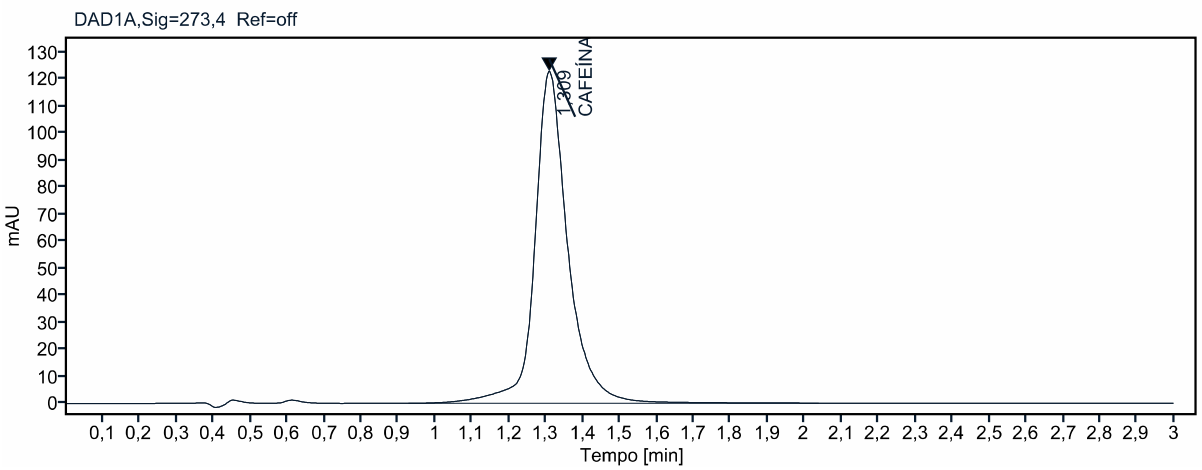


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,309	BB	1,1098	767,0901	122,8737	100,0000	CAFEÍNA
		Soma	767,0901			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-21-11-03-00.rslt\20220831 103318.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2022-08-31 10:34:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 11:01:42-03:00		

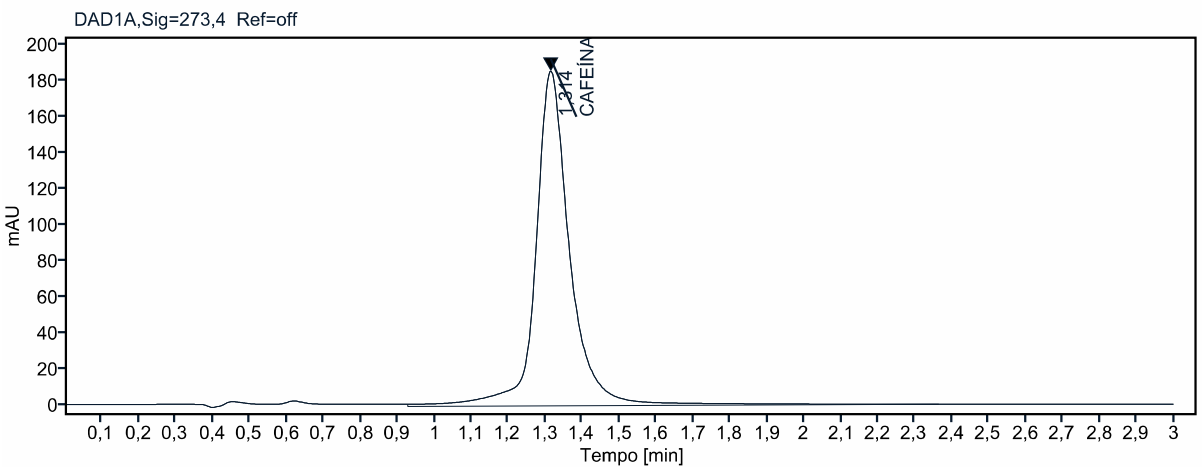


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,314	VB	1,4369	1207,2137	185,7593	100,0000	CAFEÍNA
		Soma	1207,2137			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 09-21-11-03-00.rslt\20220831 103717.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A8
Data da Injeção:	2022-08-31 10:38:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 11:01:42-03:00		

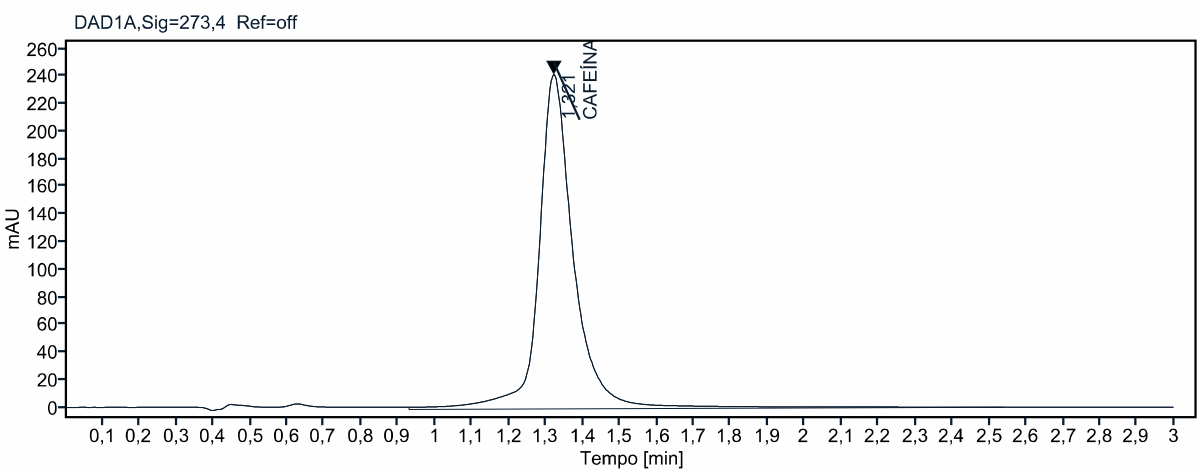


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,321	VB	1,6075	1620,5258	242,8842	100,0000	CAFEÍNA
		Soma	1620,5258			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 15-38-24-03-00.rslt\20220831 162022.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2022-08-31 16:21:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 17:22:03-03:00		

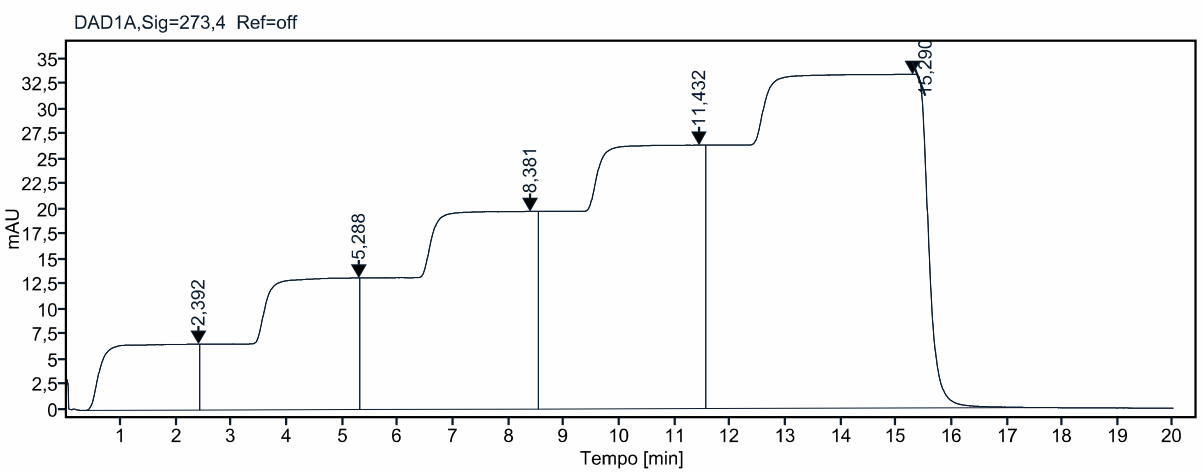


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,392	MM m	2,1268	712,6321	6,6002	3,9947	
5,288	MM m	2,8943	1808,4588	13,1670	10,1375	
8,381	MM m	3,2231	3306,5861	19,7700	18,5354	
11,432	MM m	3,0258	4355,4861	26,3541	24,4151	
15,290	MM m	6,2928	7656,1837	33,3570	42,9174	
		Soma	17839,3467			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2022-08-31 15-38-24-03-00.rslt\20220831 164119.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-A1
Data da Injeção:	2022-08-31 16:42:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-08-31 17:22:03-03:00		

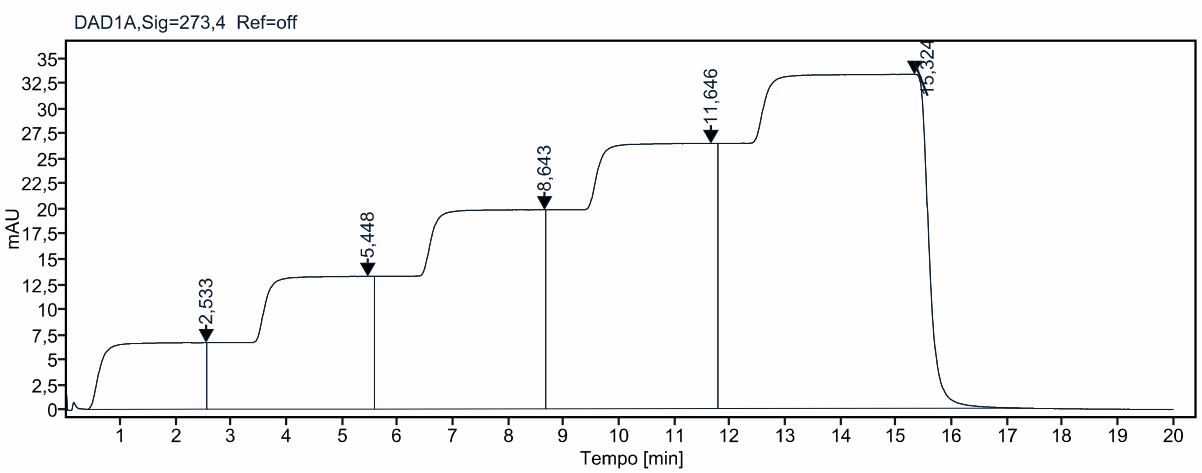

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
2,533	MM m	2,1707	768,4866	6,6489	4,2960	
5,448	MM m	3,0258	1979,0731	13,2357	11,0635	
8,643	MM m	3,0916	3267,8642	19,8491	18,2681	
11,646	MM m	3,1135	4560,8915	26,4333	25,4964	
15,324	MM m	5,4815	7312,0421	33,2893	40,8760	
		Soma	17888,3574			

Lab Advisor Diagnostic Result — 1260 Infinity II

G7117C — ASTM Drift and Noise Test — Passed

DEAEK04180
D.07.33[0003]
1260 DAD HS

The test performs ASTM drift and noise evaluation without reference.


Results

Started at 31/08/2022 10:52:53 by LABORATORIO\QPackSA on HPLC1 using Agilent Lab Advisor - Version B.02.11 [292] - Advanced

Item	Value	Result
Cell Product Number	G4212-60008	Done
Cell Name	Max-Light Cell	Done
Cell Type	10 mm/1 µl	Done
Lamp Type	Automatic Mode	Done
Accumulated UV Lamp Burn Time	5121,68 h	Done
UV Lamp On-Time	1,76 h	
Minimum Lamp On-Time	*1 h*	Passed
Signal Drift value at 254 nm (UV)	-0,028 mAU/h	
Maximum Allowed Drift	*-1 ... 1 mAU/h*	Passed
Signal Noise value at 254 nm (UV)	0,011 mAU	
Maximum Allowed Noise	*0 ... 0,02 mAU*	Passed

Finished at 31/08/2022 11:15:01

Signals

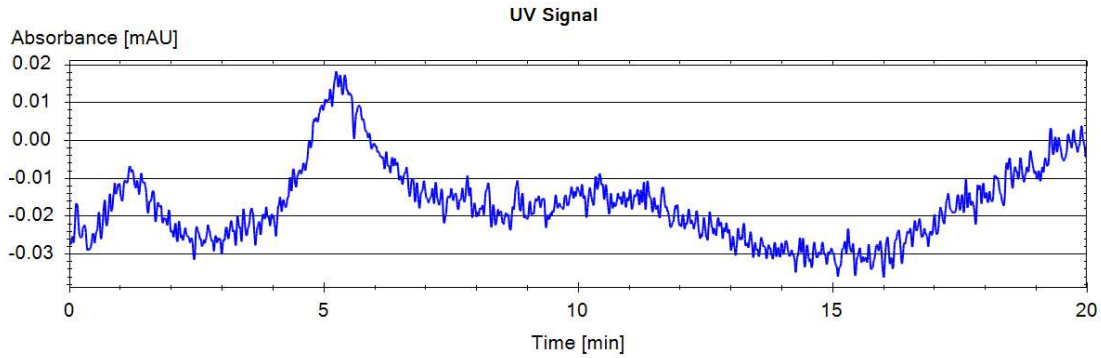

Signature: .....