PROTOCOLO DE QUALIFICAÇÃO

CERTIFICADO:	381/24

EMPRESA:	LABORATÓRIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMÉTICOS S/A
EQUIPAMENTO:	ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS
FABRICANTE:	AGILENT
MODELO:	CARY 60
TAG:	ESP.001-A
PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO:	28/08/2024 A 28/08/2024

CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO:	**381/24**
PERÍODO DA QUALIFICAÇÃO:	**28/08/2024** A **28/08/2024**

1. INTRODUÇÃO **3**
2. OBJETIVO **3**
3. SIGLAS E DEFINIÇÕES **3**
4. MODELO DE QUALIFICAÇÃO **4**
5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO **5**
6. TESTES ADICIONAIS **5**
7. DIREITOS RESERVADOS **5**
8. RESPONSABILIDADES **5**
8.1. CONTRATANTE 6
8.2. LAB PROVIDER 6
9. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS **6**
10. PRÉ-REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO **6**
11. PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS **7**
12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA **7**
13. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL **7**
13.1. DIRETRIZES DA REQUALIFICAÇÃO 8
14. PROCEDIMENTO INICIAL DA QUALIFICAÇÃO **8**
15. FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO **8**
16. CÁLCULOS **9**
16.1. MÉDIA 9
16.2. DESVIO PADRÃO 9
16.3. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO OU % DPR 10
16.4. % DESVIO 10
16.5. DESVIO 10
16.6. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO (R^2) 11
17. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS **11**
18. IDENTIFICAÇÕES **12**
18.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE 12
18.2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA 12
18.3. IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR 12
18.4. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO 13
18.5. IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS E ACESSÓRIOS 13
18.6. IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS OU MATERIAIS UTILIZADOS 13
19. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS **14**
19.1. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA 14
19.2. REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 14
19.3. RESOLUÇÃO 14
19.4. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 15
19.5. REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA 15

19.6. LINEARIDADE FOTOMÉTRICA 15
19.7. ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE 15
19.8. UNIFORMIDADE DA LINHA DE BASE 16
19.9. LUZ DIFUSA (STRAY LIGHT) 16

20. PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS 17
20.1. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA 17
20.2. REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 18
20.3. RESOLUÇÃO 19
20.4. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA 20
20.5. REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA 21
20.6. LINEARIDADE FOTOMÉTRICA 22
20.7. ESTABILIBADE DA LINHA DE BASE 23
20.8. UNIFORMIDADE DA LINHA DE BASE 24
20.9. LUZ DIFUSA (*STRAY LIGHT*) 25

21. RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DO UV-VIS 26

22. ASSINATURAS 27

23. HISTÓRICO DE REVISÕES 28

1. INTRODUÇÃO

Este protocolo foi elaborado para ser utilizado por indivíduos treinados, responsáveis por executar e revisar o conteúdo descrito nele, que verificará se o equipamento opera segundo suas especificações.

Dentro da indústria farmacêutica, alimentícia, laboratórios de prestação de serviços, entre outros, muitos equipamentos de laboratório, instrumentos, e sistemas analíticos computadorizados são utilizados. Estes sistemas são usados para a aquisição de dados e assegurar que os produtos estão adequados para os seus propósitos. Com o crescimento, a sofisticação e a automatização de instrumentos analíticos, há uma crescente demanda para qualificação desses sistemas a fim de assegurar a confiabilidade dos seus dados.

Quando todos os procedimentos são executados e todos os itens são aprovados na inspeção, isto garante que o sistema vai operar de acordo com as condições para a qual foi designado.

Este protocolo exige três tipos de pessoas:

- ✓ ***LAB PROVIDER***, especialista - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela ***BPF*** e ***BPL*** e os órgãos reguladores) para executar os procedimentos de ***QUALIFICAÇÃO*** desta documentação;

- ✓ ***LAB PROVIDER***, revisor - Pessoa treinada e qualificada (como definido pela ***BPF*** e ***BPL*** e os órgãos reguladores) para revisar e aprovar os testes realizados pelo especialista;

- ✓ ***CONTRATANTE***, um responsável treinado e qualificado (como definido pela ***BPF*** e ***BPL*** e os órgãos reguladores) para conferir e aprovar todos os testes realizados neste protocolo.

2. OBJETIVO

O objetivo deste protocolo é orientar sobre a estrutura, conceito e processo de ***QUALIFICAÇÃO*** para um ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***, seguindo os procedimentos de qualidade da ***LAB PROVIDER***.

3. SIGLAS E DEFINIÇÕES

ABREVIAÇÃO	*DESCRIÇÃO*
ASTM	*American Society for Testing and Materials*
BPF	Boas Práticas de Fabricação
BPL	Boas Práticas de Laboratório
EP	*European Pharmacopeia*

JP	*Japanese Pharmacopeia*
N/A	Não Aplicável
USP	*United States Pharmacopeia*
UV	Ultravioleta
Vis.	Visível
λ	Comprimento de Onda

4. MODELO DE QUALIFICAÇÃO

A documentação de ***QUALIFICAÇÃO*** da ***LAB PROVIDER*** baseia-se no modelo indicado na tabela abaixo.

Os princípios básicos de recomendações para ***QUALIFICAÇÃO*** estão de acordo com as diretrizes ***BPF*** e ***BPL*** atualmente aplicáveis. É recomendado a empresa ***CONTRATANTE*** realizar estas atividades de qualificação para todas as unidades instaladas no laboratório.

Requerimentos	*Verificação*
Durante o desenvolvimento do instrumento, todos os requerimentos devem ser atendidos.	***QD*** (Qualificação de Designer) - ***FABRICANTE***
O Sistema deve ser fabricado e testado de acordo com as especificações.	Protocolo de aceitação Interna - ***FABRICANTE***
O sistema deve ser instalado de acordo com as especificações do fabricante	***QI*** (Qualificação de instalação) - Empresa ***CONTRATADA***, quando contratado
Versão de *firmware*, ajustes e configurações são documentadas	*Logbook* de registro de atividades - Empresa ***CONTRATANTE*** / Empresa ***CONTRATADA***
O sistema cumpre os critérios de aceitação especificados	***QO*** (Qualificação Operacional) - Empresa ***CONTRATADA***
O usuário deverá ser treinado	Documentação de Treinamento - Empresa ***CONTRATADA***
Documentos escritos para o bom funcionamento devem estar presentes	Instruções de Operação - Empresa ***CONTRATANTE***
Execução de uma leitura de amostra da empresa ***CONTRATANTE*** de um método validado, para avaliação dos parâmetros de *System Suitability*	***QD*** (Qualificação de Desempenho) - Empresa ***CONTRATANTE***

5. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Os parâmetros estabelecidos neste protocolo são com base nas edições atuais da ***USP***, ***EP***, ***JP*** e ***ASTM***, que formam a base para a aceitação da ***QUALIFICAÇÃO***. Para os parâmetros que não estão especificados na ***USP***, ***EP***, ***JP*** e ***ASTM***, foram seguidos os limites propostos pelo fabricante do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***.

Caso haja necessidade de mudança para qualquer teste ou limite diferente dos propostos neste protocolo, a alteração deverá ser solicitada ao especialista antes do início do serviço. ***A LAB PROVIDER*** reserva-se o direito de garantir a conformidade apenas com a variância originalmente proposta nos testes. As personalizações de limites dos testes podem sujeitar o sistema a limites que excedem o intervalo operacional típico. Estas alterações serão aplicadas ao protocolo, porém, com uma notificação que irá refletir esta situação.

No caso de uma reprovação do teste, os resultados fora de especificação deverão ser anexados neste protocolo, além da entrada de uma justificativa do especialista indicando as causas da reprovação no documento Ordem de Serviço, e se existe a necessidade de uma ação corretiva.

Estas informações serão associadas, e disponibilizadas ao cliente para rastreabilidade do processo no site: cliente.labprovider.com.br

Obs.: A ***LAB PROVIDER*** não será responsável por falhas de teste para limites com faixa mais estreita (mais exigentes ou desafiadores) do que os valores recomendados.

6. TESTES ADICIONAIS

Testes adicionais que não são considerados parte da programação necessária para a conclusão do serviço contratado, deverão ser avaliados, e se for compatível com os padrões e documentos, serão cobrados os custos adicionais ao serviço inicialmente contratado.

7. DIREITOS RESERVADOS

Este protocolo, desenvolvido por meio do Núcleo de Suporte Técnico da ***LAB PROVIDER***, é totalmente protegido por direitos autorais e não pode ser utilizado ou reproduzido sem a concordância e autorização prévia dos detentores dos direitos.

As informações e procedimentos contidos neste protocolo estão sujeitas a mudanças sem notificação prévia, estando relacionadas especialmente com as definições dos órgãos competentes, não cabendo assim, nenhum tipo de responsabilidade para a ***LAB PROVIDER***.

8. RESPONSABILIDADES

A ***QUALIFICAÇÃO*** deste equipamento será realizada levando-se em consideração as condições externas (fatores como posição do instrumento, temperatura ambiente, umidade relativa, rede elétrica, nível de bancada, entre outros), as quais podem afetar o desempenho do equipamento. Assim sendo, não nos responsabilizamos por eventuais mudanças que venham a ocorrer nestas condições de instalação após a execução do serviço.

8.1. CONTRATANTE

- ✓ Aprovar os parâmetros e limites estipulados neste protocolo, antes da execução da ***QUALIFICAÇÃO*** do instrumento;
- ✓ A empresa ***CONTRATANTE*** se responsabiliza em prover boas condições para a realização do serviço, tais como temperatura controlada, rede elétrica estabilizada, espaço físico suficiente para realização do serviço, vidrarias, solventes diversos, reagentes, assim como local apropriado para o descarte deles;
- ✓ Conferir a etiqueta de ***QUALIFICAÇÃO*** do equipamento que será entregue no dia do encerramento do serviço;
- ✓ Conferir e assinar a Ordem de Serviço em formato eletrônico, do trabalho realizado;
- ✓ A empresa ***CONTRATANTE*** se responsabiliza por conferir e aprovar todo o protocolo entregue, aceitando assim, a ***QUALIFICAÇÃO*** do equipamento fornecida pela ***LAB PROVIDER***.

8.2. LAB PROVIDER

Enviar um especialista treinado e qualificado para executar todos os procedimentos de qualificação;

- ✓ Prover a cada especialista, um kit de ***QUALIFICAÇÃO*** adequado para execução do serviço, compatível com qualquer configuração de ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** disponível;
- ✓ Realizar a manutenção preventiva do instrumento antes da ***QUALIFICAÇÃO*** dele, ***QUANDO CONTRATADA***;
- ✓ Preencher a Ordem de Serviço com desvios e recomendações para resolução de problemas quando aplicável;
- ✓ Fornecer o certificado de ***QUALIFICAÇÃO*** ou de análise comprovando que os padrões e soluções de referência estão dentro da validade;
- ✓ Entregar para contratante todo protocolo pertinente à execução do serviço, e relatório final de ***QUALIFICAÇÃO***.

9. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ *Calibration Standard Kit*;
- ✓ Padrão de Luz Difusa (*Stray Light).*

10. PRÉ-REQUISITOS PARA A QUALIFICAÇÃO

Para completar o procedimento de ***QUALIFICAÇÃO*** mencionados neste protocolo, é necessário certificar-se de ter os itens abaixo disponíveis para consulta:

- ✓ A especificação completa do instrumento a ser qualificado;
- ✓ Configuração do *software* de controle e aquisição de dados (se aplicável);
- ✓ Os manuais de operação do instrumento.

11. PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS

O especialista e o revisor devem usar as seguintes diretrizes para o preenchimento do protocolo:

- ✓ Todos os itens dos formulários devem ser preenchidos (exceto o campo comentários que é opcional);
- ✓ As colunas de resultado devem ser preenchidas exclusivamente com: "***APROVADO***", "***REPROVADO***" ou "***N/A***";
- ✓ Quando o valor ou campo não for aplicável ao modelo do equipamento, ou a função testada for inexistente, o campo deve ser riscado com uma linha diagonal da esquerda superior para a direita inferior. Caso a tabela tenha mais de quatro campos não aplicáveis, utilize a linha diagonal em todos eles. Se houver quatro ou menos campos não aplicáveis, preencha-os com "***N/A***";
- ✓ Todas as datas deverão ser preenchidas no formato ***DD/MM/AAAA***;
- ✓ Qualquer desvio a partir de um procedimento definido no protocolo e/ou resultados obtidos onde medidas corretivas forem necessárias, estas devem ser documentados no adendo "***LISTA DE DESVIOS***", o responsável pelo instrumento tem que dar aprovação documentada com seu aceite para qualquer adequação ou divergência no protocolo antes das assinaturas de aprovações finais. O teste em questão deverá ser novamente executado e anexado ao protocolo numerando a página conforme a página do teste que falhou, seguido de letras em ordem alfabética (ex.: página 12A, página 12B etc.);
- ✓ Todos os resultados, espectros, evidências, relatórios e certificados de treinamento e dos padrões devem ser anexados ao final deste protocolo, e entregues a contratante.

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Tem como objetivo assegurar que o equipamento esteja em boas condições e que possa ser operado com segurança dentro da rotina do laboratório.

Este procedimento torna-se de vital importância no processo de ***QUALIFICAÇÃO***, pois o sistema será verificado em seus pontos críticos, sofrendo ajustes quando necessário, e/ou substituição de peças de desgaste natural.

13. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

Seguindo corretamente os procedimentos de ***QUALIFICAÇÃO*** do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** descritos nesta documentação, os resultados obtidos assegurarão propriamente a ***QUALIFICAÇÃO*** e manutenção deste equipamento.

Informações coletadas durante o processo de ***QUALIFICAÇÃO*** deverão ser escritas nos formulários que oferecerão evidências para os órgãos regulatórios de que o ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** opera adequadamente.

13.1. DIRETRIZES DA REQUALIFICAÇÃO

É sugerido que o responsável do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** siga estas diretrizes para determinar quando é necessário realizar a ***REQUALIFICAÇÃO***:

- ✓ A periodicidade da ***REQUALIFICAÇÃO*** deverá ser definida pelo ***CONTRATANTE***, baseando-se na frequência do uso, desgaste de lâmpadas, unidade óptica, e/ou procedimentos internos;
- ✓ Quando o equipamento for transferido do local onde foi ***QUALIFICADO***;
- ✓ Deve-se sempre ***REQUALIFICAR*** após a substituição de componentes ou peças de maior importância como:
  - ➢ placas de controle;
  - ➢ placas de interface;
  - ➢ placas amplificadoras;
  - ➢ lâmpadas e peças da parte óptica;
- ✓ É importante ***REQUALIFICAR*** sempre que adicionar um acessório ou realizar alguma modificação/atualização do *hardware* ou *software*.

14. PROCEDIMENTO INICIAL DA QUALIFICAÇÃO

Antes de iniciar a ***QUALIFICAÇÃO*** operacional, certifique-se de que o especialista e o revisor tenham lido e entendido todas as partes deste documento de ***QUALIFICAÇÃO***. As páginas anteriores detalham os procedimentos de preenchimentos dos formulários.

Após completar cada procedimento de ***QUALIFICAÇÃO***, o especialista deve registrar todos os resultados obtidos no formulário correspondente.

Se o especialista não completar corretamente um procedimento desta documentação de ***QUALIFICAÇÃO***, ele não deverá continuar os testes até que o problema seja resolvido.

O especialista deverá documentar que ação foi tomada para corrigir o problema na seção de comentários do formulário correspondente.

Quando for executar os testes de ***QUALIFICAÇÃO***, o especialista deve seguir as ***BPL*** todo o tempo. Sempre usar óculos de segurança e roupas adequadas e tomar cuidado quando for manipular solventes.

15. FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Será utilizada uma etiqueta de identificação para o instrumento, que deverá ser totalmente preenchida, obedecendo os procedimentos abaixo mencionados:

- ✓ Deverá ser preenchido o ***NÚMERO DO CERTIFICADO***;
- ✓ O ***MODELO*** do equipamento;
- ✓ ***NÚMERO DE SÉRIE*** do equipamento ou ***TAG***;
- ✓ Quem executou o serviço;
- ✓ Tipo de serviço realizado;
- ✓ A data atual da conclusão no formato ***DD/MM/AA***;
- ✓ Para o campo ***PRÓXIMA DATA*** consulte o responsável do laboratório contratante, pois cada ***CONTRATADA*** tem um cronograma definido que estipula a periodicidade dos serviços de qualificação.



Atenção: O local de colagem da etiqueta deverá ser de fácil visualização, e colada preferencialmente no módulo definido pelo cliente.

16. CÁLCULOS

Esta seção inclui todos os cálculos e fórmulas para todos os testes disponíveis. Dependendo dos testes que foram executados na ***QUALIFICAÇÃO***, apenas os cálculos pertinentes a eles serão aplicados.

16.1. MÉDIA

A média aritmética simples é obtida dividindo-se a soma das observações pelo número delas. É um quociente geralmente representado pelo símbolo $\overline{X}$. Se tivermos uma série de n valores de uma variável x, a média aritmética simples será determinada pela expressão:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_{med\ i}}{n}$$

Onde:

$X_{med\ i}$ = *Valor amostral, leitura i-ésimo de n*

n = *Número total de leituras amostrais*

16.2. DESVIO PADRÃO

O desvio padrão é uma medida de dispersão e o seu valor reflete a variabilidade das observações em relação à média.

A dispersão das observações que constituem uma amostra pode ser caracterizada pelos desvios de cada observação em relação à média, podendo tomar valores positivos ou negativos, e o somatório dos desvios de cada observação em relação à média amostral é zero. Contudo, os desvios ao quadrado, tomam sempre um valor positivo, e a respectiva média é a variância da amostra. Se existir uma grande dispersão das observações a variância é grande. Se os valores de cada uma das observações forem próximos da média a variância é pequena. O cálculo de desvio padrão será determinado pela expressão:

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - X_{med})^2}{n-1}}$$

Onde:

X *i* = Valor Amostral, leitura i-ésimo de n

X *med* = Valor médio amostral para n valores

n = Número total de leituras amostrais

16.3. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO OU % DPR

O coeficiente de variação (C.V.) ou %DPR é uma medida de dispersão relativa, pois expressa a relação percentual do desvio padrão em relação à média.

É visto que o conceito estatístico de desvio padrão corresponde ao conceito matemático de distância, ou seja, a dispersão dos dados em relação à média de uma sequência. É chamado de dispersão absoluta o desvio padrão, e de dispersão relativa o coeficiente de variação que é a divisão entre o desvio padrão e a média. Assim o cálculo será determinado pela expressão:

$$CV\ ou\ \%\ DPR = \frac{DP\ x\ 100}{Média}$$

Onde:

DP = Desvio padrão para n valores

Média = Valor médio amostral para n valores

16.4. % DESVIO

A razão da % de desvio é calculada como a diferença absoluta entre a resposta normalizada e a resposta nominal, pela resposta nominal máxima determinada em porcentagem, conforme expressão abaixo:

$$\%\ Desvio = \frac{\left(|\ X_{norm_i} - X_{nom_i}\ |\right)}{X_{nom_{max}}} x\ 100$$

Onde:

Xnorm i = Valor da leitura normalizado no ponto indicado

Xnom i = Valor da leitura nominal no ponto indicado

Xnom max = Valor da leitura no ponto máximo

16.5. DESVIO

O Desvio é avaliado pela diferença absoluta entre o valor programado e a leitura obtida, conforme expressão abaixo:

$$\boldsymbol{Desvio} = \left(|\ \boldsymbol{X_{leit}} - \boldsymbol{X_{progr}}\ |\right)$$

Onde:

Xleit = Valor da leitura para X

Xprogr = Valor programado para X

16.6. COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO (R^2)

O coeficiente de determinação, também chamado de R^2, é uma medida de ajustamento de um modelo estatístico linear generalizado, como a regressão linear, em relação aos valores observados. O R^2 varia entre 0 e 1 indicando, em porcentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R^2, mais explicativo é o modelo, melhor ele se ajusta à amostra.

Assim o cálculo será determinado pela expressão:

$$R^2 = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum X)^2) \; x \; (n\sum y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Onde:

X = Valores de x

Y = Valores de Y

n = Número dos pares de observação

17. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

NORMA ABNT NBR ISO 9001:2008 – SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - REQUISITOS.

NORMA ABNT NBR ISO 17025:2005 – REQUISITOS GERAIS PARA A COMPETÊNCIA DE LABORATÓRIOS DE ENSAIO E CALIBRAÇÃO.

ASTM – AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIAL, VOL. 03.06 (OCTOBER 2011).

USP – THE UNITED STATES PHARMACOPEIA, EDITION 43 (2022) <857> ULTRAVIOLET-VISIBLE SPECTROSCOPY.

EP – EUROPEAN PHARMACOPEIA, EDITION 11 (2023) <2.2.25> ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY ULTRAVIOLET AND VISIBLE.

EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OR MEDICINES & HEALTHCARE – OMCL NETWORK OF THE COUNCIL OF EUROPE.

VAM – VALID ANALYTICAL MEASUREMENT.

CVG – CALIBRATION AND VALIDATION GROUP.

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MANUAL DE BOAS PRÁTICAS EM BIODISPONIBILIDADE / BIOEQUIVALÊNCIA. VOLUME II – MÓDULO 3: INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA <6.3.2> QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO.

BPL – BOAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO.

BPF – BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

18. IDENTIFICAÇÕES

18.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE	
EMPRESA:	**LABORATÓRIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMÉTICOS S/A**
ENDEREÇO:	**AVENIDA SAGRADA FAMÍLIA, 2924, ANEXO I, JOSÉ ALCEBIADES OLIVEIRA, SANTO ÂNGELO/RS - CEP: 98805-678**
CONTATO DO DEPARTAMENTO:	**CLAUDIA HAHN**

18.2. IDENTIFICAÇÃO DO ESPECIALISTA	
ESPECIALISTA:	**MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**
FUNÇÃO:	**ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO**
EMPRESA:	**LAB PROVIDER**

18.3. IDENTIFICAÇÃO DO REVISOR	
REVISOR:	**FABÍOLA SPIGARIOL**
FUNÇÃO:	**DOCUMENTAÇÃO**
EMPRESA:	**LAB PROVIDER**

18.4. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO

EQUIPAMENTO:	**ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS**
MODELO:	**CARY 60**
NÚMERO DE SERIE:	**MY19209209**
SOFTWARE:	**CARY WINUV**
VERSÃO/ FIRMWARE:	**5.1.0.1016**
TAG:	**ESP.001-A**
LOCAL INSTALADO:	**CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO**

18.5. IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS E ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO / MODELO	NÚMERO DE SÉRIE	FABRICANTE
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

18.6. IDENTIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS OU MATERIAIS UTILIZADOS

INSTRUMENTO OU MATERIAL UTILIZADO	TAG OU NÚMERO DE SÉRIE	DATA DA ÚLTIMA CALIBRAÇÃO	DATA DA PRÓXIMA CALIBRAÇÃO	Nº DO CERTIFICADO	ANEXO
CALIBRATION STANDARD KIT	**KUV 02**	**21/05/2024**	**30/05/2029**	**1002190 Rev.02**	A1
STRAY LIGHT	**311E2422**	**22/05/2024**	**22/05/2025**	**PD20.STRL.01**	A2
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	A3

ATUALIZAR

19. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

19.1. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA

DEFINIÇÃO: A exatidão do comprimento de onda refere-se à capacidade do espectrofotômetro de medir corretamente o comprimento de onda desejado. É fundamental para garantir que as medições ocorram na faixa espectral correta, especialmente quando se lida com compostos que apresentam picos de absorção estreitos e definidos.

IMPORTÂNCIA: Uma exatidão inadequada no comprimento de onda pode levar a erros significativos nas medições de absorbância, impactando a identificação e quantificação de substâncias. Isso é crucial para aplicações que exigem precisão rigorosa, como a análise de fármacos e componentes bioquímicos.

POSIÇÃO ESPERADA (nm)	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)
279.0	≤ **1.00**
360.9	≤ **1.00**
453.6	≤ **1.00**
637.6	≤ **1.00**

19.2. REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA

DEFINIÇÃO: A repetibilidade do comprimento de onda é a capacidade do espectrofotômetro de reproduzir consistentemente o mesmo comprimento de onda em medições consecutivas, sob as mesmas condições experimentais.

IMPORTÂNCIA: A repetibilidade é crucial para garantir que o espectrofotômetro ofereça resultados consistentes ao longo do tempo, minimizando variações que poderiam comprometer a qualidade dos dados analíticos.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)
≤ **0.10**

19.3. RESOLUÇÃO

DEFINIÇÃO: A resolução do espectrofotômetro é a sua capacidade de distinguir entre dois picos de absorção próximos. A alta resolução é necessária para separar picos que estão próximos um do outro em amostras complexas.

IMPORTÂNCIA: A resolução adequada é essencial para análises que envolvem misturas complexas, onde diferentes substâncias podem ter comprimentos de onda de absorção muito próximos. Uma resolução inadequada pode resultar na sobreposição de picos, prejudicando a precisão da análise.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)
Para largura de banda de **1.5** nm ≤ **2.80** nm

19.4. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA

DEFINIÇÃO: A exatidão fotométrica refere-se à precisão com que o espectrofotômetro mede a absorbância ou transmitância de uma amostra. Este parâmetro é crítico para garantir que as medições de concentração baseadas na absorbância sejam precisas.

IMPORTÂNCIA: Erros na exatidão fotométrica podem resultar em quantificações incorretas de concentrações, especialmente em métodos que dependem da Lei de Beer-Lambert para calcular a concentração com base na absorbância.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)
≤ **0.0100**

19.5. REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA

DEFINIÇÃO: A repetibilidade fotométrica é a capacidade do espectrofotômetro de fornecer valores de absorbância consistentes para a mesma amostra em medições repetidas sob condições idênticas.

IMPORTÂNCIA: A repetibilidade é fundamental para garantir a confiabilidade dos resultados em experimentos onde a mesma amostra é medida várias vezes, assegurando que as variações são mínimas e atribuíveis apenas ao equipamento.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)
≤ **0.0020**

19.6. LINEARIDADE FOTOMÉTRICA

DEFINIÇÃO: A linearidade fotométrica é a capacidade do espectrofotômetro de fornecer uma resposta proporcional à concentração de analito em um intervalo de concentração especificado, obedecendo à Lei de Beer-Lambert

IMPORTÂNCIA: A linearidade fotométrica é crítica para garantir que os cálculos de concentração baseados na absorbância sejam precisos e reprodutíveis, especialmente em métodos quantitativos.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)
R^2≥ 0.99900 .

19.7. ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE

DEFINIÇÃO: A estabilidade da linha de base é a capacidade do espectrofotômetro de manter um sinal de base consistente sem flutuações significativas durante um período de 900 seg.

IMPORTÂNCIA: A estabilidade da linha de base é crucial para assegurar que medições prolongadas não sejam afetadas por desvios no sinal de base, que podem introduzir erros sistemáticos nas análises.
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)
≤ **0.00500**
19.8. UNIFORMIDADE DA LINHA DE BASE
DEFINIÇÃO: A uniformidade da linha de base refere-se à capacidade do espectrofotômetro de manter a linha de base uniforme em toda a faixa de comprimento de onda utilizada para as medições.
IMPORTÂNCIA: A uniformidade da linha de base é essencial para garantir que as leituras de absorbância sejam consistentes em diferentes comprimentos de onda, especialmente ao escanear espectros completos.
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)
≤ **0.00500**
19.9. LUZ DIFUSA (STRAY LIGHT)
DEFINIÇÃO: A luz difusa refere-se à luz que atinge o detector fora da faixa de comprimento de onda de interesse, causando interferências e leituras incorretas de absorbância.
IMPORTÂNCIA: A presença de luz difusa pode levar a resultados errôneos, especialmente em medições de alta absorbância ou em amostras que absorvem fortemente em comprimentos de onda específicos.
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (%T)
≤ 1.00 %

20. PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DO ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS

20.1. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA

O desafio mais utilizado para se verificar a exatidão do comprimento de onda do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***, é realizando a leitura do ***ÓXIDO DE HÓLMIO*** que apresenta, em seu espectro, vários picos bem definidos ao longo da região ***UV-VIS*** onde se pode observar com exatidão a real posição do comprimento de onda desejado.

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Varredura do comprimento de onda
Modo Fotométrico:	Absorbância
Faixa de Leitura:	230 – 650 nm
Velocidade de Varredura:	40 (se selecionável)
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Pontos de Coleta:	0.1 nm
Resposta:	Rápida

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Colocar o padrão de Óxido de Hólmio no compartimento de amostra;
3. Iniciar a leitura do padrão;
4. Após a leitura, determinar as posições dos picos encontrados.


POSIÇÃO ESPERADA (nm)	POSIÇÃO OBTIDA (nm)	DIFERENÇA (nm)	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)	RESULTADO
279.0	**279.00**	**0.00**	≤ **1.00**	**APROVADO**
360.9	**360.30**	**0.60**	≤ **1.00**	**APROVADO**
453.6	**452.90**	**0.70**	≤ **1.00**	**APROVADO**
637.6	**637.90**	**0.300**	≤ **1.00**	**APROVADO**

Comentários: **N/A**

Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**

Agilent 21-CFR-11 package active

Zero Report

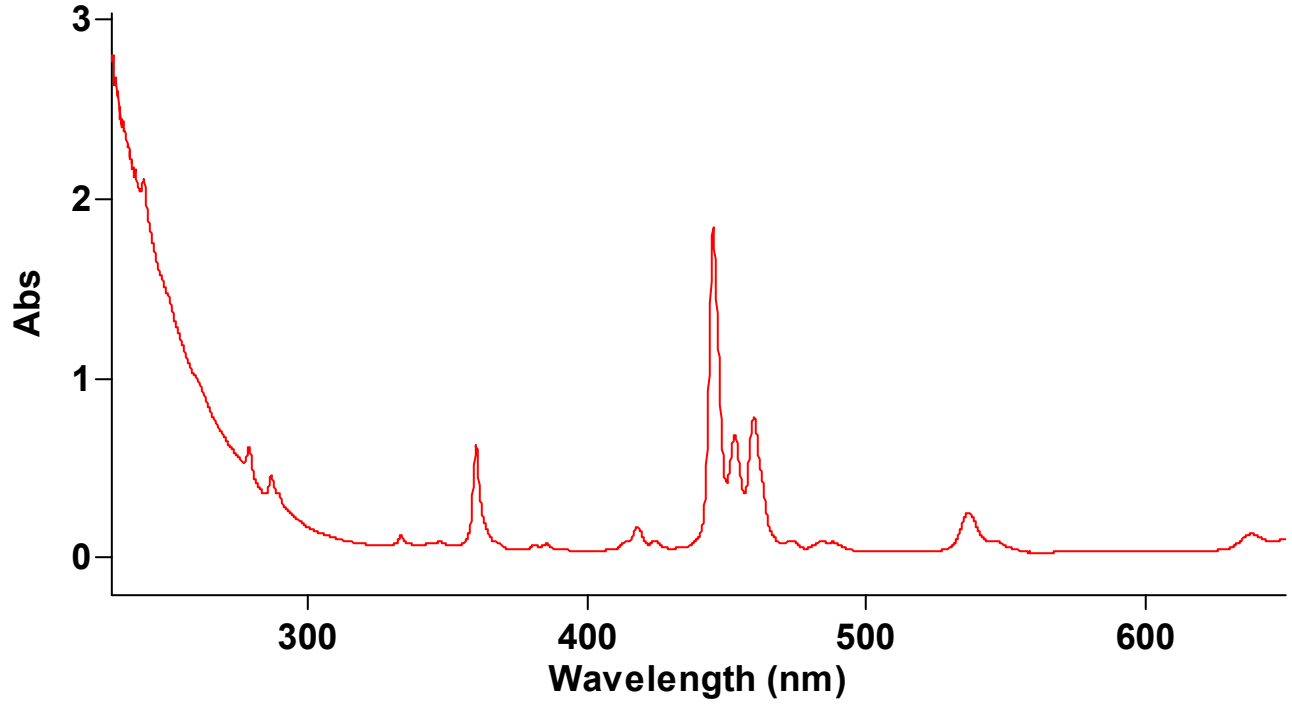

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 9:56:05 AM GMT: 8/28/2024 12:56:05 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 09:56:50 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Exatidão Do Comprimento De Onda.BSW
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	650.0
Stop (nm)	230.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	90.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.15
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.1000
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	Off
Cycle Mode	Off

Comments

Zero Report

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

Sample Name: Exatidão Do Comprimento De Onda

Collection Time	8/28/2024 9:56:59 AM

Peak Table

Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	650.0nm to 230.0nm

Wavelength (nm)	Abs
637.9	0.133
536.4	0.248
483.9	0.090
473.4	0.093
459.8	0.785
452.9	0.687
445.2	1.840
424.2	0.090
418.1	0.173
385.4	0.076
381.2	0.071
360.3	0.632
347.6	0.089
333.6	0.122
287.1	0.465
279.0	0.617
241.4	2.107
240.1	2.053
238.2	2.162
237.8	2.182
236.4	2.263
236.0	2.304
234.1	2.432
233.4	2.439
233.1	2.491
232.8	2.513
232.2	2.597
231.9	2.592
231.6	2.659
231.2	2.673
230.5	2.796

20.2. REPETIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA

Este método certifica de que o posicionamento do monocromador do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** é exatamente o mesmo para aquele determinado comprimento de onda. Para a obtenção de resultados quantitativos, a repetibilidade do comprimento de onda é mais importante que a precisão do comprimento de onda. Pois quando a repetibilidade do comprimento de onda é pobre, o desvio entre leituras é grande e a variação dos valores fotométricos medidos geralmente também será grande, afetando grandemente a determinação quantitativa.


Parâmetros de leitura:	
Modo:	Varredura do comprimento de onda
Modo Fotométrico:	Absorbância
Faixa de Leitura:	356 – 366 nm
Velocidade de Varredura:	40 (se selecionável)
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Pontos de Coleta:	0.1 nm
Resposta:	Rápida

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Colocar o padrão de Óxido de Hólmio no compartimento de amostra;
3. Iniciar a leitura do padrão;
4. Repetir a leitura o padrão por mais duas vezes;
5. Após as leituras, determinar a posição dos picos encontrados.

POSIÇÕES		VALOR MÁXIMO E MINIMO ENCONTRADO	DIFERENÇA (nm)	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)	RESULTADO
1ª POSIÇÃO	**360.3**	MÁX. = **360.3** MIN. = **360.3**	**0.00000**	≤ **0.10**	**APROVADO**
2ª POSIÇÃO	**360.3**				
3ª POSIÇÃO	**360.3**				
Comentários:	**N/A**				
Especialista:	**MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**				

Agilent 21-CF R-11 packa ge active

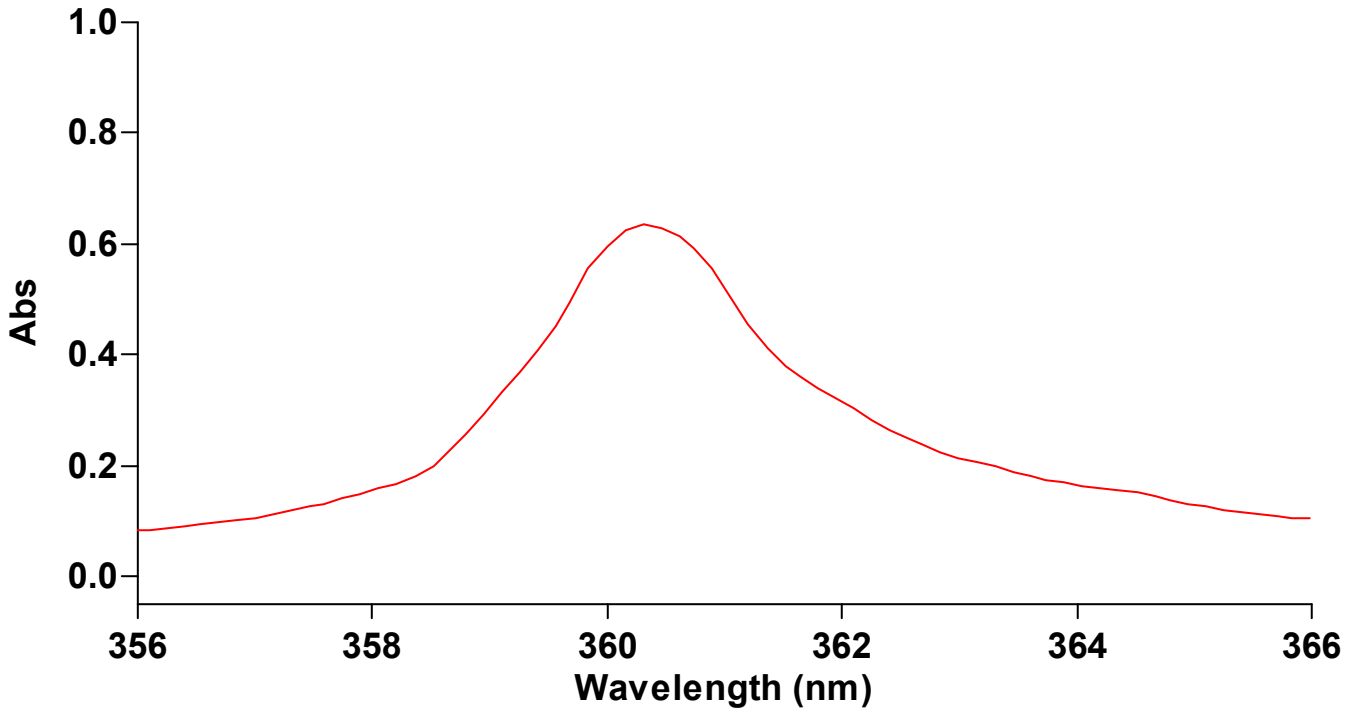

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:13:34 AM GMT: 8/28/2024 1:13:34 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 10:14:06 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Repetibilidade Do Comprimento De Onda - Rep. 1
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	366.0
Stop (nm)	356.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	720.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.15
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.0125
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	Off
Cycle Mode	Off
Comments	

Zero Report

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

Sample Name: Exatidão Do Comprimento De Onda - Rep. 1


Collection Time	8/28/2024 10:14:11 AM

Peak Table

Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	366.0nm to 355.9nm

Wavelength (nm)	Abs
360.3	0.635

Agilent 21-CF R-11 package active

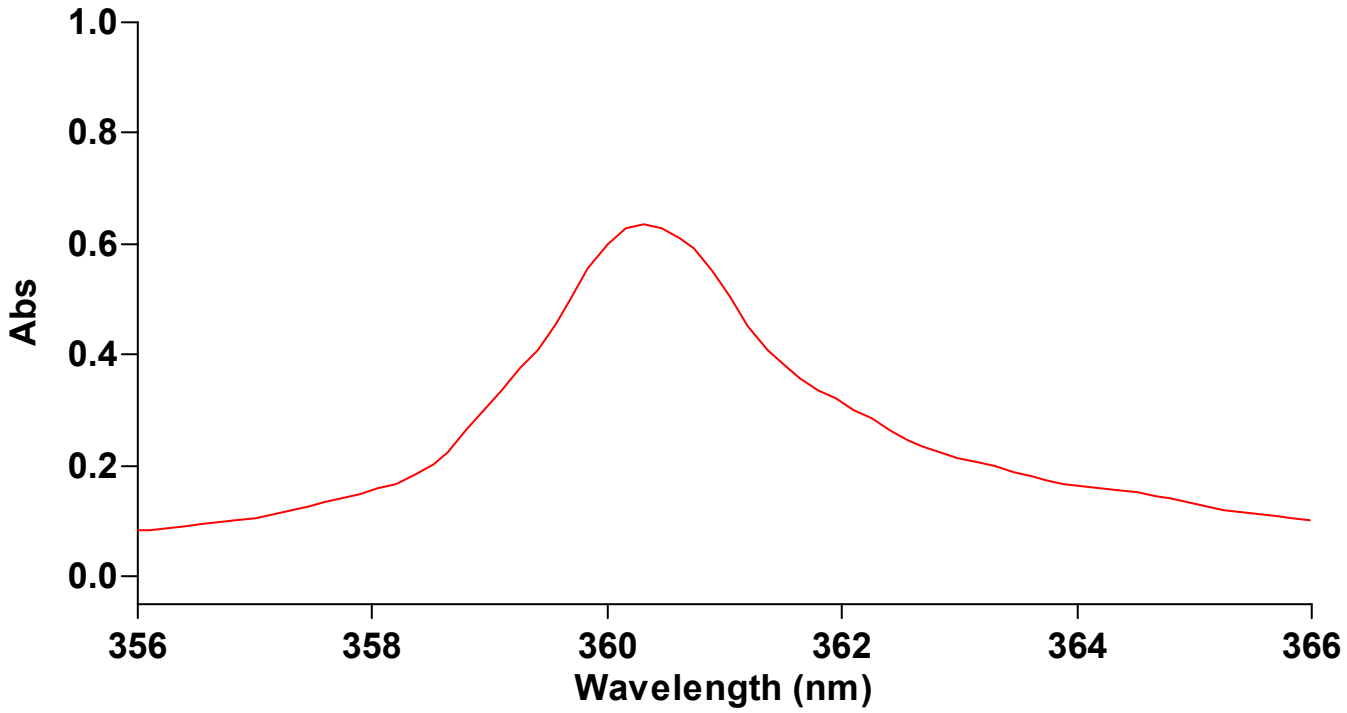

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:14:48 AM GMT: 8/28/2024 1:14:48 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 10:14:53 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Repetibilidade Do Comprimento De Onda - Rep. 2
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	366.0
Stop (nm)	356.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	720.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.15
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.0125
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	Off
Cycle Mode	Off
Comments	

Zero Report

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

Sample Name: Exatidão Do Comprimento De Onda - Rep. 2


Collection Time	8/28/2024 10:14:56 AM

Peak Table

Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	366.0nm to 355.9nm

Wavelength (nm)	Abs
360.3	0.634

Agilent 21-CF R-11 packa ge active

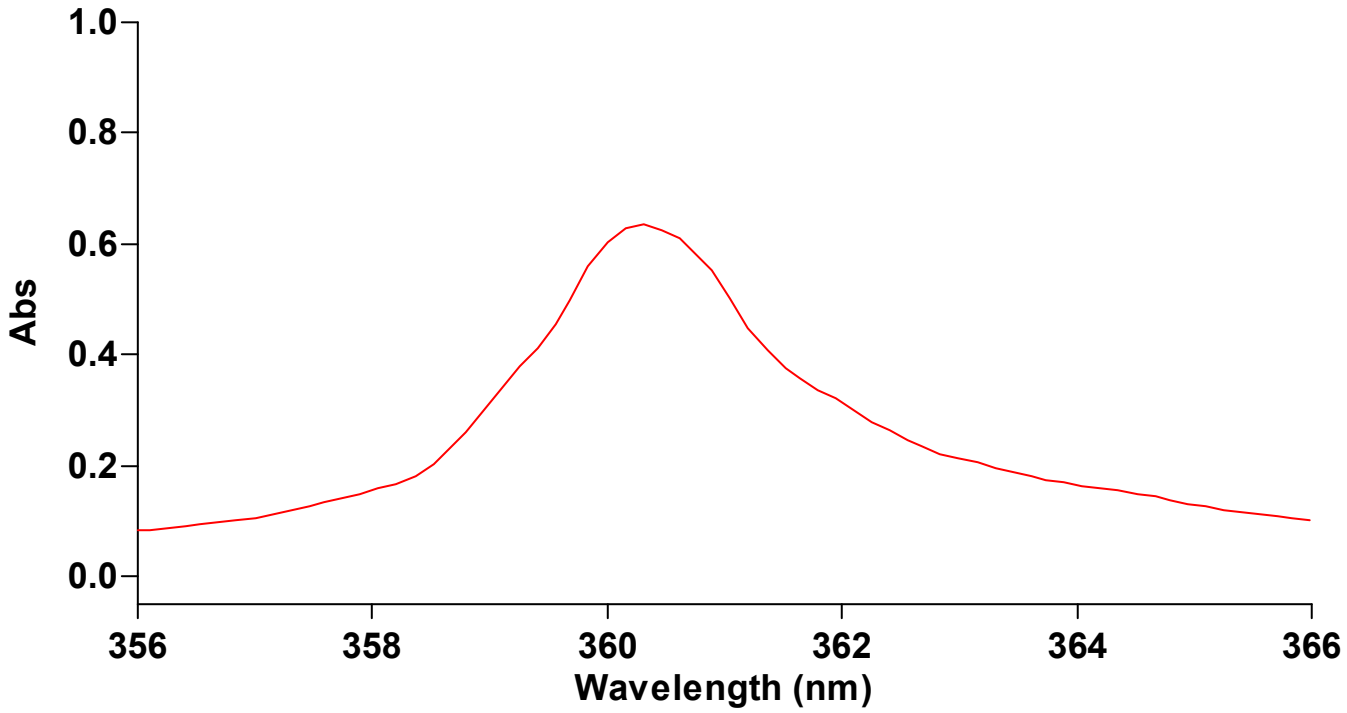

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:15:18 AM GMT: 8/28/2024 1:15:18 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 10:15:22 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Repetibilidade Do Comprimento De Onda - Rep. 3
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	366.0
Stop (nm)	356.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	720.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.15
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.0125
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	Off
Cycle Mode	Off
Comments	

Zero Report

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

Sample Name: Exatidão Do Comprimento De Onda - Rep. 3

Collection Time	8/28/2024 10:15:24 AM

Peak Table

Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	366.0nm to 355.9nm

Wavelength (nm)	Abs
360.3	0.635

20.3. RESOLUÇÃO

Este método verifica capacidade de separar e medir picos de absorção adjacentes (resolução) do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***. A resolução depende da pureza da luz incidente na amostra e é geralmente definida como a largura de banda espectral (nm) da luz monocromática.


Parâmetros de leitura:	
Modo:	Varredura do comprimento de onda
Modo Fotométrico:	Absorbância
Faixa de Leitura:	350 – 370 nm
Velocidade de Varredura:	40 (se selecionável)
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Pontos de Coleta:	0.1 nm
Resposta:	Rápida

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Colocar o padrão de Óxido de Hólmio no compartimento de amostra;
3. Iniciar a leitura do padrão;
4. Após a leitura, determinar a largura da meia altura do pico encontrado.

LARGURA DA MEIA ALTURA OBTIDA (nm)	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (nm)	RESULTADO
2.3834	Para largura de banda de **1.5** nm = ≤ **2.80** nm	**APROVADO**
Comentários: **N/A**		
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**		

Agilent 21-CF R-11 package active

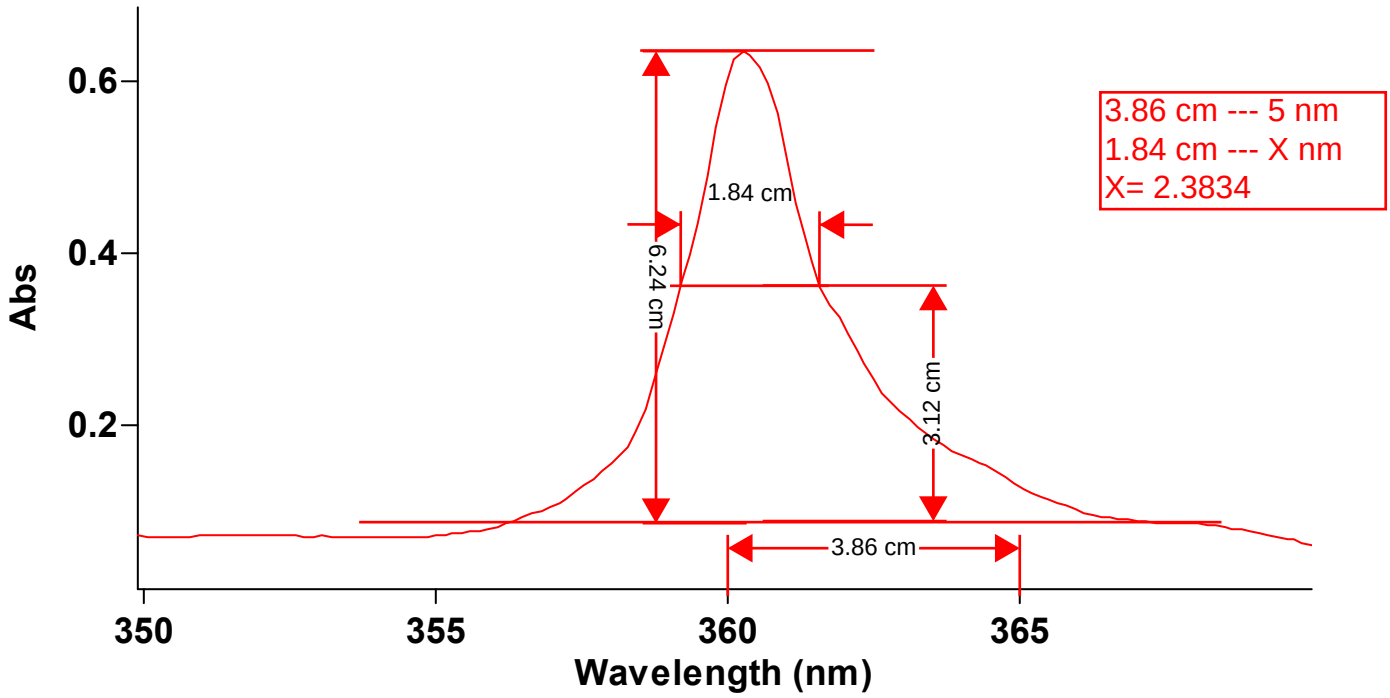

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:18:38 AM GMT: 8/28/2024 1:18:38 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 10:18:50 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Resolução.BSW
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	370.0
Stop (nm)	350.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	720.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.15
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.0125
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	Off
Cycle Mode	Off
Comments	

Zero Report

Read	Abs (650.0 nm)
Zero	0.0517

Sample Name: Resolução

Collection Time	8/28/2024 10:18:53 AM

Peak Table

Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	370.0nm to 349.9nm

Wavelength (nm)	Abs
360.3	0.634

20.4. EXATIDÃO FOTOMÉTRICA

Este método envolve a avaliação da precisão das leituras de absorbância ou transmitância do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** utilizando amostras padrão. A definição geral é verificar a diferença da absorbância ou transmitância entre o valor do certificado e o valor obtido do padrão.

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Comprimento de onda fixo
Modo Fotométrico:	Absorbância
Comprimento de Onda:	440 nm
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Resposta:	Médio

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Usando a função Auto Zero, zerar a absorbância;
3. Colocar o filtro do primeiro padrão no compartimento de amostra;
4. Iniciar a leitura do padrão;
5. Repetir o item 3 para o filtro do segundo e terceiro padrão.

FILTRO	ABSORBÂNCIA ESPERADA	ABSORBÂNCIA OBTIDA	DIFERENÇA	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO
A3	**0.520**	**0.5170**	**0.0030**	≤ **0.0100**	**APROVADO**
A4	**0.968**	**0.9740**	**0.0060**	≤ **0.0100**	**APROVADO**
A6	**2.054**	**2.0497**	**0.0043**	≤ **0.0100**	**APROVADO**
Comentários: **N/A**					
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**					

8/28/2024 10:32:38 AM
relatorio de espectrofotometria

Agilent 21-CFR-11 package active
\

Simple Reads Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:24:59 AM GMT: 8/28/2024 1:24:59 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Collection Time:	8/28/2024 10:31:18 AM
Method:	
Version	5.0.0.999
Instrument:	Cary 60
Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:31:21 AM GMT: 8/28/2024 1:31:21 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
Zero	(0.0565)	440.0
Ave Time (sec)	1.0000	

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:31:41 AM GMT: 8/28/2024 1:31:41 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
1	0.5170	440.0
2	0.9740	440.0
3	2.0497	440.0

Report Saved to AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Exatidão_Fotométrica.BSR

20.5. REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA

Este método certifica repetibilidade mecânica do posicionamento da amostra no porta amostras do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***. A definição geral é a variação do valor de medição, mostrado como Absorbância ou Transmitância, quando uma amostra é removida e reinstalada na mesma posição. Valores menores indicam que a amostra está mais próxima da posição original.

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Comprimento de onda fixo
Modo Fotométrico:	Absorbância
Comprimento de Onda:	361 nm
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Resposta:	Médio
Leituras:	3

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Colocar o padrão de Óxido de Hólmio no compartimento de amostra;
3. Iniciar a leitura do padrão;
4. Repetir a leitura o padrão por mais duas vezes;
5. Após as leituras, determinar o valor de absorbância encontrados.

POSIÇÕES DAS LEITURAS		VALOR MÁXIMO E MINIMO ENCONTRADO	DIFERENÇA (abs)	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)	RESULTADO
1ª LEITURA	**0.5228**	MÁX. = **0.5228** MIN. = **0.5226**	**0.00020**	≤ **0.0020**	**APROVADO**
2ª LEITURA	**0.5227**				
3ª LEITURA	**0.5226**				
Comentários: **N/A**					
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**					

8/28/2024 10:42:24 AM
relatorio de espectrofotometria

Agilent 21-CFR-11 package active
\

Simple Reads Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:33:58 AM GMT: 8/28/2024 1:33:58 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Collection Time:	8/28/2024 10:34:26 AM
Method:	
Version	5.0.0.999
Instrument:	Cary 60
Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:34:30 AM GMT: 8/28/2024 1:34:30 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
Zero	(0.0564)	361.0
Ave Time (sec)	1.0000	

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:34:47 AM GMT: 8/28/2024 1:34:47 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
1	0.5228	361.0
2	0.5227	361.0
3	0.5226	361.0

Report Saved to
AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Repetibilidade_Fotométrica.BSR

20.6. LINEARIDADE FOTOMÉTRICA

Este método envolve a avaliação da linearidade das leituras de absorbância ou transmitância do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***, utilizando amostras padrão. A definição geral é verificar o coeficiente de inclinação da curva entre o valor do certificado e o valor obtido do padrão.

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Comprimento de Onda Fixo
Modo Fotométrico:	Absorbância
Comprimento de Onda:	440nm
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Resposta:	Médio

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Usando a função Auto Zero, zerar a absorbância;
3. Realizar as leituras das absorbâncias dos filtros relacionados abaixo e anotar as absorbâncias obtidas;
4. Após as leituras obtidas, determinar o R^2 das absorbâncias encontradas.

FILTRO	ABSORBÂNCIA ESPERADA	ABSORBÂNCIA OBTIDA	VALOR ENCONTRADO R^2	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO
A3	**0.520**	**0.5172**	**0.99994**	≥ **0.99900**	**APROVADO**
A4	**0.968**	**0.9749**			
A6	**2.054**	**2.0485**			
Comentários: **N/A**					
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**					

8/28/2024 10:50:32 AM
relatorio de espectrofotometria

Agilent 21-CFR-11 package active
\

Simple Reads Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:34:40 AM GMT: 8/28/2024 1:34:40 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Collection Time:	8/28/2024 10:43:51 AM
Method:	
Version	5.0.0.999
Instrument:	Cary 60
Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:44:19 AM GMT: 8/28/2024 1:44:19 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
Zero	(0.0560)	440.0

\

Simple Reads Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:44:30 AM GMT: 8/28/2024 1:44:30 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Collection Time:	8/28/2024 10:44:30 AM
Method:	
Version	5.0.0.999
Instrument:	Cary 60
Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 10:44:52 AM GMT: 8/28/2024 1:44:52 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	Abs	nm
1	0.5172	440.0
2	0.9749	440.0
3	2.0485	440.0

Report Saved to AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Linearidade Fotométrica.BSR

20.7. ESTABILIBADE DA LINHA DE BASE

Estabilidade da linha de base mostra a estabilidade da leitura durante um longo período próximo do nível zero de absorbância do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***. A estabilidade de linha de base é geralmente definida como sendo a largura de variação, apresentada como uma unidade de absorbância quando o instrumento é submetido a funcionar sem mudança de parâmetros e sem amostra na câmara de amostra. Quando o valor é pequeno, a confiabilidade dos valores de medição é alta. Esta avaliação é importante quando várias amostras são medidas durante um período longo, como quando se usa um amostrador automático. Este teste deve ser realizado somente depois que o instrumento estiver ligado por mais de uma hora. Variações de temperatura ambiente devem ser reduzidas ao mínimo (+/- 5 °C).

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Varredura por tempo
Modo Fotométrico:	Absorbância
Comprimento de Onda:	250 nm
Período:	900 seg
Largura de Banda:	1 nm (se selecionável)
Pontos de Coleta:	5.0 seg
Resposta:	Lento


Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Confirmar que não haja amostras na câmara de amostras;
3. Iniciar a leitura;
4. Após a leitura, determinar o ponto máximo e o ponto mínimo dos dados coletados.

DIFERENÇA ENTRE O PONTO MÁXIMO E O PONTO MÍNIMO DA LINHA DE BASE MEDIDO A 250 NM POR 900 SEGUNDOS

VALOR DE ABS ENCONTRADOS		DIFERENÇA DOS PICOS	DIVIDIR POR 2 A DIFERENÇA ENCONTRADA	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)	RESULTADO
MÁX =	**0.00010**	**0.00010**	VALOR OBTIDO	≤ **0.00500**	**APROVADO**
MIN =	**-0.00004**		**0.00010**		
Comentários: **N/A**					
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**					

8/28/2024 11:58:16 AM
relatorio de espectrofotometria

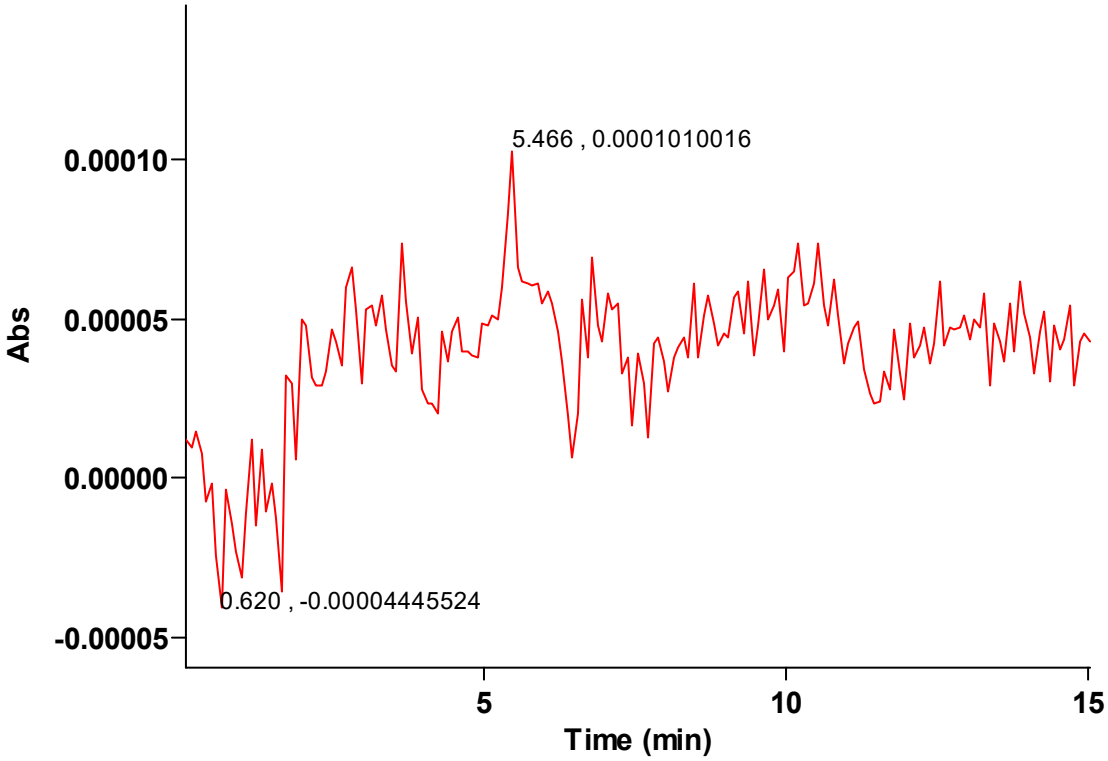

Agilent 21-CFR-11 package active

\

Kinetics Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 11:07:40 AM GMT: 8/28/2024 2:07:40 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Collection Time:	Wed 28 Aug 11:08:13 AM 2024
Method:	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Estabilidade Da Linha De Base.BKN
Software version:	5.0.0.999
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument version	2.00
Wavelength (nm)	250.0
Ordinate mode	Abs
Ave Time (sec)	5.0000
Cycle Time(min)	0.00
Stop Time(min)	15.00

8/28/2024 11:58:16 AM
relatorio de espectrofotometria

Zero Report

Read	Abs (250.0 nm)
Zero	0.0405

User Data Form

20.8. UNIFORMIDADE DA LINHA DE BASE

A uniformidade da linha de base é sempre medida em todos os comprimentos de onda do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS*** e é ideal quando a amostra não tem absolutamente nenhuma absorbância em toda a faixa espectral. Uniformidade da linha de base é geralmente definido como a largura de variação, mostrado como absorbância ou transmitância, quando comprimentos de onda são verificados ao longo de um determinado intervalo definido com a câmara de amostra vazia. Quando a medição é realizada com a linha de base pouco uniforme, cuidados especiais devem ser tomados, pois a distorção será adicionada para o espectro original, resultando em um espectro de absorção impreciso.

Estas distorções da linha de base diminuíram muito com os novos espectrofotômetros que utilizam microprocessadores internos, porque a uniformidade da linha de base é corrigida para todas as regiões do comprimento de onda. Este teste deve ser realizado somente uma hora depois que instrumento foi ligado. As variações de temperatura ambiente devem ser reduzidas ao mínimo (+/- 5 °C).

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Varredura do comprimento de onda
Modo Fotométrico:	Absorbância
Faixa de Leitura:	200 – 1000 nm
Velocidade de Scan:	400 nm/min
Pontos de Coleta:	1.0 nm
Resposta:	Média


Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Confirmar que não haja amostras na câmara de amostras;
3. Iniciar a leitura;
4. Após a leitura, determinar o ponto máximo e o ponto mínimo dos dados coletados.

DIFERENÇA ENTRE O PONTO MÁXIMO E O PONTO MÍNIMO DA LINHA DE BASE MEDIDO DA FAIXA DE 200 A 1000 NM					
VALOR DE ABS ENCONTRADOS		DIFERENÇA DOS PICOS	DIVIDIR POR 2 A DIFERENÇA ENCONTRADA	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (abs)	RESULTADO
MÁX =	**0.00274**	**0.00624**	VALOR OBTIDO	**0.00500**	**APROVADO**
MIN =	**-0.00350**		**0.00310**		
Comentários: **N/A**					
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**					

Agilent 21-CFR-11 package active

Zero Report

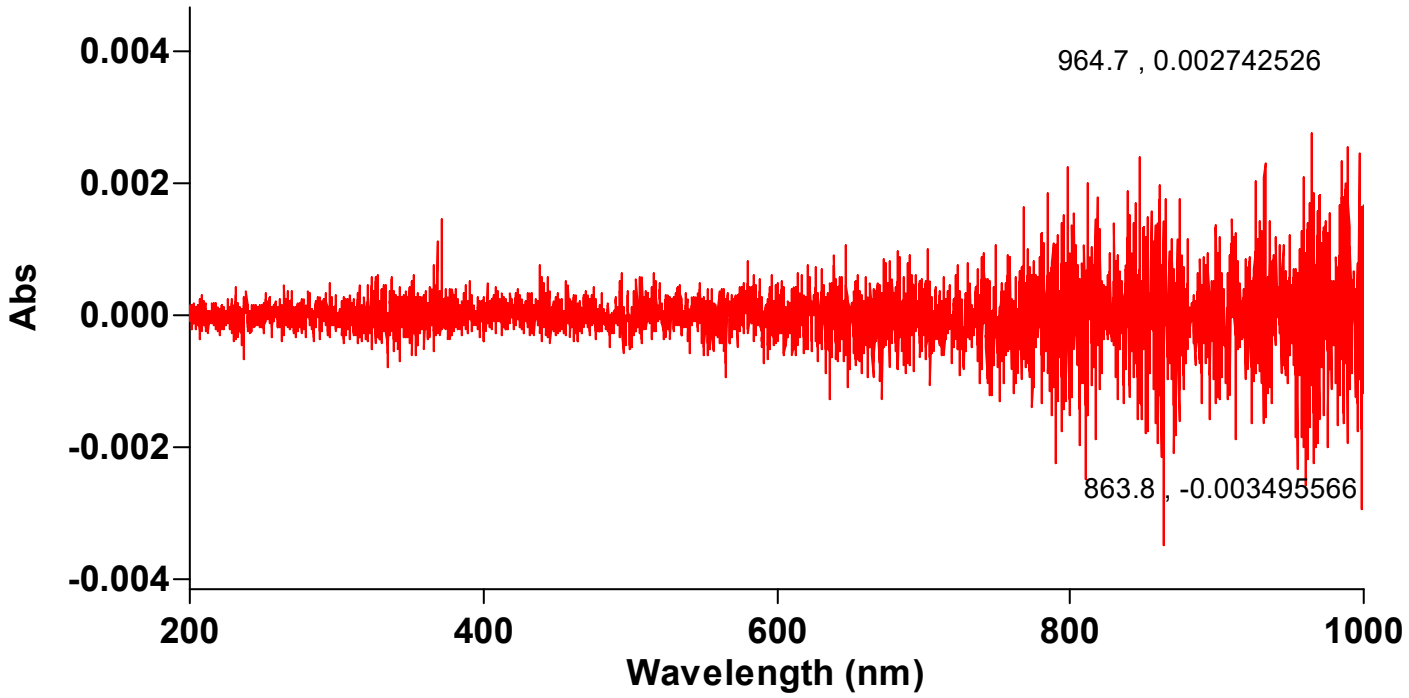

Read	Abs (1000.0 nm)
Zero	0.0367

\

Scan Analysis Report

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 11:58:29 AM GMT: 8/28/2024 2:58:29 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Report Time :	Wed 28 Aug 11:58:49 AM 2024
Method	
Batch:	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Uniformidade Da Linha.BSW
Software version:	5.1.0.1016
Operator:	ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini (Bruno Colovini)

Instrument Parameters

Instrument	Cary 60
Instrument Version	2.00
Start (nm)	1000.0
Stop (nm)	200.0
X Mode	Nanometers
Y Mode	Abs
UV-Vis Scan Rate (nm/min)	408.00
UV-Vis Data Interval (nm)	0.17
UV-Vis Ave. Time (sec)	0.0250
Beam Mode	Dual Beam
Baseline Correction	On
Baseline Type	Baseline correction

Baseline File Name	AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Uniformidade Da Linha.BSW
Baseline Std Ref File Name	
Cycle Mode	Off
Comments	

Zero Report

Read	Abs (1000.0 nm)
Zero	0.0367

Sample Name: Uniformidade Da Linha De Base

Collection Time	8/28/2024 11:58:52 AM

Peak Table	
Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	1000.0nm to 200.0nm

No peak found above threshold

20.9. LUZ DIFUSA (*STRAY LIGHT*)

Este método envolve a avaliação da incidência de luzes difusas do ***ESPECTROFOTÔMETRO UV-VIS***, na região do ultravioleta ou visível utilizando um padrão rastreável.

Parâmetros de leitura:	
Modo:	Comprimento de onda fixo
Modo Fotométrico:	Transmitância
Comprimento de Onda:	Verificar no certificado do padrão
Largura de Banda:	1 nm se selecionável
Resposta:	Médio

Procedimento do teste:

1. Configurar os parâmetros de leitura;
2. Usando a função Auto Zero, zerar a absorbância;
3. Colocar o padrão no compartimento de amostra;
4. Iniciar a leitura do padrão.

COMPRIMENTO DE ONDA	VALOR DE TRANSMITÂNCIA OBTIDO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO
360	**0.001**	≤ **1.0%**	**APROVADO**
Comentários: **N/A**			
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**			

8/28/2024 1:23:18 PM
relatorio de espectrofotometria

Agilent 21-CFR-11 package active
\

Simple Reads Report

Collection Time:	8/28/2024 1:16:04 PM
Method:	
Version	5.0.0.999
Instrument:	Cary 60
Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 1:16:52 PM GMT: 8/28/2024 4:16:52 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	%T	nm
Zero	(87.759)	360.0

Ave Time (sec)	1.0000

on AFRA13 at Local time:8/28/2024 1:23:08 PM GMT: 8/28/2024 4:23:08 PM by ANALISTAS PeD\OMEGA\bruno_colovini = Bruno Colovini ;Serial Number: G6860A MY19209209;

Read	%T	nm
1	0.001	360.0

Report Saved to AFRA13\SQLEXPRESS|VAIMDB_21CFR11DataBase(000)|AFRAPHARMA\CQ\Analise\Stray Light.BSR

21. RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DO UV-VIS

TESTES REALIZADOS	RESULTADO
20.1. Exatidão do Comprimento de Onda	**N/A**
20.2. Repetibilidade do Comprimento de Onda	**APROVADO**
20.3. Resolução	**APROVADO**
20.4. Exatidão Fotométrica	**APROVADO**
20.5. Repetibilidade Fotométrica	**APROVADO**
20.6. Linearidade Fotométrica	**APROVADO**
20.7. Estabilidade da Linha de Base	**APROVADO**
20.8. Uniformidade da Linha de Base	**APROVADO**
20.9. Luz Difusa (Stray Light)	**APROVADO**
Especialista: **MICHAEL FERNANDO CARELI DA SILVA**	

22. ASSINATURAS

As assinaturas a seguir representam a validação dos testes realizados, bem como a aprovação dos parâmetros e critérios de aceitação estabelecidos neste certificado de ***QUALIFICAÇÃO***. A aprovação é atestada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante:

Aprovado por:	**FABÍOLA SPIGARIOL**	Assinatura:
Empresa Contratada:	**LAB PROVIDER**	
Departamento:	**DOCUMENTAÇÃO**	
Função:	**ASSIST. DE QUALIDADE**	

Empresa Contratante:	**LABORATÓRIO TIARAJU ALIMENTOS E COSMÉTICOS S/A**	
Aprovado por:		Assinatura:

23. HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA DE EFETIVIDADE:	***REVISÃO***	***ITENS***	***REGISTRO DE ALTERAÇÕES***
22/08/2024	00	Todos	Elaboração do Documento.