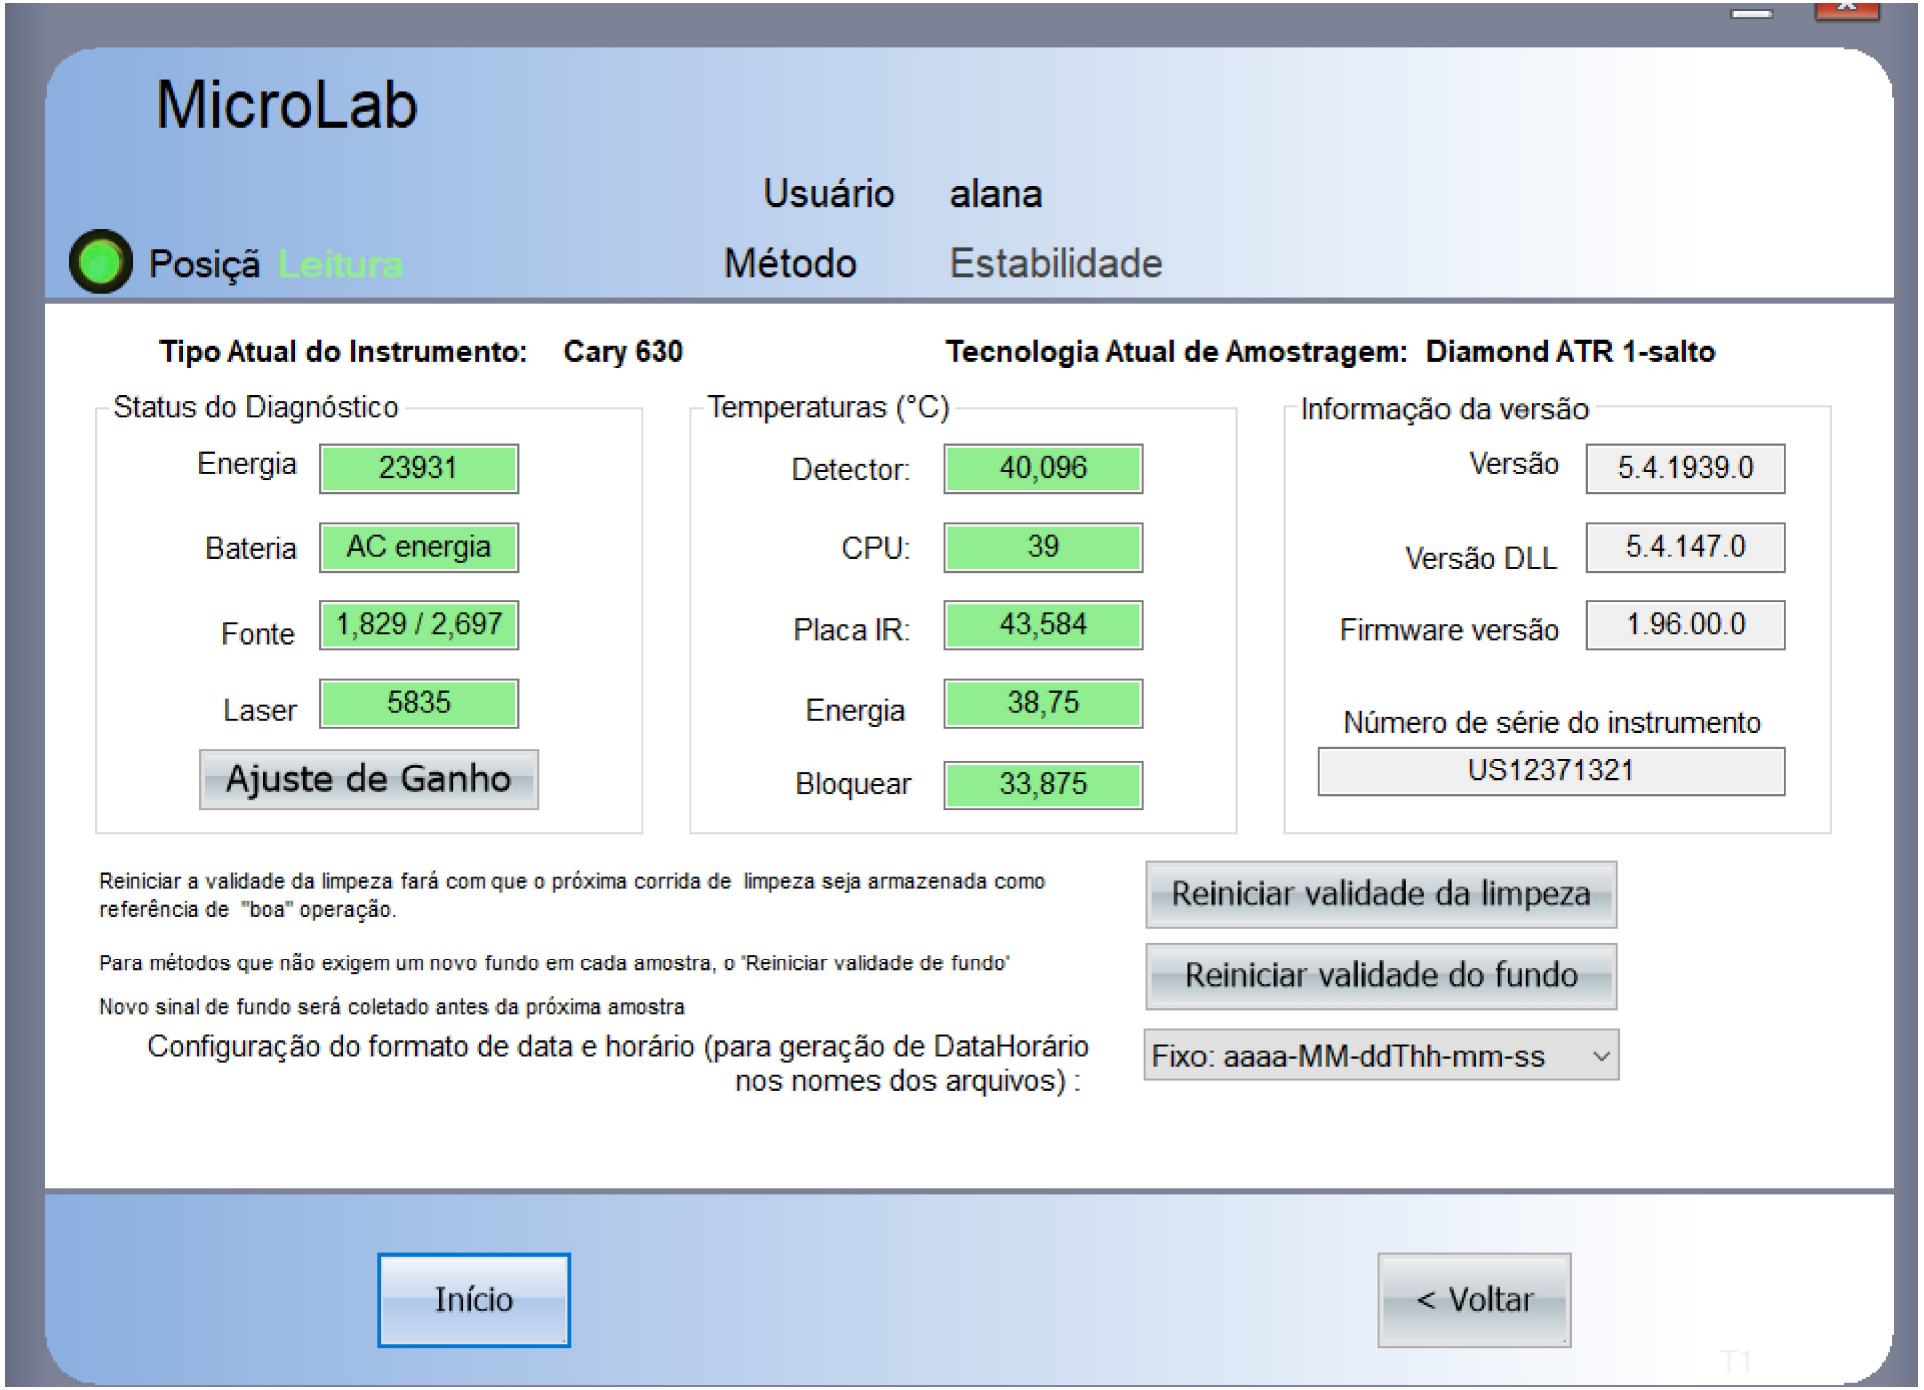

MicroLab
Usuário alana
Posiçã Leitura
Método Estabilidade
Tipo Atual do Instrumento: Cary 630
Tecnologia Atual de Amostragem: Diamond ATR 1-salto
Status do Diagnóstico
Energia 23931
Bateria AC energia
Fonte 1,829 / 2,697
Laser 5835
Ajuste de Ganho
Temperaturas (°C)
Detector: 40,096
CPU: 39
Placa IR: 43,584
Energia 38,75
Bloquear 33,875
Informação da versão
Versão 5.4.1939.0
Versão DLL 5.4.147.0
Firmware versão 1.96.00.0
Número de série do instrumento
US12371321
Reiniciar a validade da limpeza fará com que o próxima corrida de limpeza seja armazenada como referência de "boa" operação.
Reiniciar validade da limpeza
Para métodos que não exigem um novo fundo em cada amostra, o 'Reiniciar validade de fundo'
Novo sinal de fundo será coletado antes da próxima amostra
Reiniciar validade do fundo
Configuração do formato de data e horário (para geração de DataHorário nos nomes dos arquivos) :
Fixo: aaaa-MM-ddThh-mm-ss
Início
< Voltar

Agilent Technologies

Sample ID:02 - Exatidão do número de onda - ATR

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m

Sample Scans:16

User:alana

Background Scans:16

Date/Time:08/13/2026 10:34:33


Resolution:2

Range:3000 - 650

System Status:Bom

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\02 - Exatidão do número de onda - ATR_2026-08-13T10-34-33.a2r

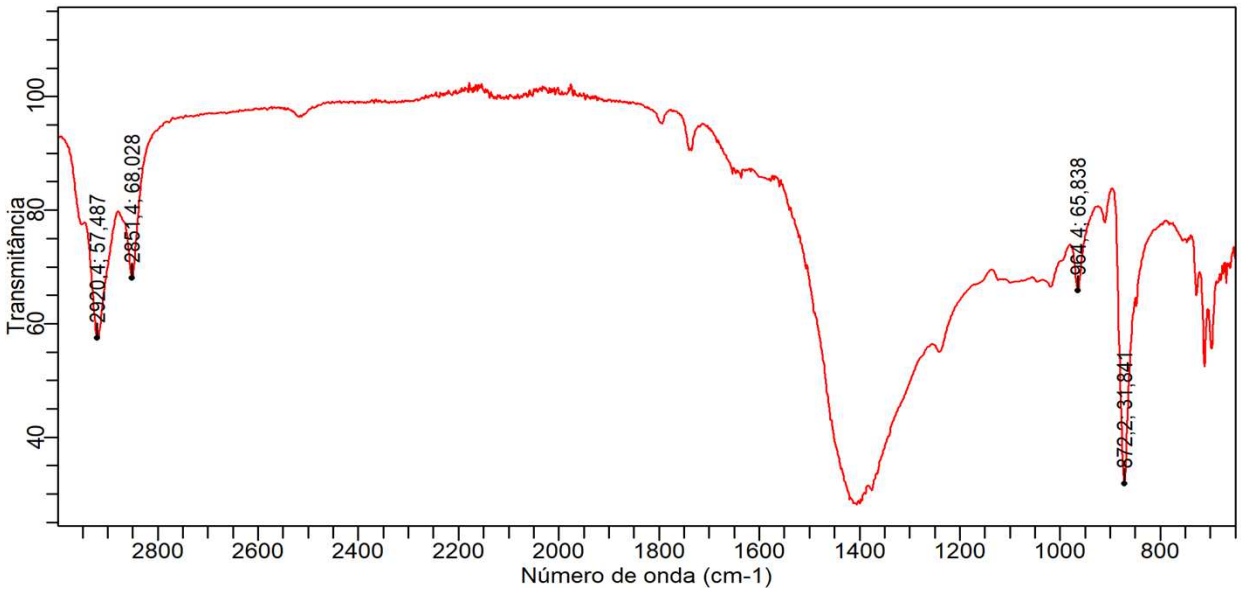

Agilent Technologies

Sample ID:03 - Resolução - ATR

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m

Sample Scans:16

User:alana

Background Scans:16

Date/Time:08/13/2026 10:39:45


Resolution:2

Range:3000 - 650

System Status:Bom

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\03 - Resolução - ATR_2026-08-13T10-39-45.a2r

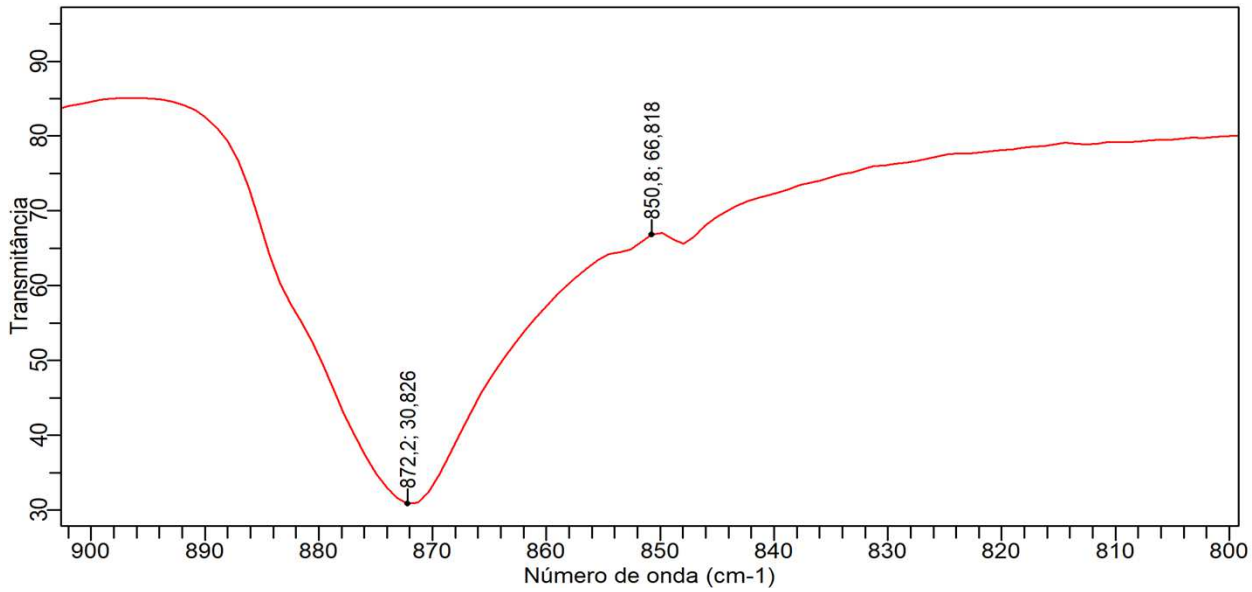

Agilent Technologies

Sample ID:04a - Repetibilidade do número de onda 1-2 - ATR

Sample Scans:16

Background Scans:16

Resolution:2

System Status:Bom

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m


User:alana

Date/Time:08/13/2026 10:42:34

Range:3000 - 650

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\04a - Repetibilidade do número de onda 1-2 - ATR_2026-08-13T10-42-34.a2r

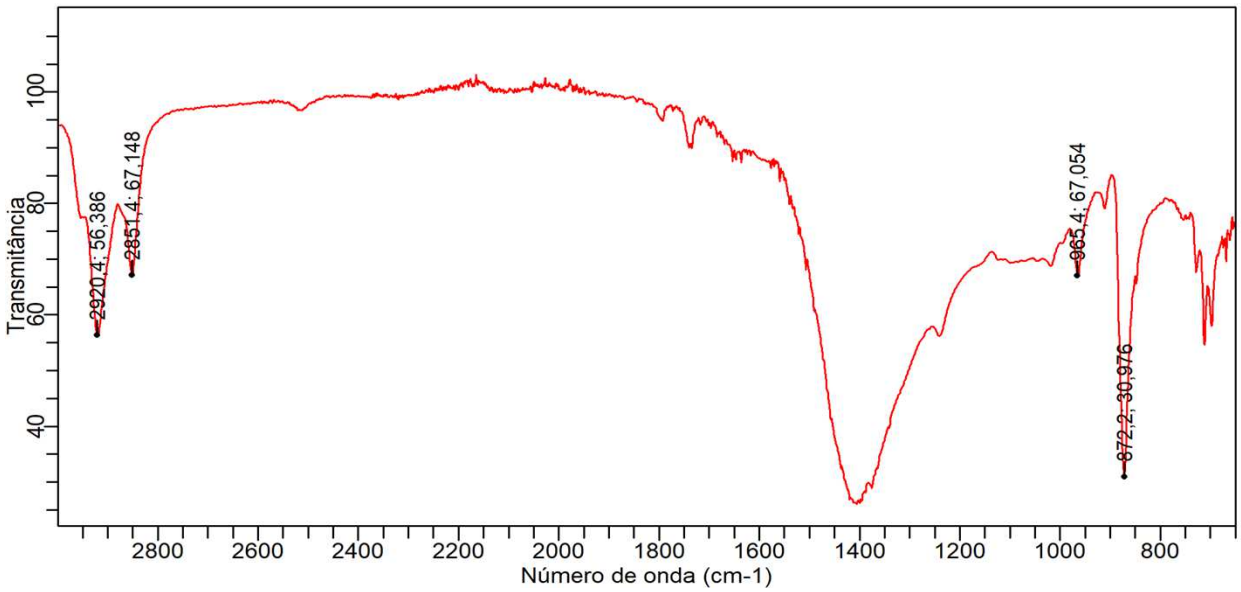

Agilent Technologies

Sample ID:04b - Repetibilidade do número de onda 2-2 - ATR

Sample Scans:16

Background Scans:16

Resolution:2

System Status:Bom

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m


User:alana

Date/Time:08/13/2026 10:45:16

Range:3000 - 650

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\04b - Repetibilidade do número de onda 2-2 - ATR_2026-08-13T10-45-16.a2r

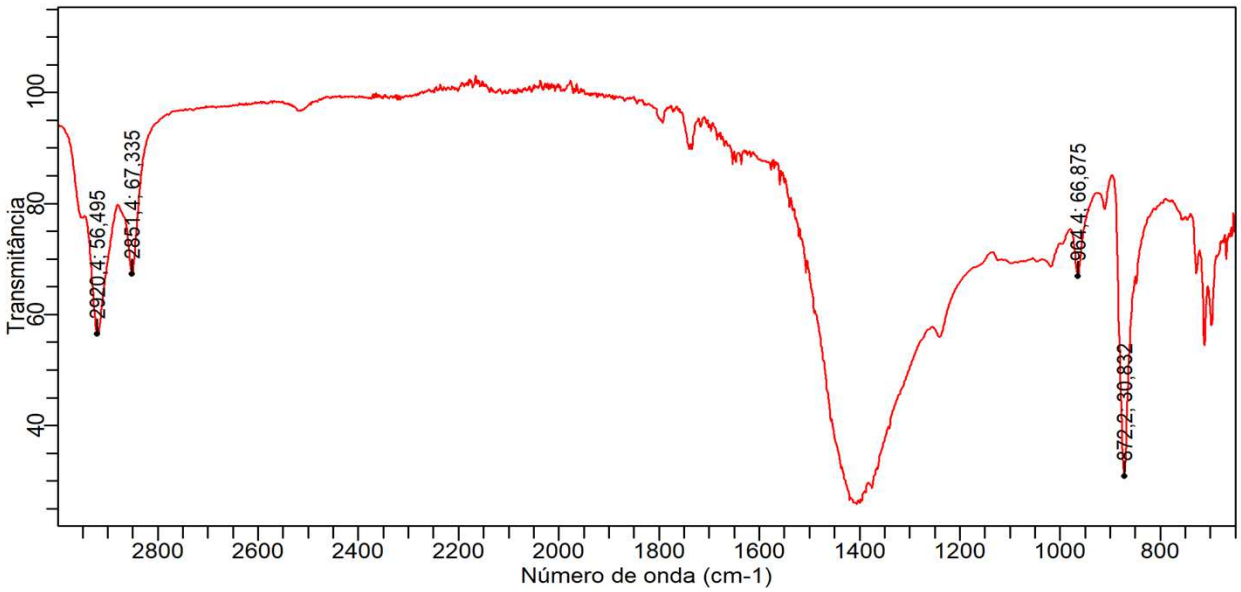

Agilent Technologies

Sample ID:05a - Repetibilidade fotométrica 1-2 - ATR

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m

Sample Scans:16

User:alana

Background Scans:16

Date/Time:08/13/2026 10:50:18


Resolution:2

Range:3000 - 650

System Status:Bom

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\05a - Repetibilidade fotométrica 1-2 - ATR_2026-08-13T10-50-18.a2r

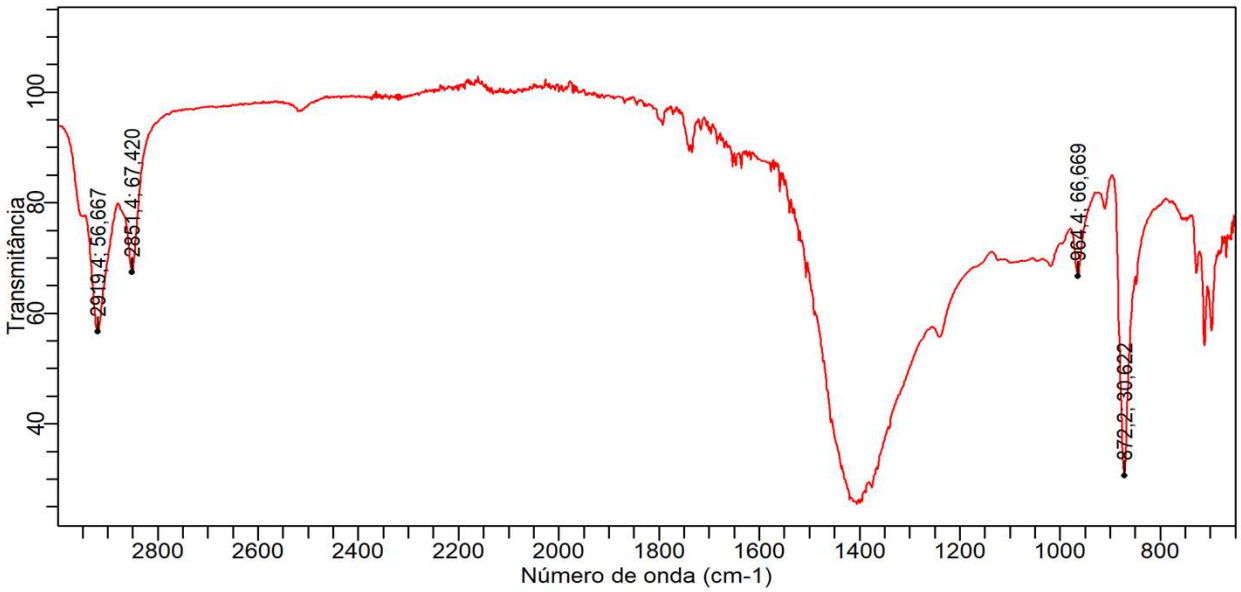

Agilent Technologies

Sample ID:05b - Repetibilidade fotométrica 2-2 - ATR

Sample Scans:16

Background Scans:16

Resolution:2

System Status:Bom

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m


User:alana

Date/Time:08/13/2026 10:52:59

Range:3000 - 650

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\05b - Repetibilidade fotométrica 2-2 - ATR_2026-08-13T10-52-59.a2r

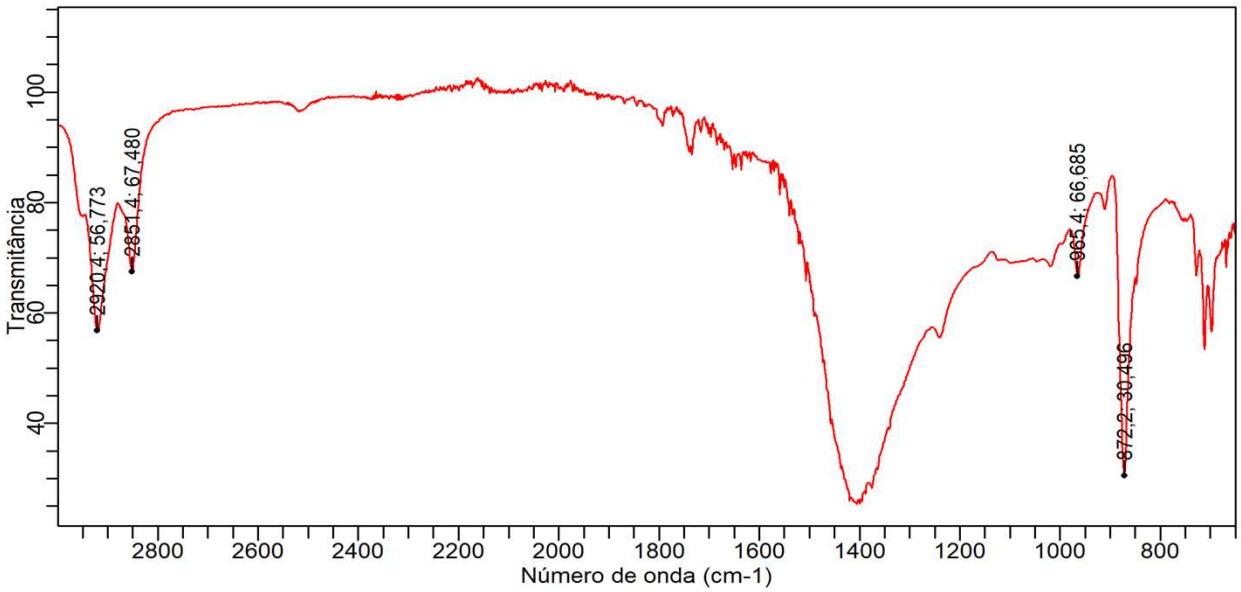

Agilent Technologies

Sample ID:06 - Sensibilidade - ATR

Method Name:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Methods\QPack Qualificação.a2m

Sample Scans:48

User:alana

Background Scans:48

Date/Time:08/13/2026 11:00:51

Resolution:4

Range:3000 - 650

System Status:Bom

Apodization:Happ-Genzel

File Location:C:\Users\Public\Documents\Agilent\MicroLab\Results\\06 - Sensibilidade - ATR_2026-08-13T11-00-51.a2r

