CALIBRAÇÃO - BRANCO




```
TOC2100                          GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
11/09/24                         13:16:57
|  Condut.|    Temp.|      TOC |
|   uS/cm |      'C |      ppb |
|---------+---------+----------|
|   0.955|     25.8|       50|
|   0.951|     25.5|       51|
|   0.957|     25.7|       47|
--------- Estatistica ----------
Nr. Amostras=          3
TOC Minimo  =       47 ppb
TOC Maximo  =       51 ppb
Amplitude   =        4 ppb
Desv. Padrao=      1.9 ppb
DP Relativo =      3.8 %
---------------------------------
TOC Medio   =      49.2 ppb
---------------------------------
---------------------------------
                 Assinatura
```

CALIBRAÇÃO - SACAROSE



```
TOC2100                          GEHAKA
Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004
11/09/24                         15:22:21
|  Condut.|    Temp.|      TOC |
|   uS/cm |      'C |      ppb |
|---------+---------+----------|
|   0.771|     26.0|      512|
|   0.790|     26.0|      497|
|   0.791|     26.1|      492|
--------- Estatistica ----------
Nr. Amostras=          3
TOC Minimo  =      492 ppb
TOC Maximo  =      512 ppb
Amplitude   =       20 ppb
Desv. Padrao=     10.4 ppb
DP Relativo =      2.1 %
---------------------------------
TOC Medio   =      500.3 ppb
---------------------------------
---------------------------------
                 Assinatura
```

SYSTEM SUITABILTY - BRANCO

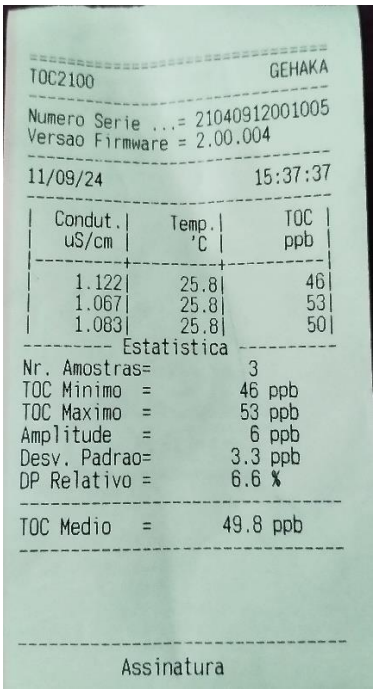

TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004

11/09/24 15:37:37

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
1.122	25.8	46
1.067	25.8	53
1.083	25.8	50

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	46 ppb
TOC Maximo =	53 ppb
Amplitude =	6 ppb
Desv. Padrao=	3.3 ppb
DP Relativo =	6.6 %
TOC Medio =	49.8 ppb

Assinatura

SYSTEM SUITABILTY - SACAROSE



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004

11/09/24 16:20:01


Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
0.962	26.2	511
0.930	26.1	516
0.962	26.4	513

Estatistica

Nr. Amostras=	3
TOC Minimo =	511 ppb
TOC Maximo =	516 ppb
Amplitude =	5 ppb
Desv. Padrao=	2.6 ppb
DP Relativo =	0.5 %
TOC Medio =	513.6 ppb

Assinatura

SYSTEM SUITABILTY - BENZOQUINONA

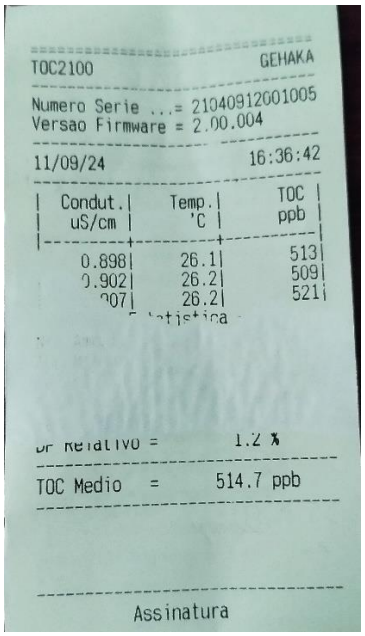

TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004

11/09/24 16:36:42

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
0.898	26.1	513
0.902	26.2	509
907	26.2	521

Estatistica

DP Relativo = 1.2 %

TOC Medio = 514.7 ppb

Assinatura

CONDUTIVIDADE



TOC2100 GEHAKA

Numero Serie ...= 21040912001005
Versao Firmware = 2.00.004

11/09/24 16:55:07

Condut. uS/cm	Temp. °C	TOC ppb
2.016	26.0	184
1.752	25.8	206
1.738	26.4	185

Estatistica

Nr. Amostras= 3
TOC Minimo = 184 ppb
TOC Maximo = 206 ppb
Amplitude = 22 ppb
Desv. Padrao= 12.3 ppb
DP Relativo = 6.4 %

TOC Medio = 191.6 ppb

Assinatura