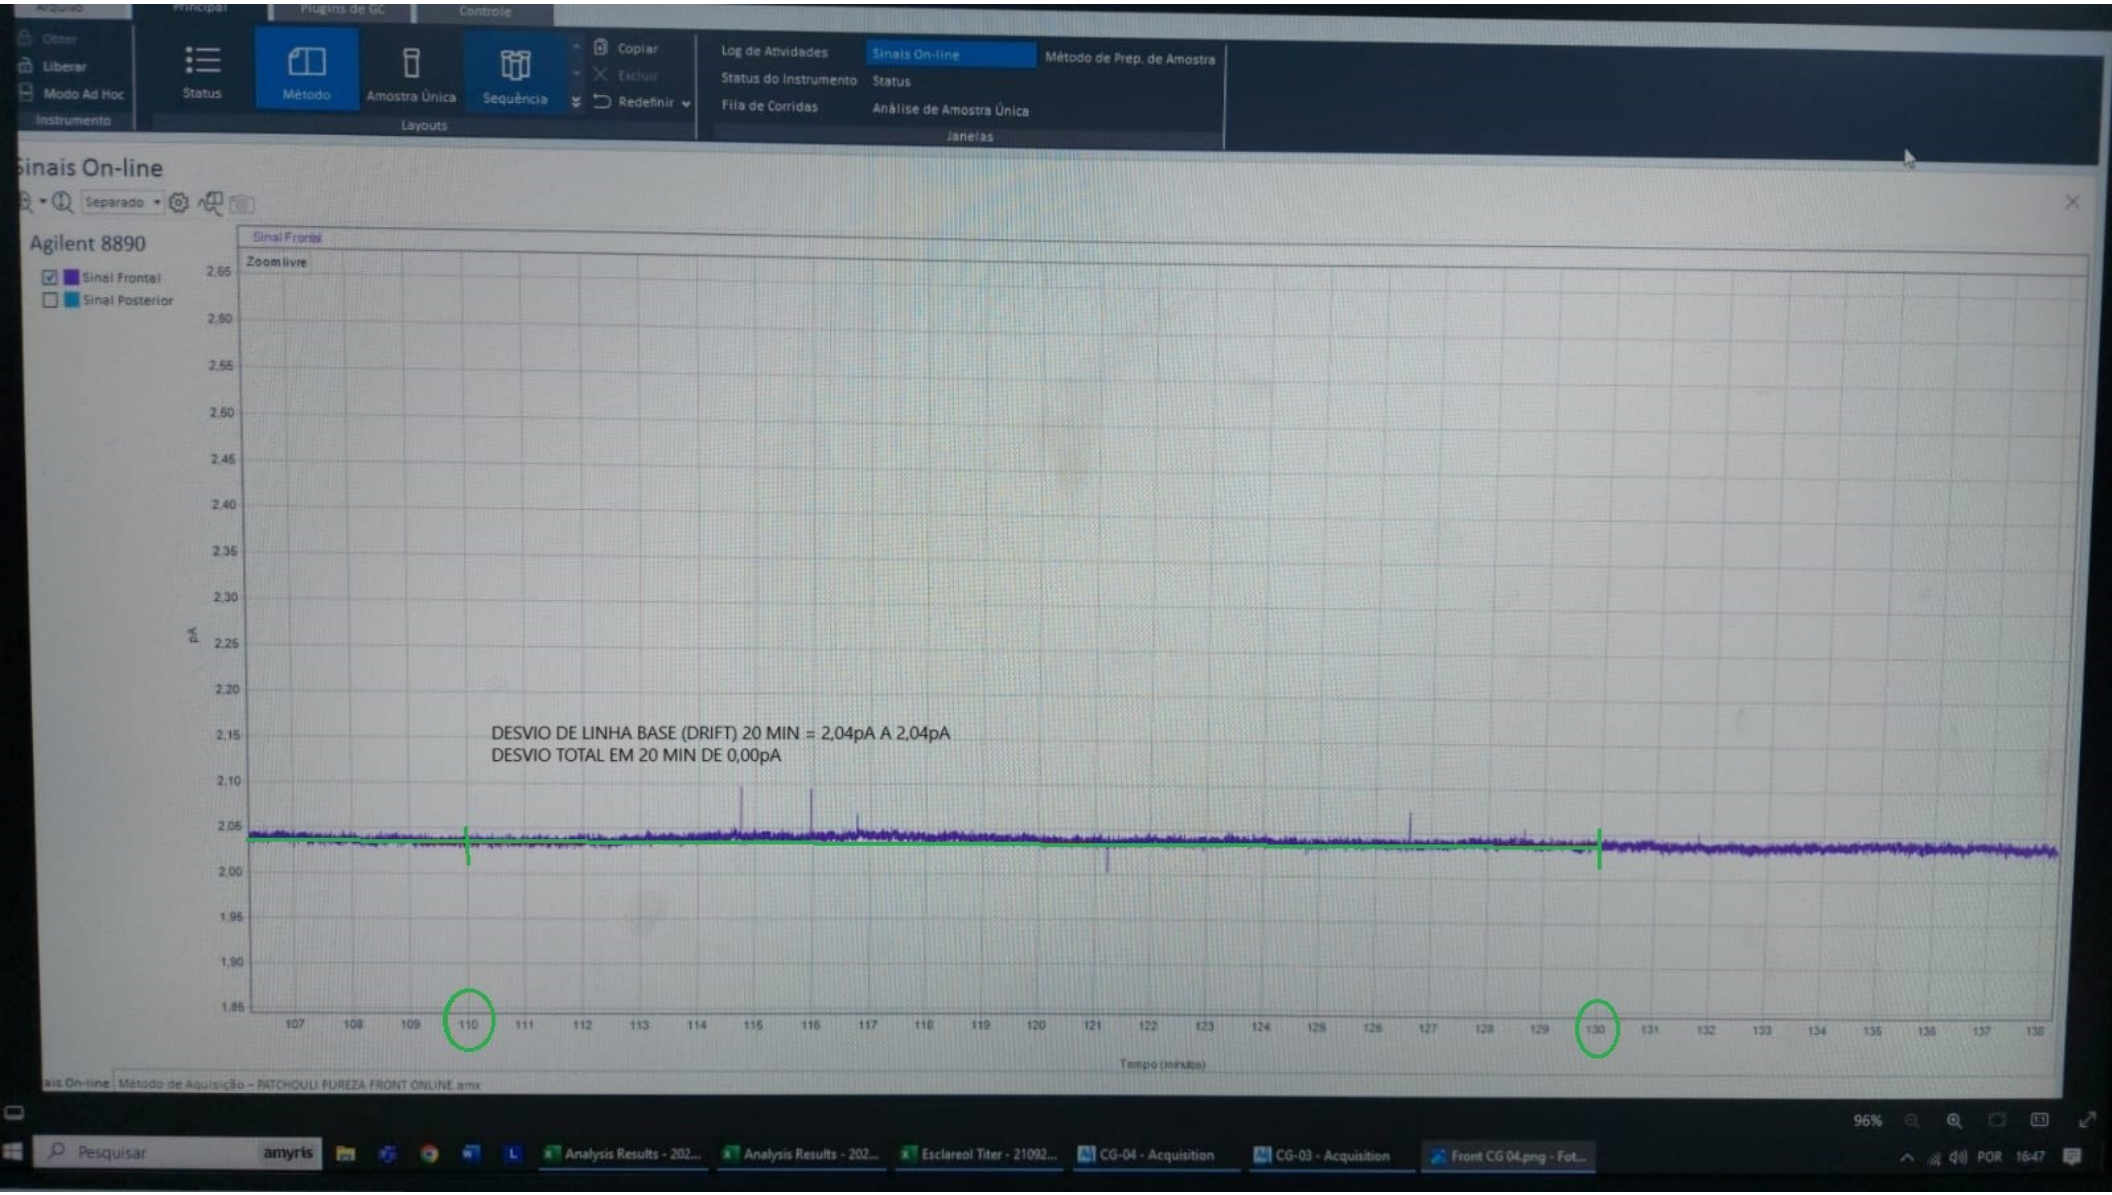
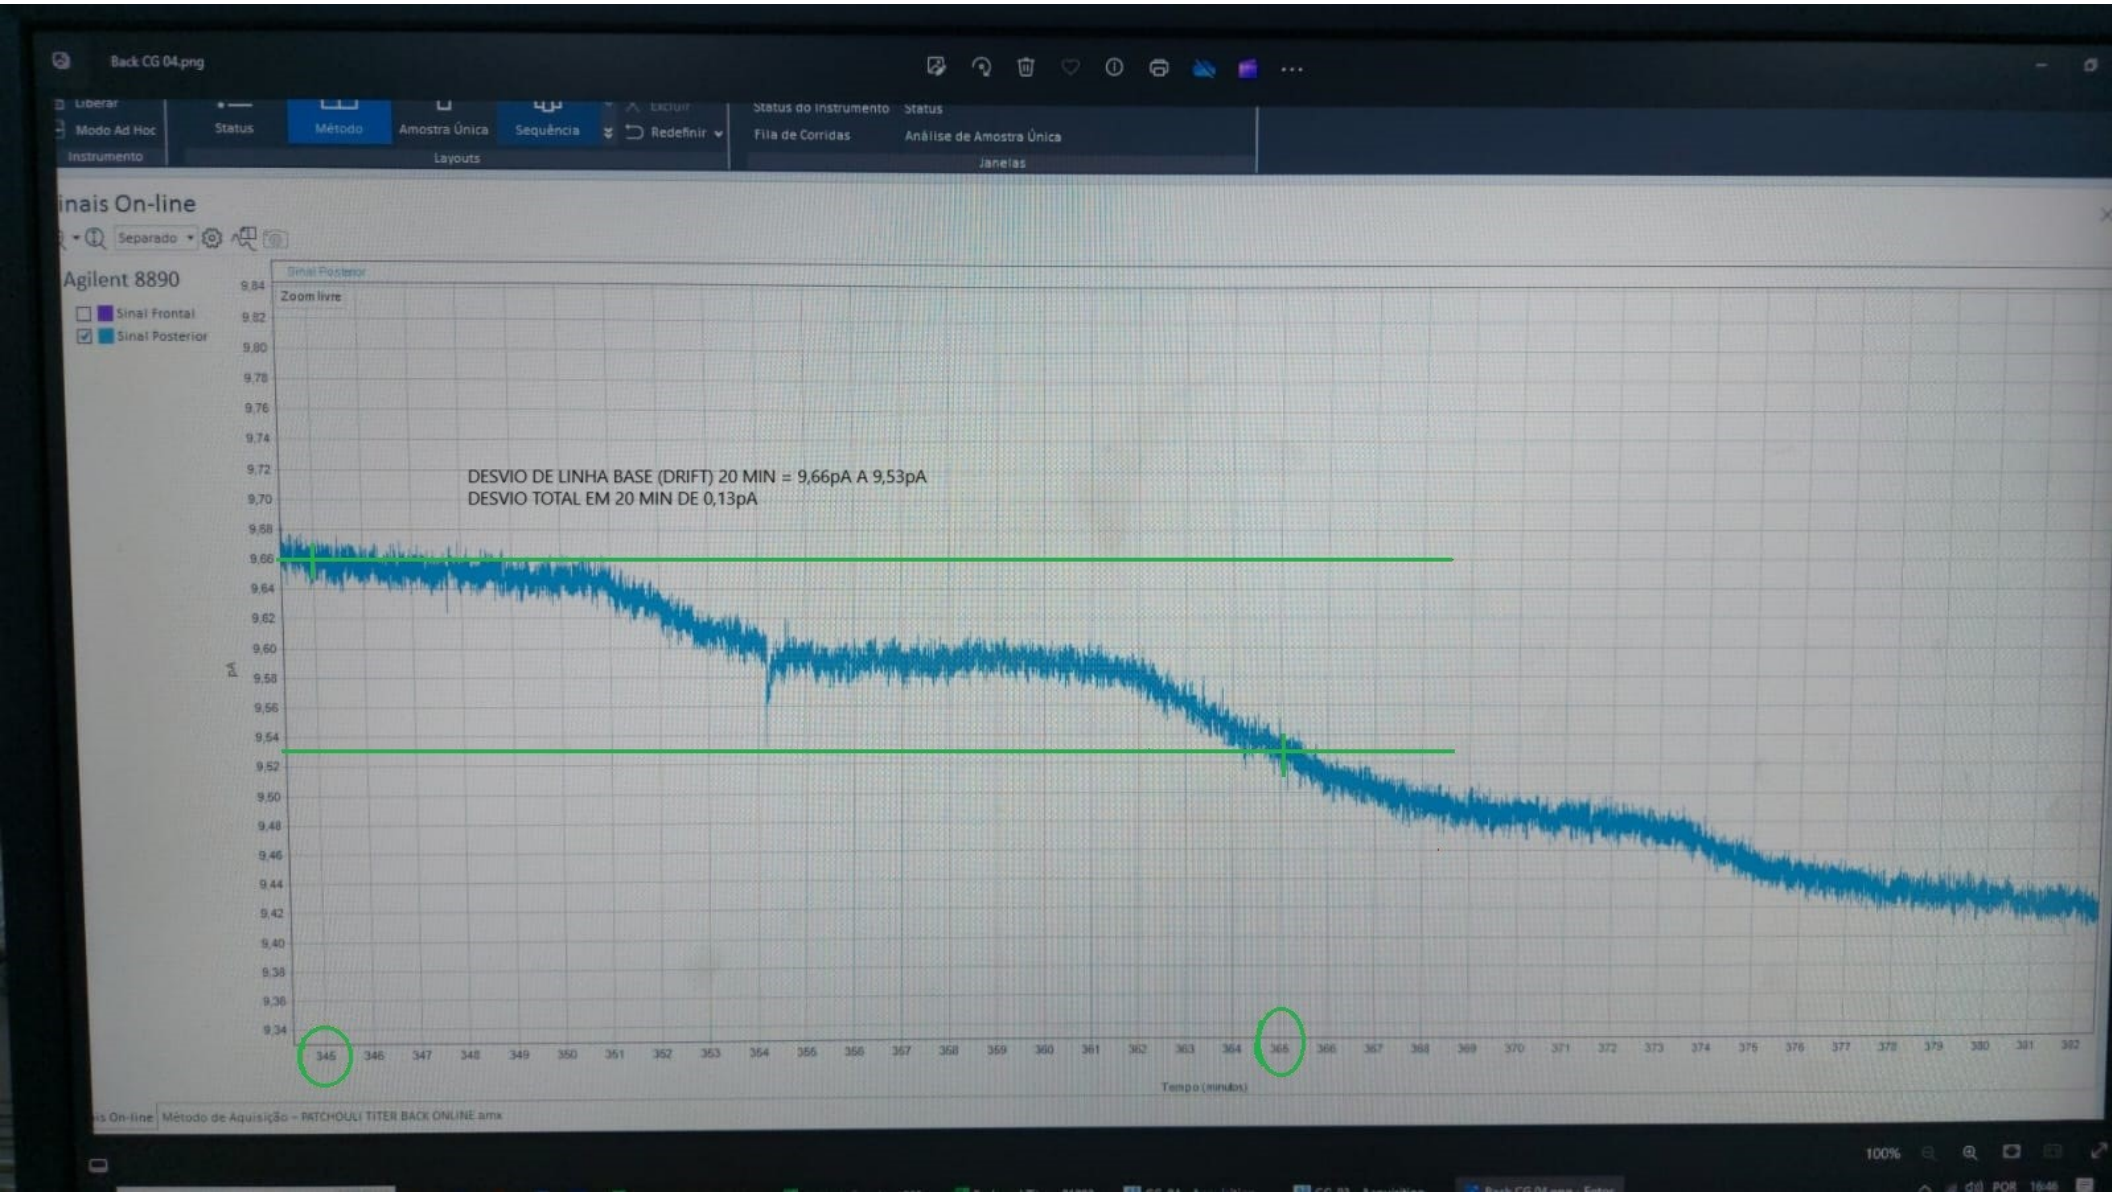

Arquivo
Principal
Plugins de GC
Controle
Obter
Liberar
Modo Ad Hoc
Instrumento
Status
Método
Amostra Única
Sequência
Copiar
Excluir
Redefinir
Layouts
Log de Atividades
Status do Instrumento
Fila de Corridas
Sinais On-line
Status
Análise de Amostra Única
Método de Prep. de Amostra
Janelas
Sinais On-line
Separado
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Sinal Frontal
Zoom livre
RUÍDO DE LINHA BASE DE 2,0435pA A 2,35pA
TOTALIZANDO 0,0085pA
pA
Tempo (minutos)
Seleção de Sinal
Sinais On-line
Método de Aquisição – PATCHOULI PUREZA FRONT ONLINE.amx
Usuário atual: SYSTEM (SYSTEM), Projeto ativo: 2024


Back CG 04 1.png
Instrumento
Obter
Liberar
Modo Ad Hoc
Status
Método
Amostra Única
Sequência
Layouts
Copiar
Excluir
Redefinir
Log de Atividades
Sinais On-line
Método de Prep. de Amostra
Status do Instrumento
Status
Fila de Corridas
Análise de Amostra Única
Janelas
Sinais On-line
Separado
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Sinal Posterior
Zoom livre
RUÍDO DE LINHA BASE DE 9,441pA A 9,420pA
TOTALIZANDO
0,021pA
pA
Seleção de Sinal
Tempo (minutos)
Sinais On-line
Método de Aquisição – PATCHOULI TITER BACK ONLINE.amx
98%
Pesquisar
amyris
Analysis Results - 202...
Analysis Results - 202...
Esclareol Titer - 21092...
CG-04 - Acquisition
CG-03 - Acquisition
Back CG 04 1.png - F...


Liberar
Modo Ad Hoc
Instrumento
Status
Método
Amostra Única
Sequência
Copiar
Excluir
Redefinir
Layouts
Log de Atividades
Sinais On-line
Método de Prep. de Amostra
Status do Instrumento
Status
Fila de Corridas
Análise de Amostra Única
Janelas
Sinais On-line
Separado
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Sinal Frontal
Zoom livre
pA
DESVIO DE LINHA BASE (DRIFT) 20 MIN = 2,04pA A 2,04pA
DESVIO TOTAL EM 20 MIN DE 0,00pA
Tempo (minutos)
Método de Aquisição – PATCHOULI PUREZA FRONT ONLINE.amx
96%
Pesquisar
amyris
Analysis Results - 202...
Analysis Results - 202...
Esclareol Titer - 21092...
CG-04 - Acquisition
CG-03 - Acquisition
Front CG 04.png - Fot...
POR
16:47


Back CG 04.png
Liberar
Modo Ad Hoc
Instrumento
Status
Método
Amostra Única
Sequência
Redefinir
Layouts
Status do Instrumento
Status
Fila de Corridas
Análise de Amostra Única
Janelas
inais On-line
Separado
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Sinal Posterior
Zoom livre
DESVIO DE LINHA BASE (DRIFT) 20 MIN = 9,66pA A 9,53pA
DESVIO TOTAL EM 20 MIN DE 0,13pA
pA
Tempo (minutos)
Método de Aquisição – PATCHOULI TITER BACK ONLINE.amx
100%