



EDUV - DETECTOR VWD – G 4290B – DECAD00125

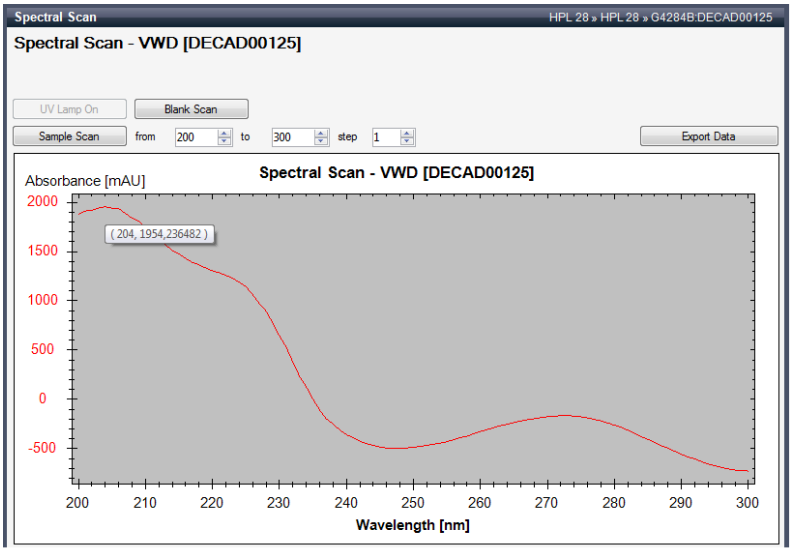


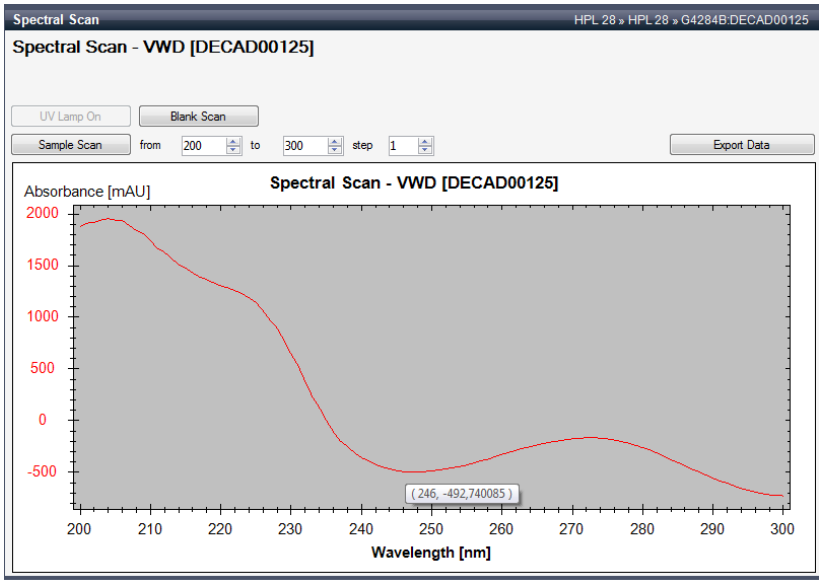


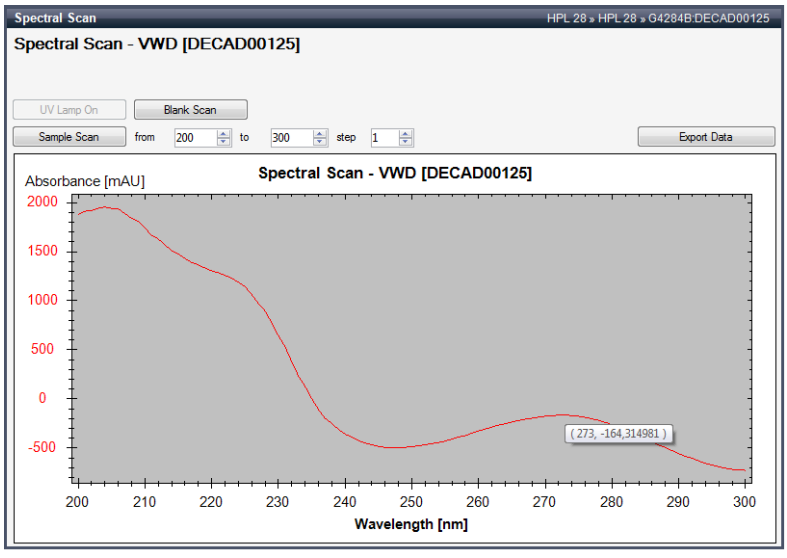

EDUV - DETECTOR DAD – G 1316B – DE30517791

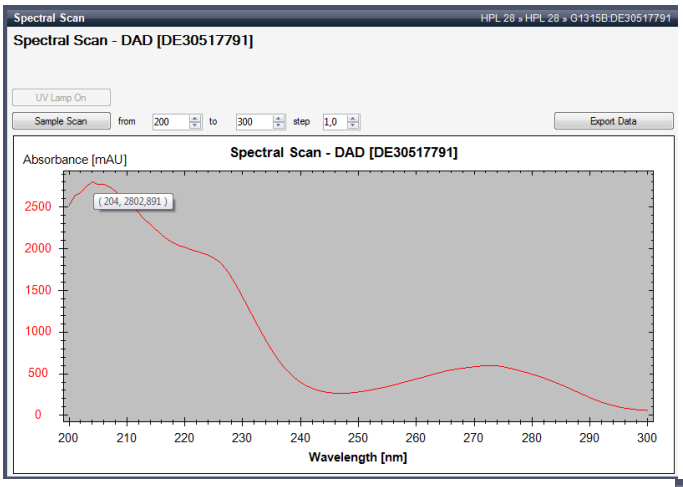

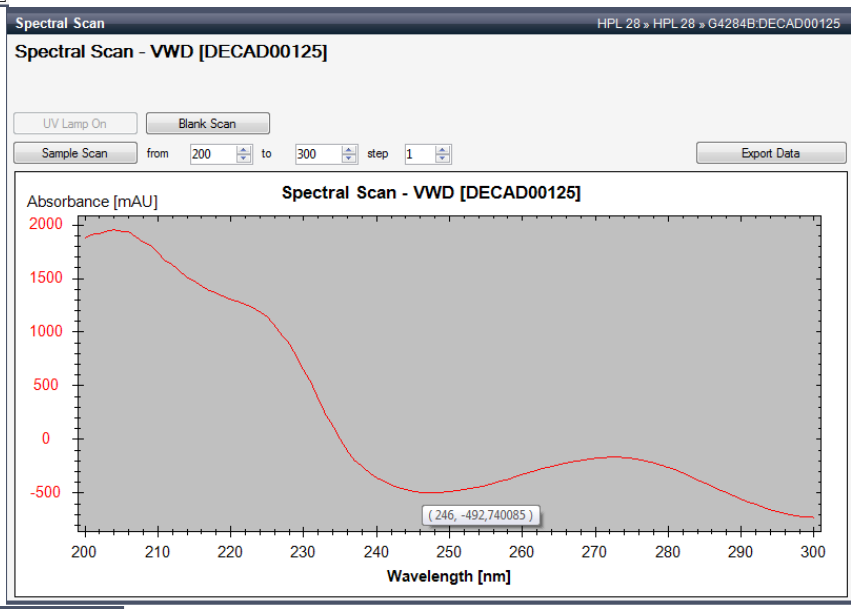


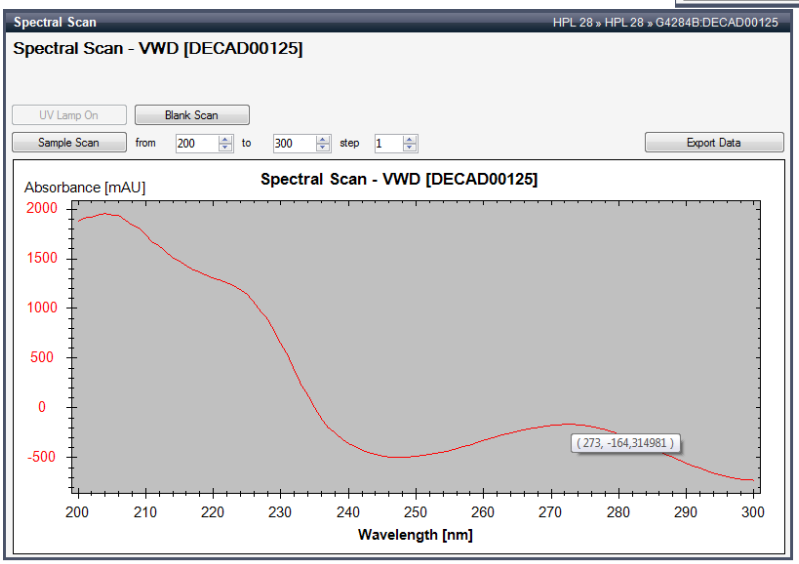

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO 01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 01_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 11:47:49 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:08:42 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: BRANCO 01
Vial: 2 Volume: 10 µL

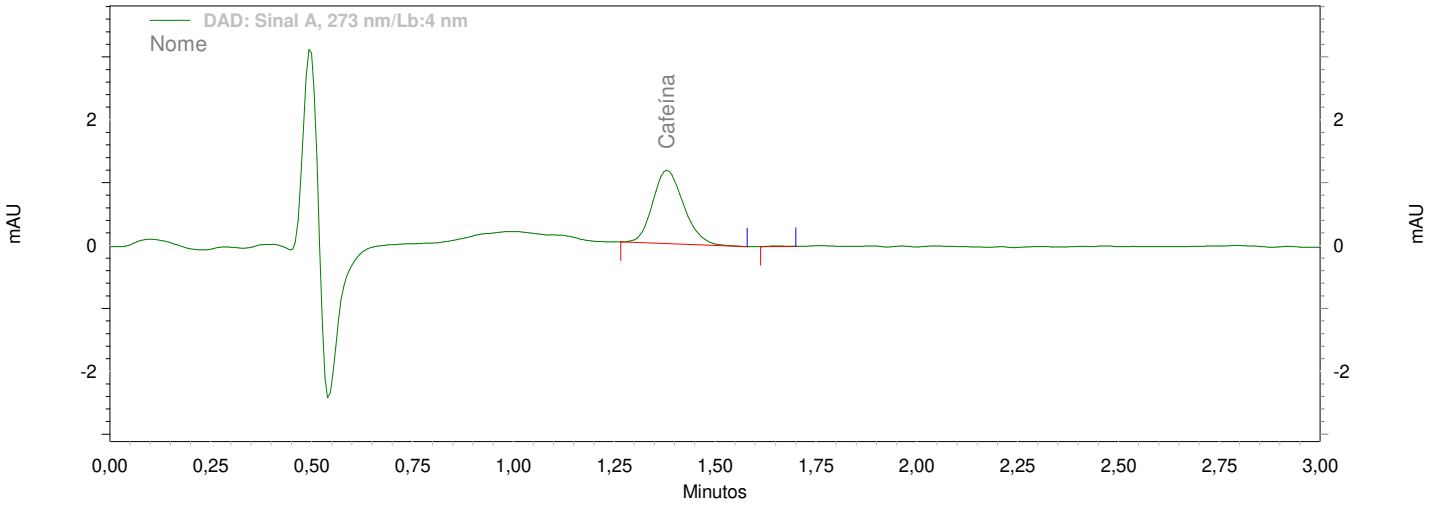

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area
Cafeína	1,380	13021
	1,653	33
Totais		13054

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 01_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 11:52:00 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:12:03 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 01
Vial: 3 Volume: 10 µL

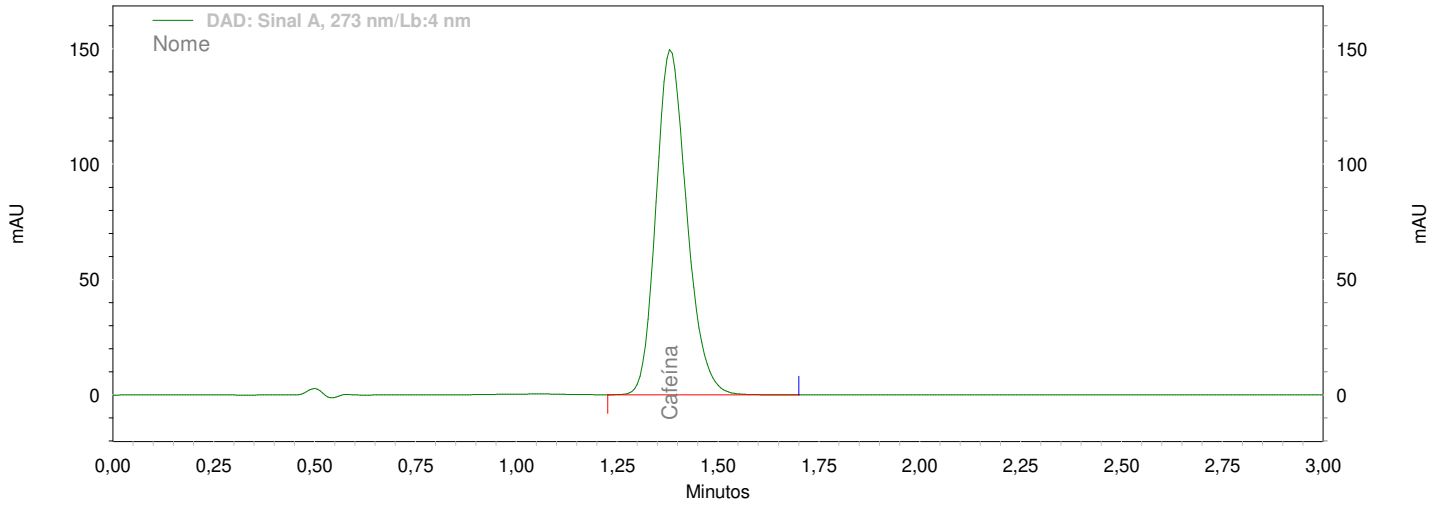

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,380	1668474	**314026**

Totais		1668474	**314026**

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 02_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 11:56:15 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:13:08 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 02
Vial: 3 Volume: 10 µL

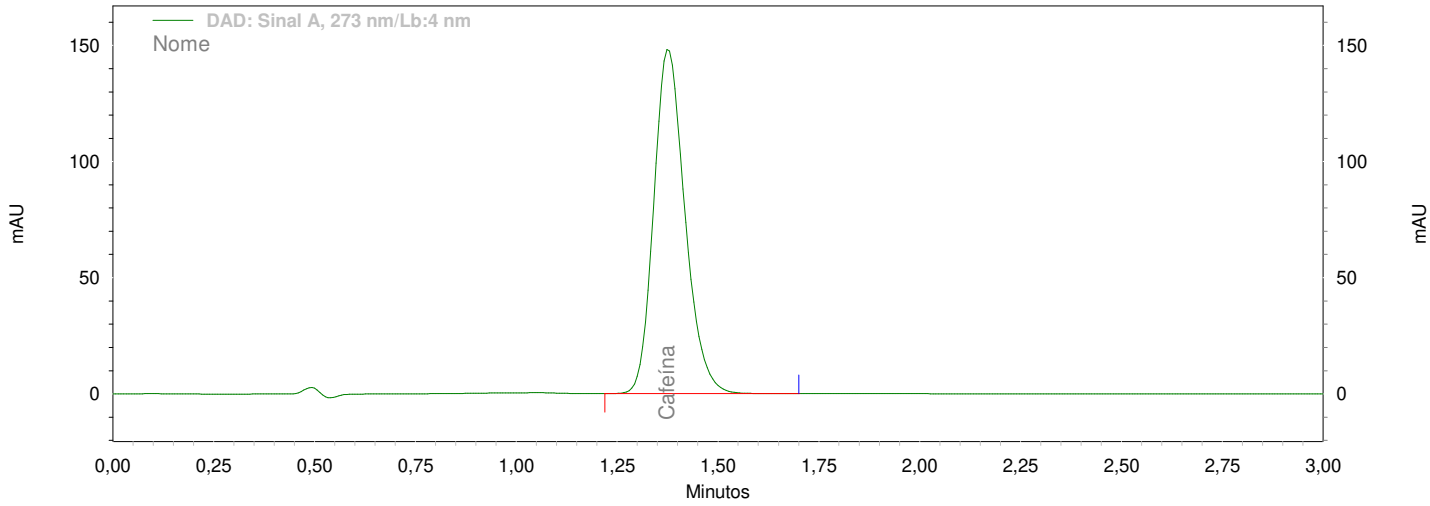

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,373	1671725	**310870**

Totais		1671725	**310870**

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 03_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:00:27 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:17:15 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 03
Vial: 3 Volume: 10 µL

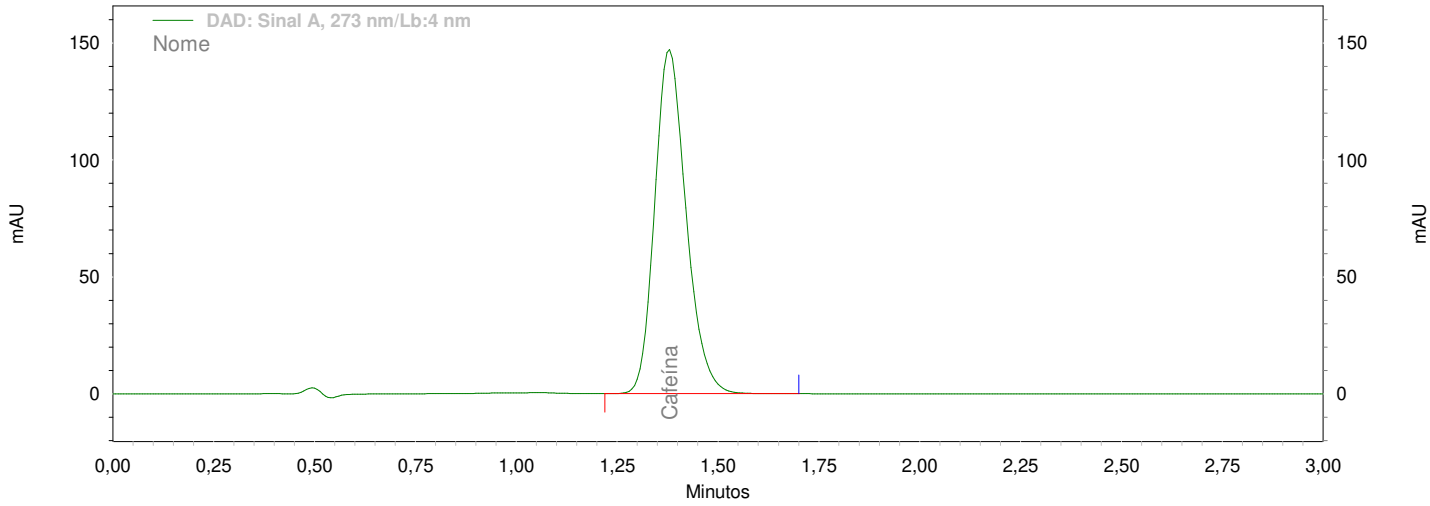

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,380	1671154	**308644**
Totais		1671154	**308644**

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO 02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 02_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:04:41 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:18:32 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: BRANCO 02
Vial: 2 Volume: 10 µL

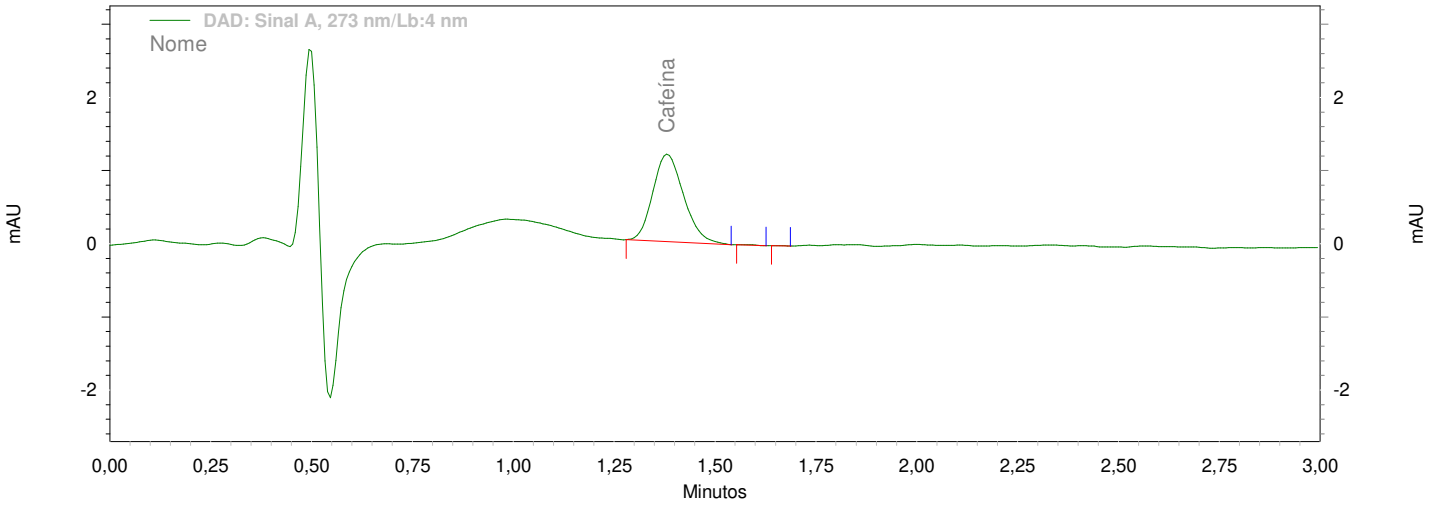

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,380	13326	**2509**
	1,580	34	**17**
	1,667	11	**7**
Totais		13371	**2533**

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 04_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:08:55 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:18:57 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 04
Vial: 3 Volume: 10 µL

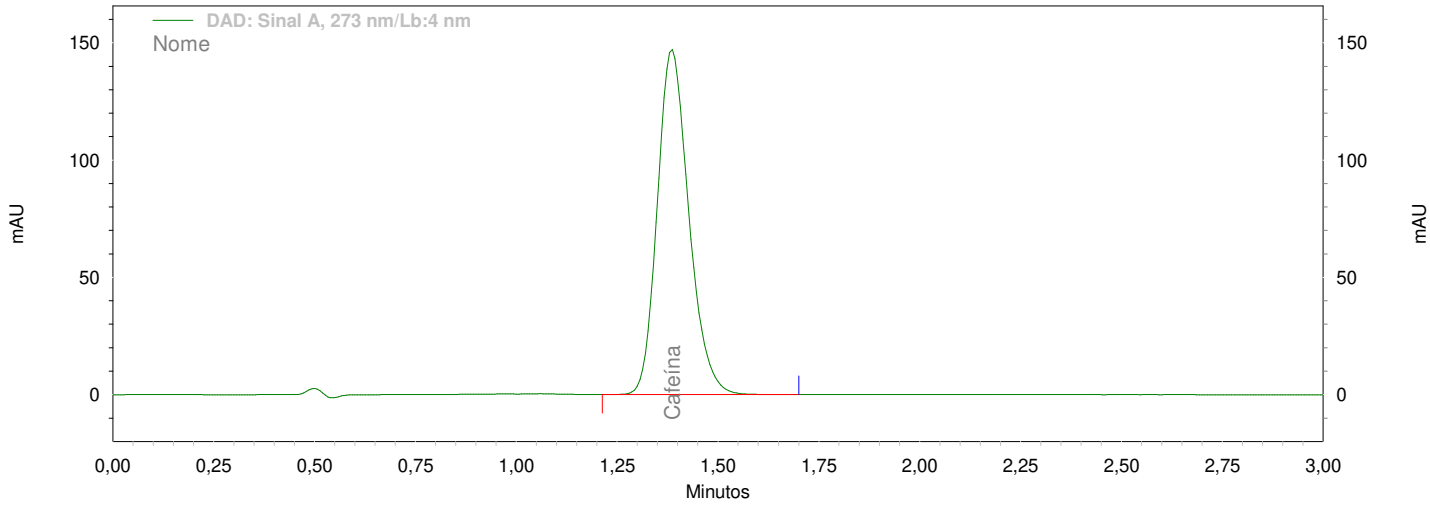

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,387	1675782	**308673**

Totais		1675782	**308673**

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 05_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:13:05 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:22:27 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 05
Vial: 3 Volume: 10 µL

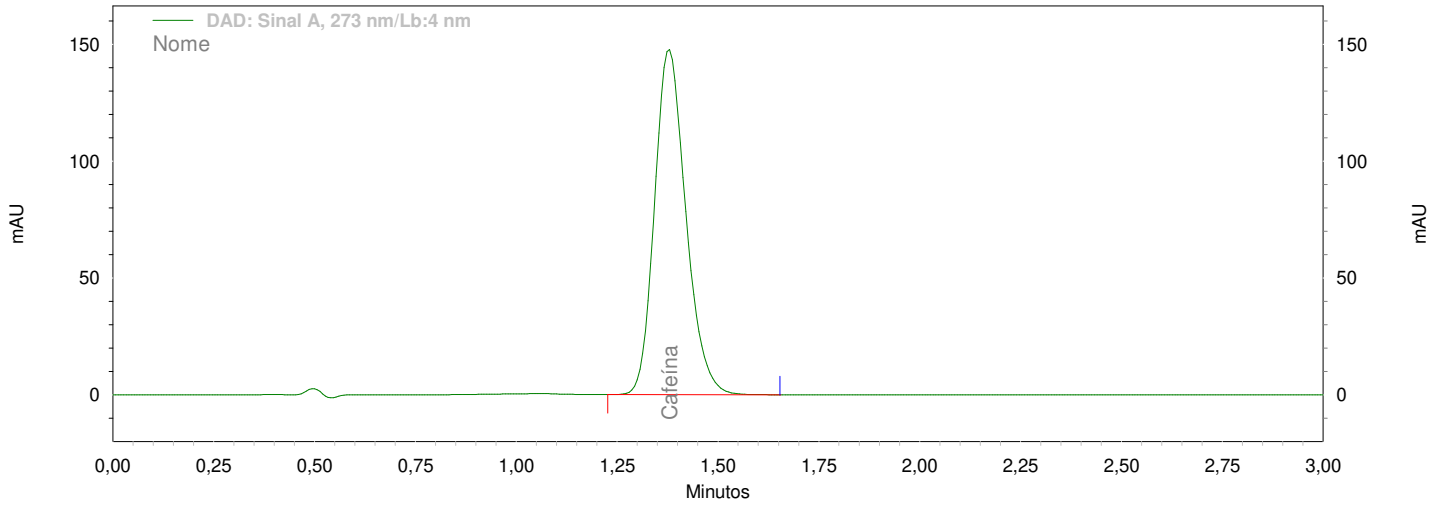

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,380	1672997	**309884**
Totais		1672997	**309884**

Teste de Precisão do Injetor - PCIN 06

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\PCIN 06_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:17:18 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:23:20 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: PCIN 06
Vial: 3 Volume: 10 µL

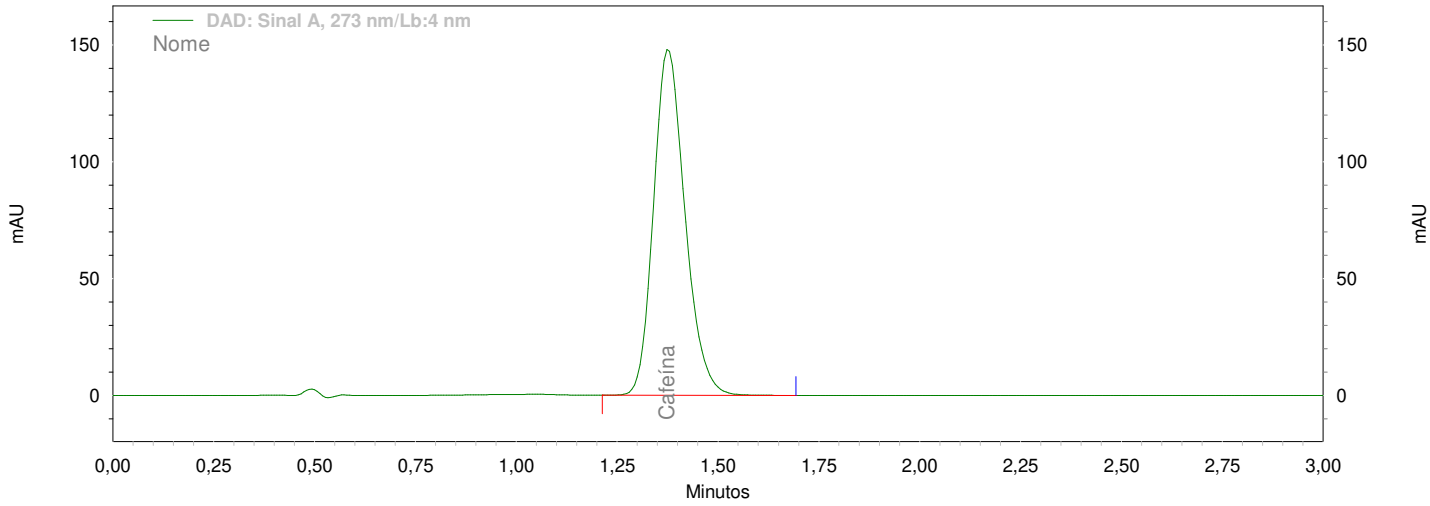

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,373	1681947	**310601**

Totais		1681947	**310601**

Teste de Precisão do Injetor - BRANCO 03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\BRANCO 03_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:21:33 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:25:12 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: BRANCO 03
Vial: 2 Volume: 10 µL

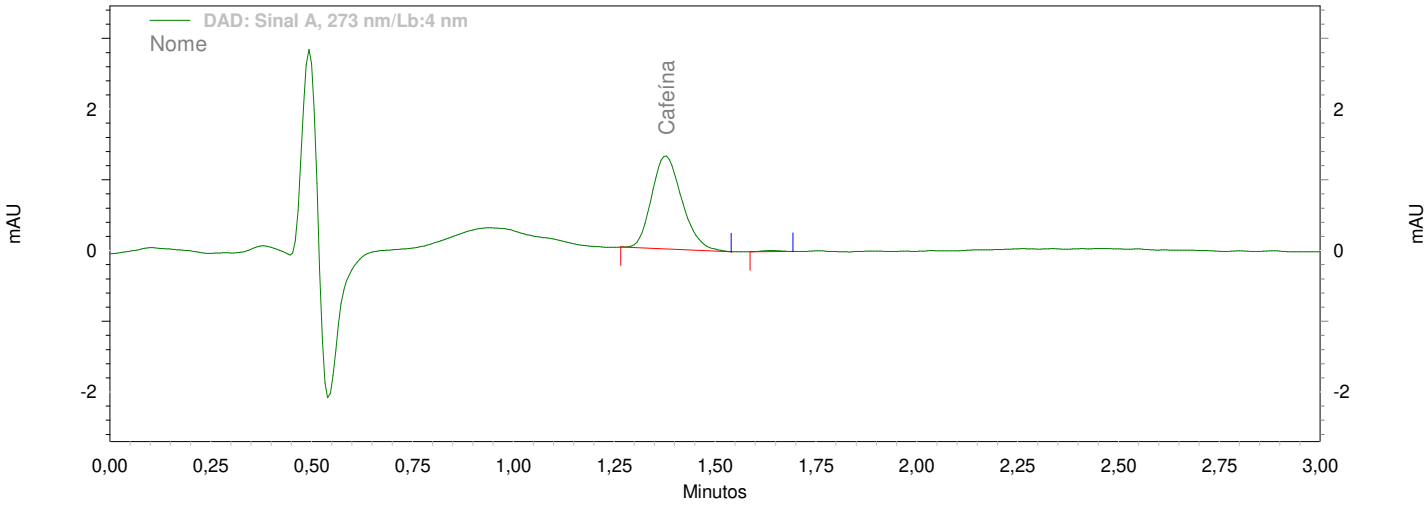

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
Cafeína	1,380	14456	**2753**
	1,640	110	**33**
Totais		14566	**2786**

Teste de Precisão do Injetor - LDUV 01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:25:47 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:00:27 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LDUV 01
Vial: 4 Volume: 10 µL

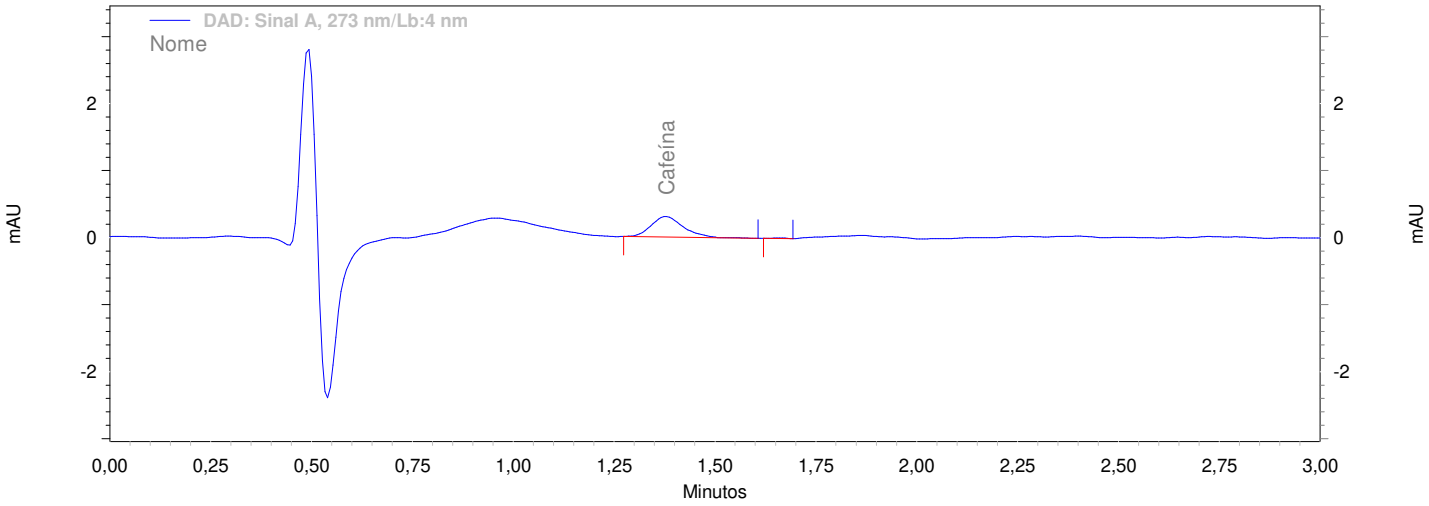

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,380	3594	0,000
	1,653	37	0,000

Totais		3631	0,000

Teste de Precisão do Injetor - LDUV 02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:30:01 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:59:36 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LDUV 02
Vial: 5 Volume: 10 µL

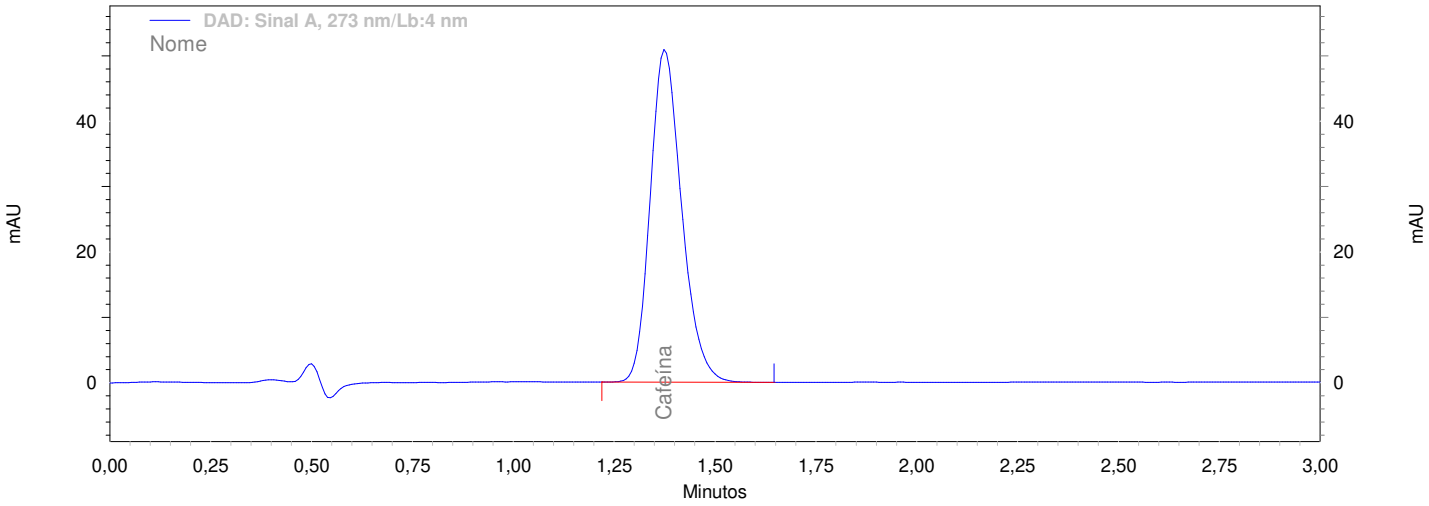

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,373	579694	0,000

Totais		579694	0,000

Teste de Precisão do Injetor - LDUV 03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LDUV 03_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:34:14 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 15:59:13 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LDUV 03
Vial: 6 Volume: 10 µL

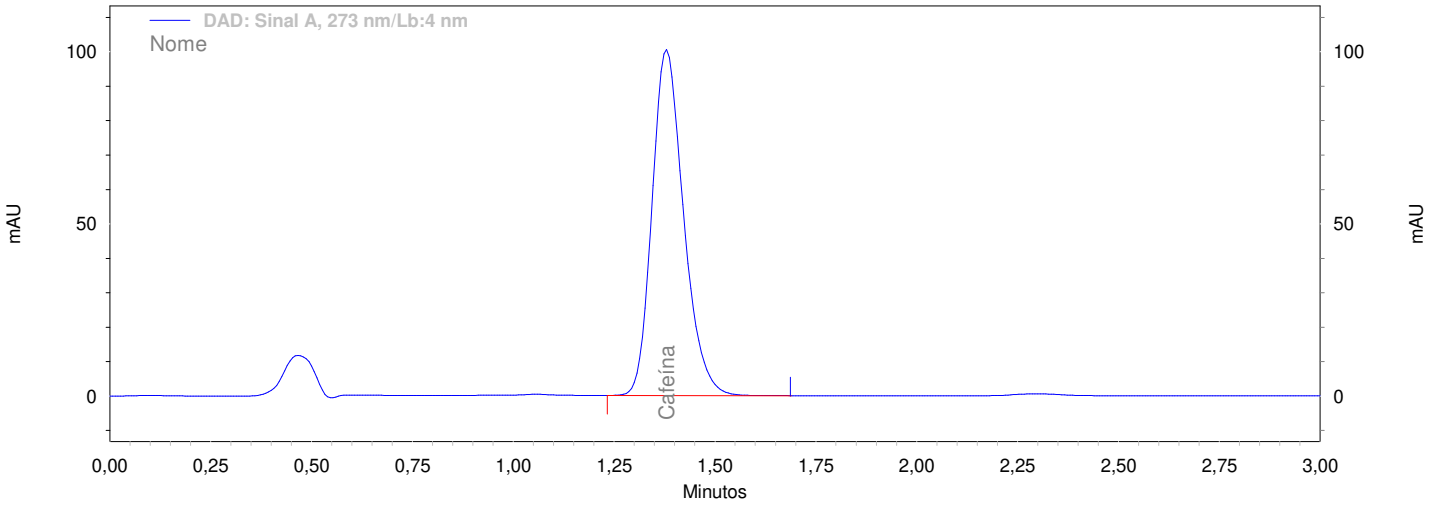

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,380	1146308	0,000

Totais		1146308	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LDUV 04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LDUV 04_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:38:28 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:11:29 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LDUV 04
Vial: 7 Volume: 10 µL

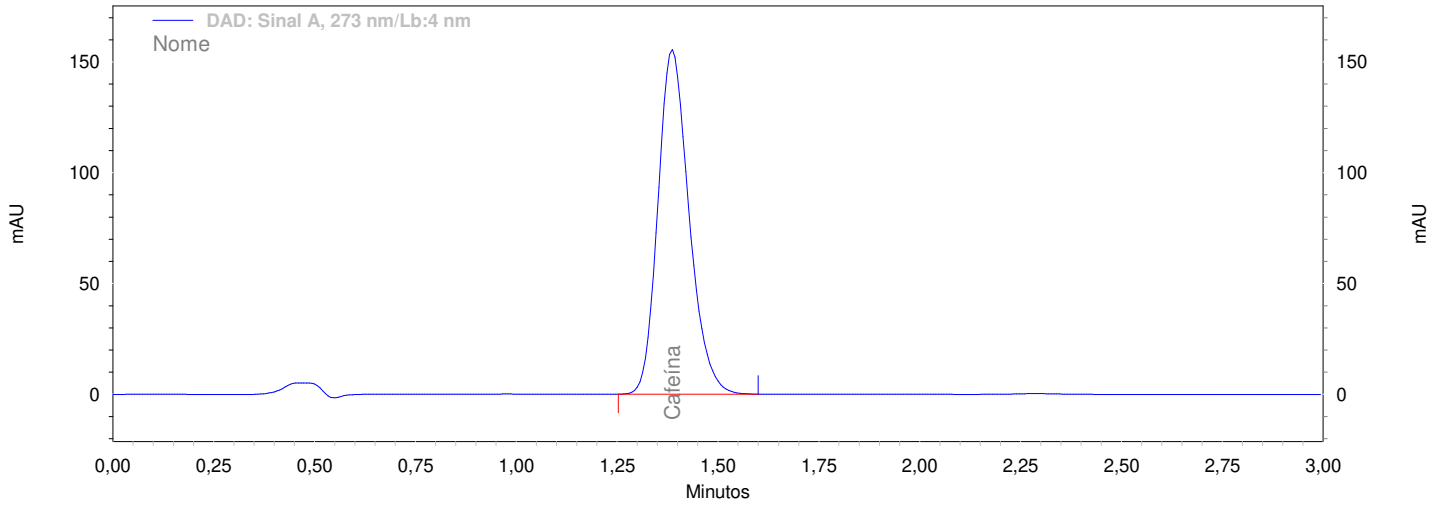

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,387	1750129	0,000

Totais		1750129	0,000

Teste de Linearidade do Detector - LDUV 05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 12:42:43 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:13:13 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LDUV 05
Vial: 8 Volume: 10 µL

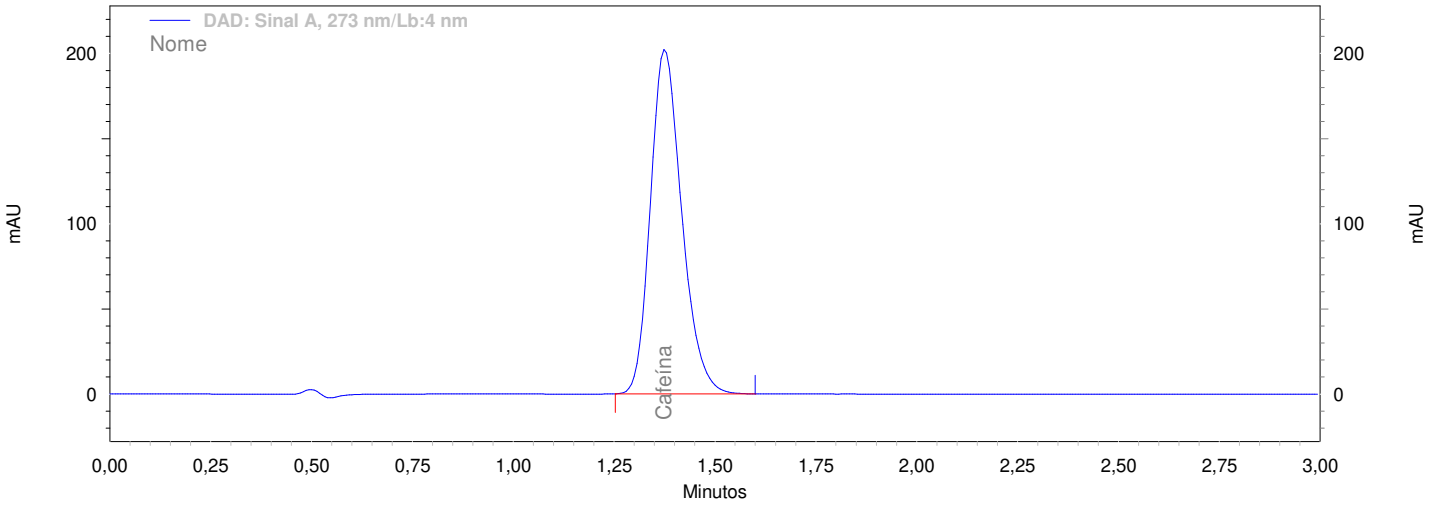

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,373	2292742	0,000

Totais		2292742	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LIIN 01_019.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 13:39:12 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:13:41 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LIIN 01
Vial: 9 Volume: 0 µL

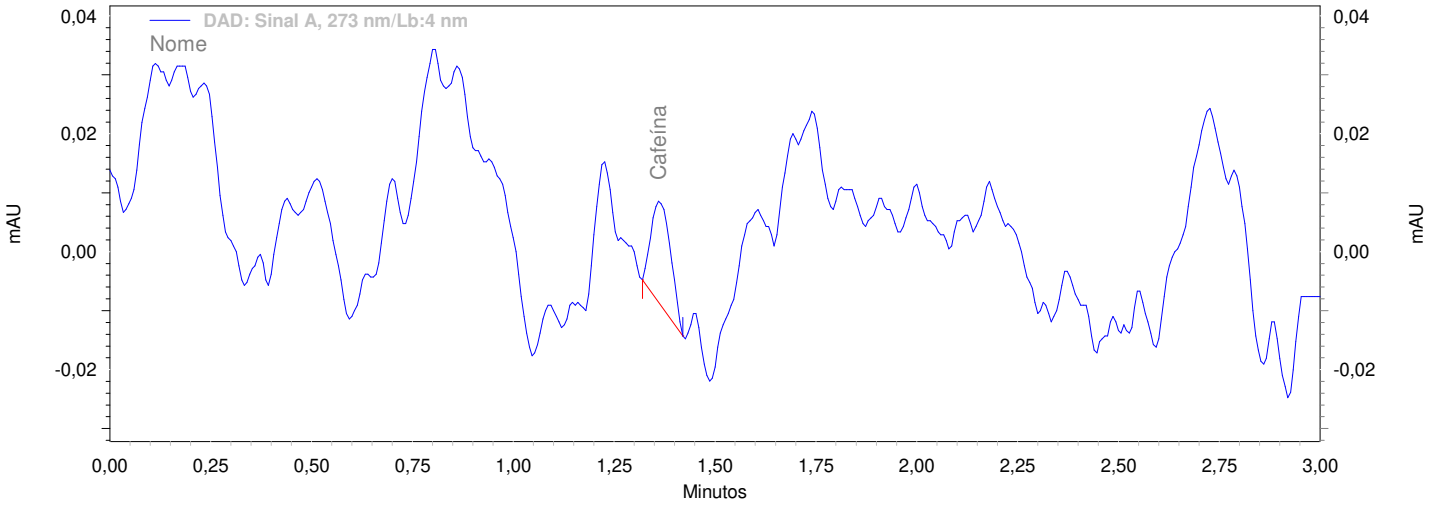

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,360	125	0,000

Totais		125	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LIIN 02_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 13:59:54 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:13:59 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LIIN 02
Vial: 9 Volume: 5 µL

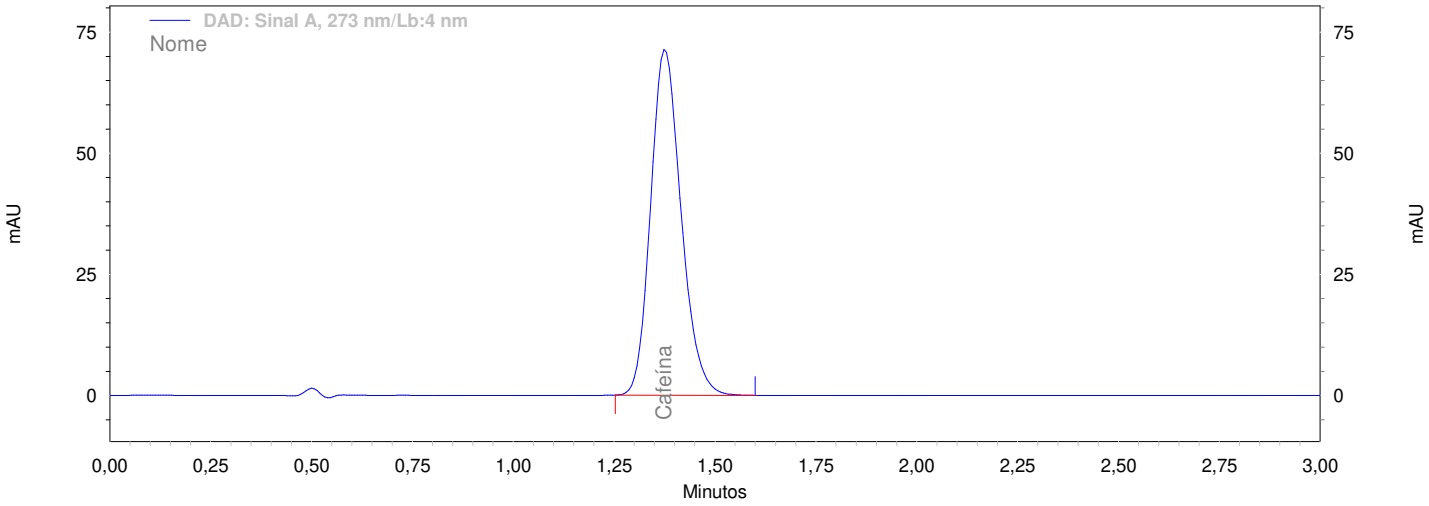

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,373	785888	0,000

Totais		785888	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LIIN 03_021.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 14:04:08 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:14:34 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LIIN 03
Vial: 9 Volume: 10 µL

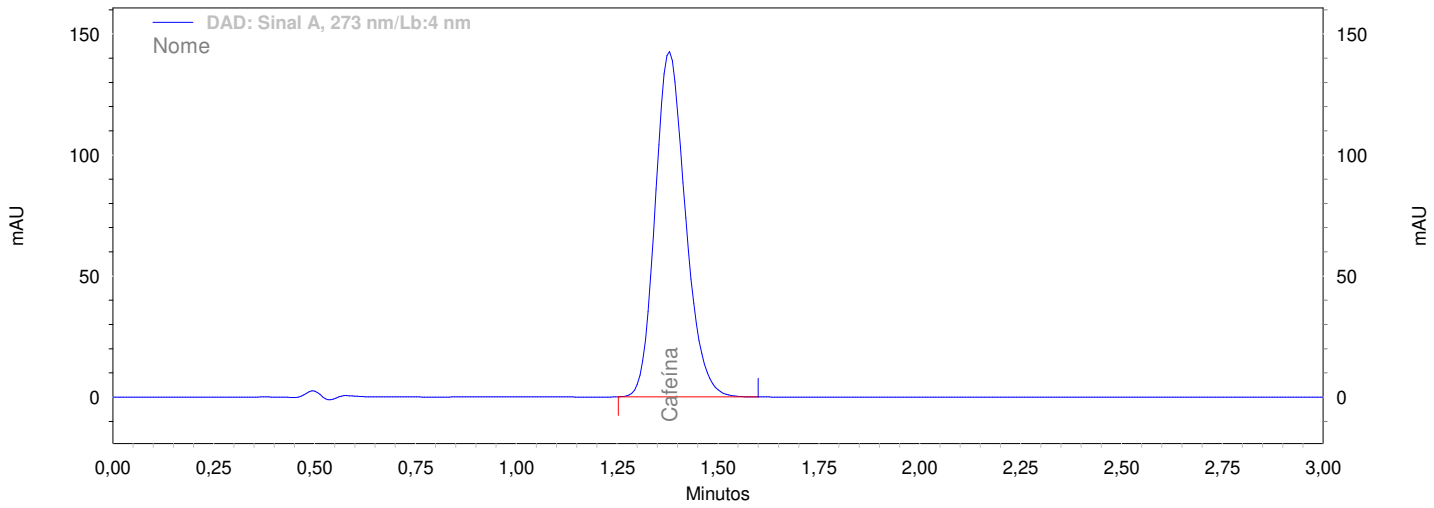

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,380	1560614	0,000

Totais		1560614	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LIIN 04_022.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 14:08:25 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:15:12 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LIIN 04
Vial: 9 Volume: 15 µL

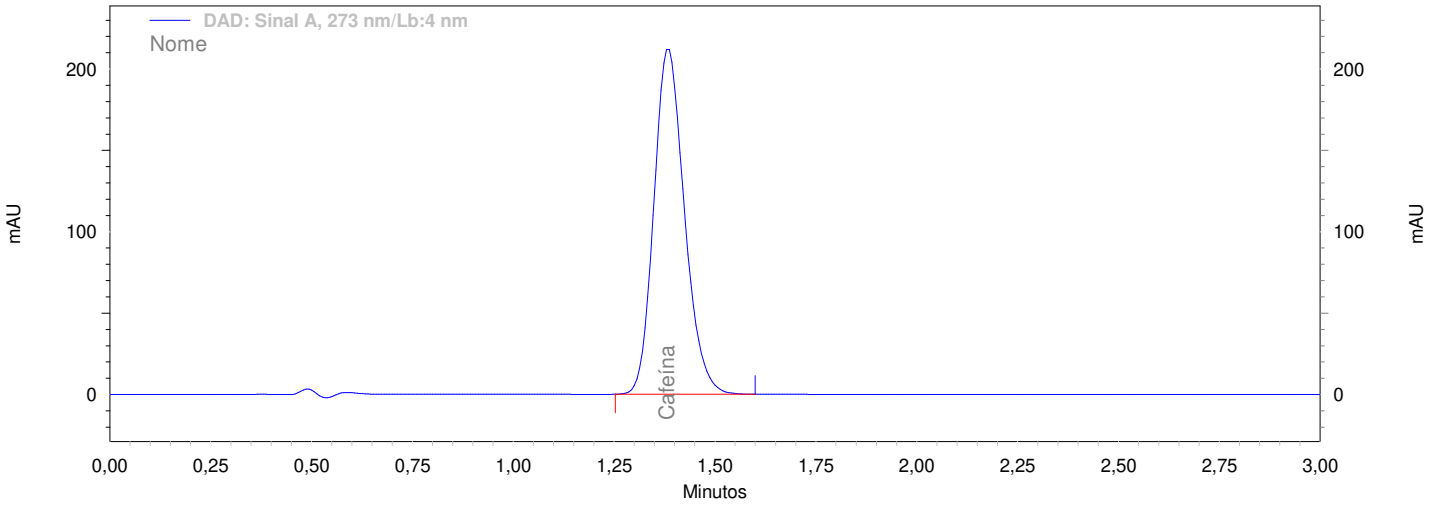

Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,380	2347017	0,000

Totais		2347017	0,000

Teste de Linearidade do Injetor - LIIN 05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-26 14-43-11 (GMT -03-00).rslt\LIIN 05_023.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 26/09/2024 14:12:45 (GMT -03:00)
Impresso: 26/09/2024 16:18:14 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 (Off-line) Amostra: LIIN 05
Vial: 9 Volume: 20 µL

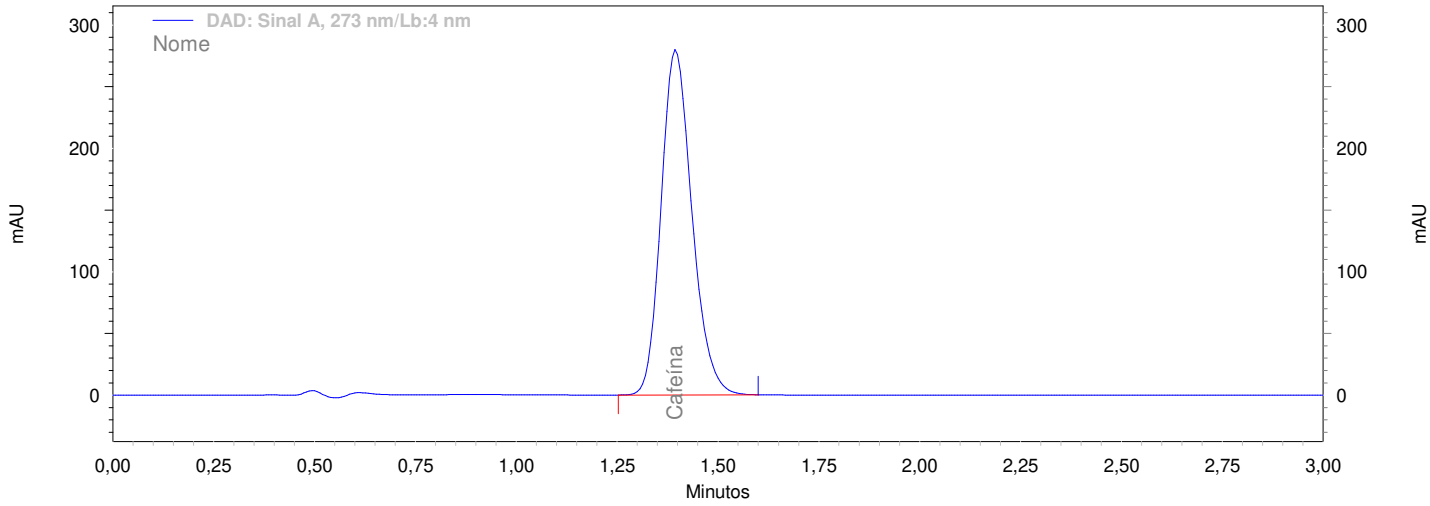

Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,393	3123722	0,000


Totais		3123722	0,000

Teste de Sinal Ruído da Linha de Base - RELB


Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\RELB.met
Data: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-27 08-47-02 (GMT -03:00).rslt\RELB_017.dat
Usuário: QPackSA (QPackSA)
Adquirido: 26/09/2024 12:47:10 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:04:19 (GMT -03:00)
TAG: HPL28 (Off-line) **Amostra:** RELB
Vial: 10 **Volume:** 20 L

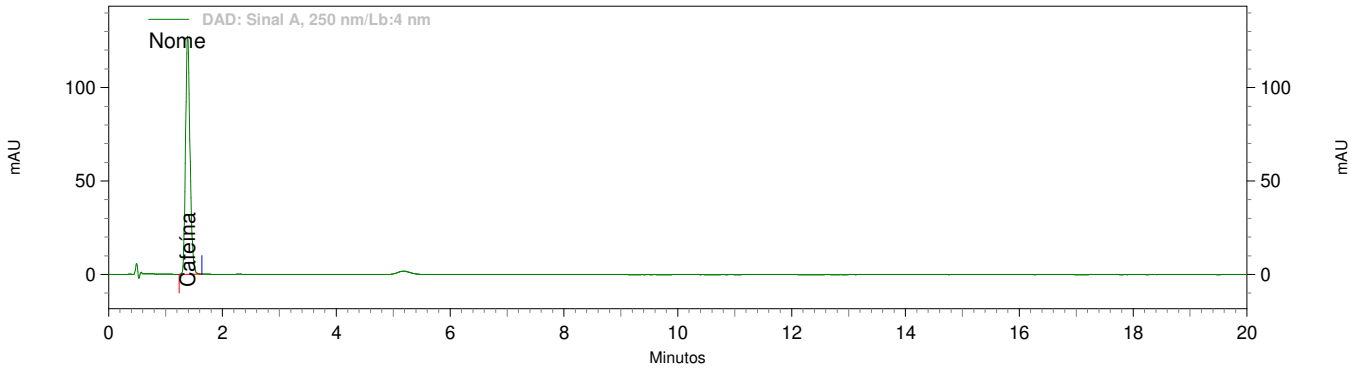

ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE

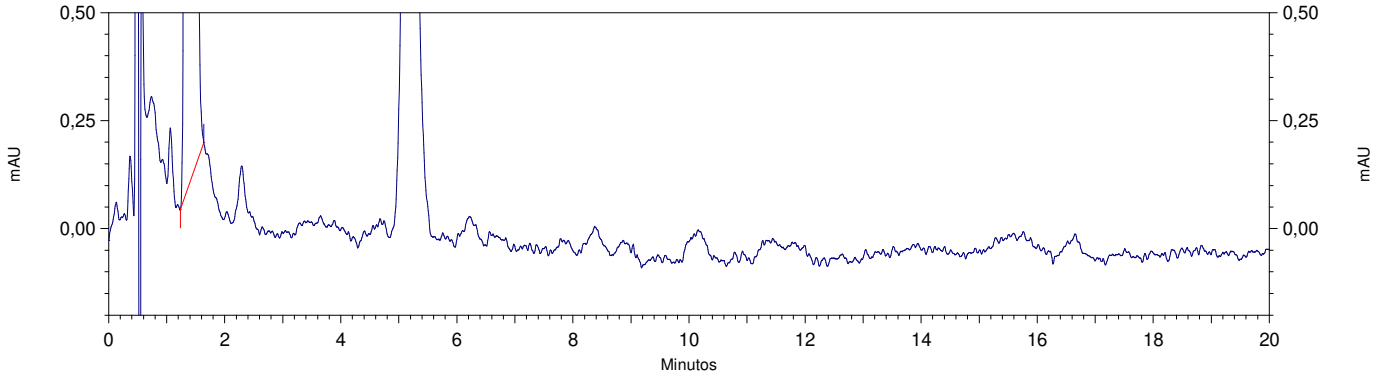


RUÍDO

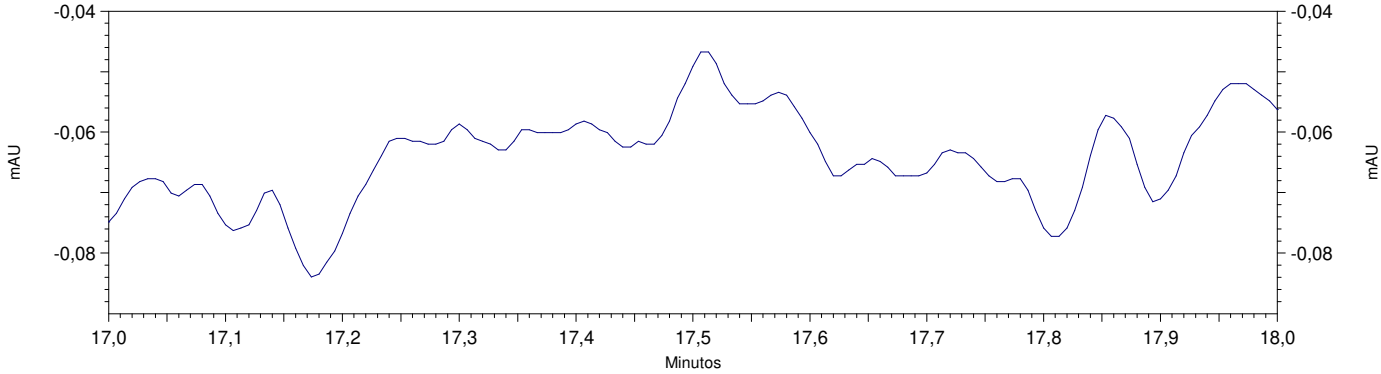

Teste de Sinal Ruído da Linha de Base - RELB

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\RELB.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28 (Off-line).39 2024-09-27 08-47-02 (GMT -03-00).rslt\RELB_017.dat**
Usuário: **QPackSA (QPackSA)**
Adquirido: **26/09/2024 12:47:10 (GMT -03:00)**
Impresso: **27/09/2024 09:04:19 (GMT -03:00)**
TAG: **HPL28 (Off-line)** **Amostra:** **RELB**
Vial: **10** **Volume:** **20 L**

ALTURA DO PICO

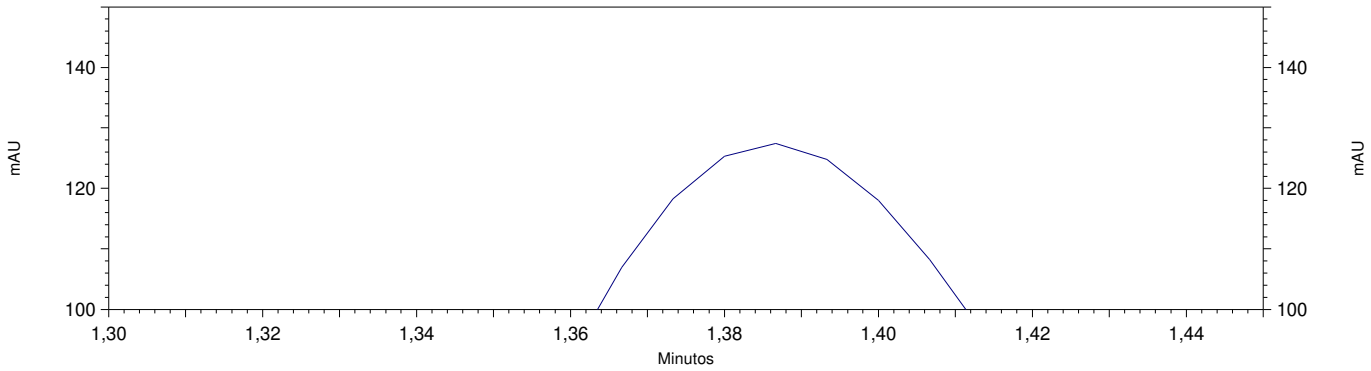

Resultados DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,387	1455275	267008

Totais			1455275	267008

Teste de Exatidão do Detector - LDUV 01

Arquivo de Dados: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 01_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 27/09/2024 08:14:27 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:30:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: LDUV 01
Vial: 4 Volume: 10 µL

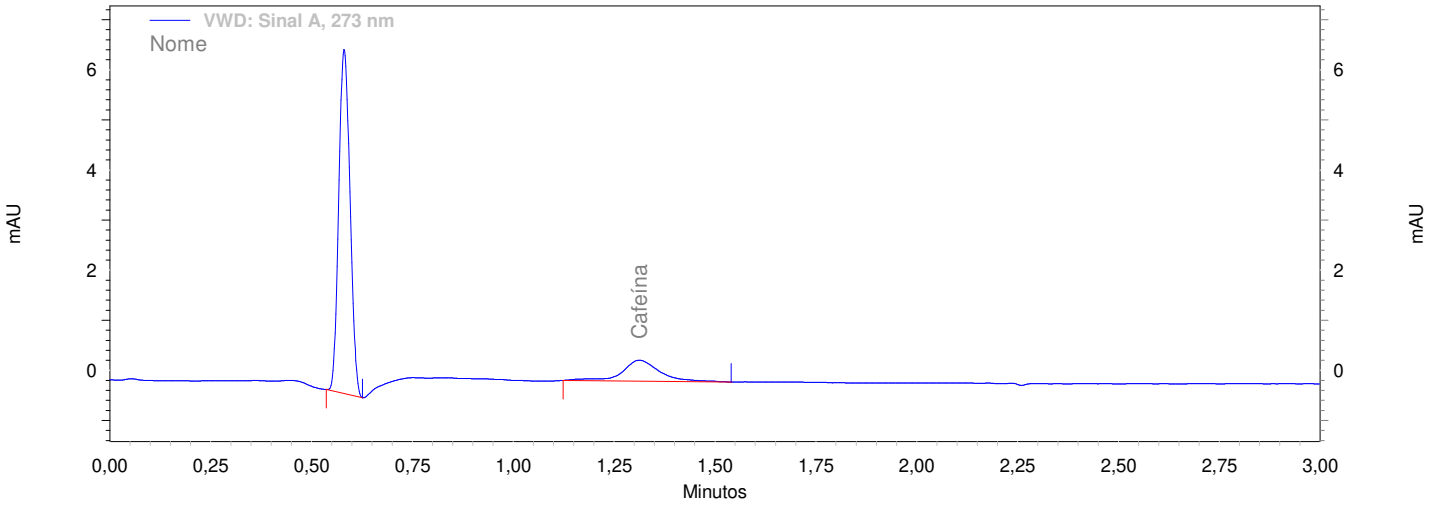

Channel A

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm


Name	Time	Area	Amount
	0,580	224647	0,000
Cafeína	1,312	45472	0,000

Totais		270119	0,000

Teste de Exatidão do Detector - LDUV 02

Arquivo de Dados: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 02_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 27/09/2024 08:18:42 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:26:39 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: LDUV 02
Vial: 5 Volume: 10 µL

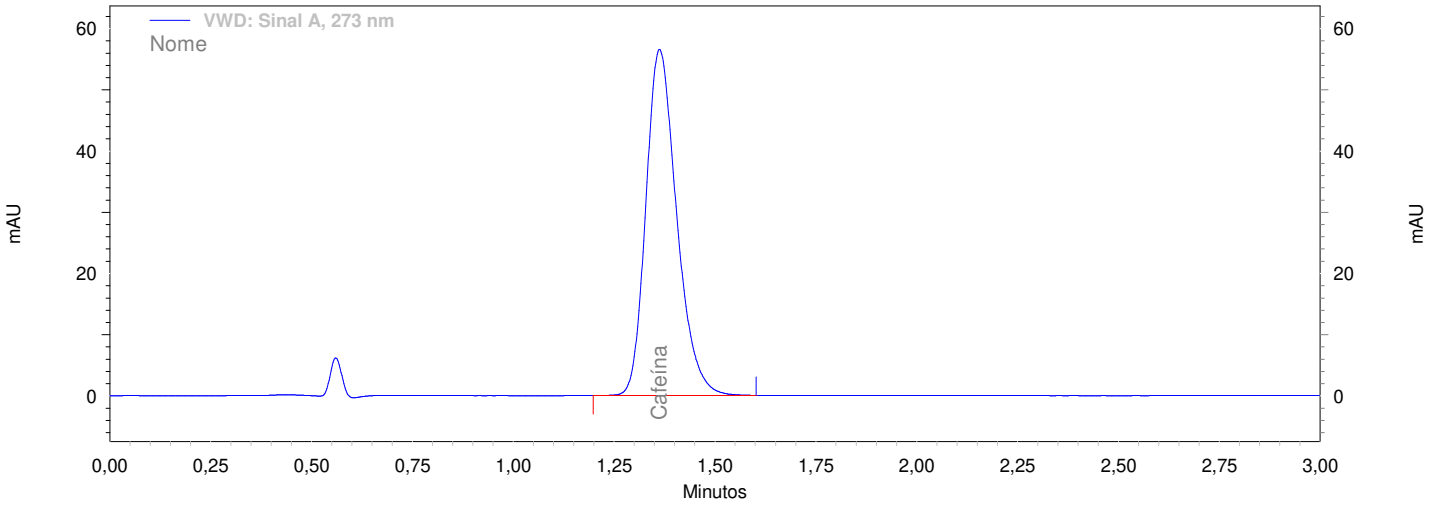

Channel A

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,362	5037467	0,000

Totais		5037467	0,000

Teste de Exatidão do Detector - LDUV 03

Arquivo de Dados: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03:00).rslt\LDUV 03_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 27/09/2024 08:23:03 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:32:28 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: LDUV 03
Vial: 6 Volume: 10 µL

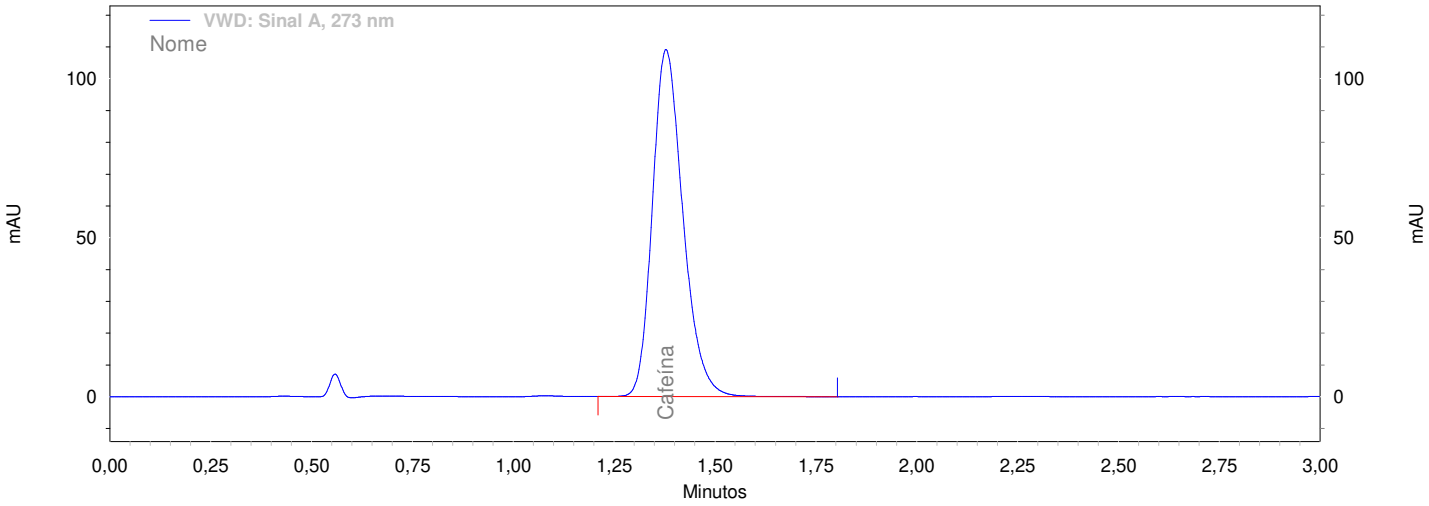

Channel A

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,378	9641933	0,000

Totais		9641933	0,000

Teste de Exatidão do Detector - LDUV 04

Arquivo de Dados: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03:00).rslt\LDUV 04_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 27/09/2024 08:27:19 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:34:09 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: LDUV 04
Vial: 7 Volume: 10 µL

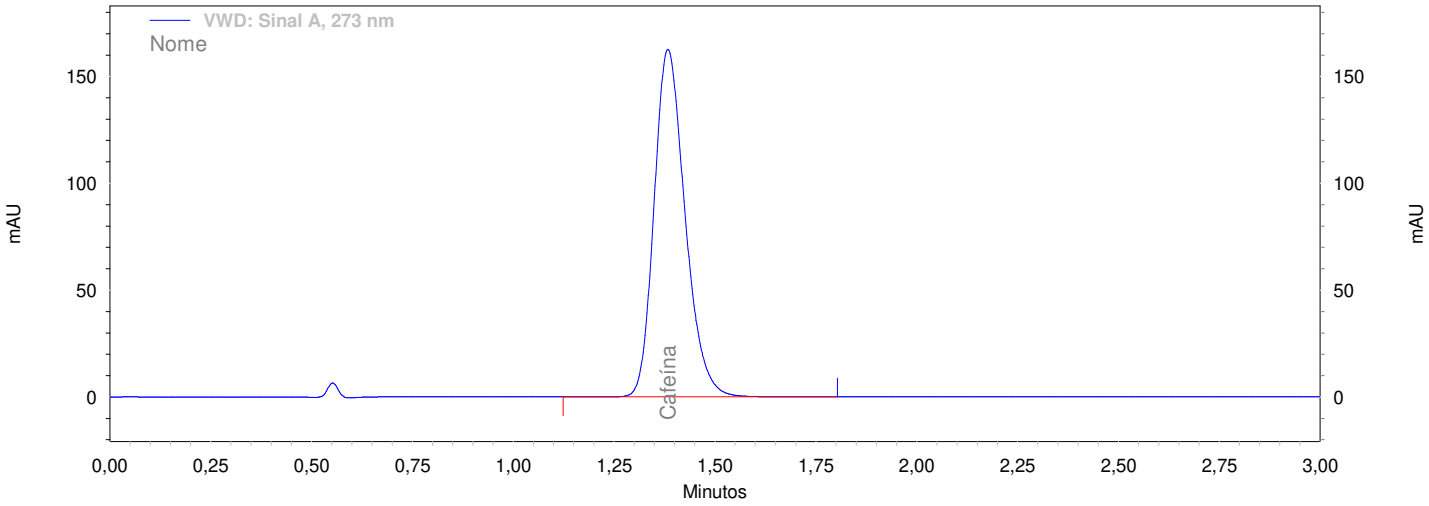

Channel A

Resultados VWD: Sinal A, 273 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,383	14558695	0,000

Totais		14558695	0,000

Teste de Exatidão do Detector - LDUV 05

Arquivo de Dados: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03-00).rslt\LDUV 05_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\QUALIFICAÇÃO.met
Adquirido: 27/09/2024 08:31:39 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:34:50 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: LDUV 05
Vial: 8 Volume: 10 µL

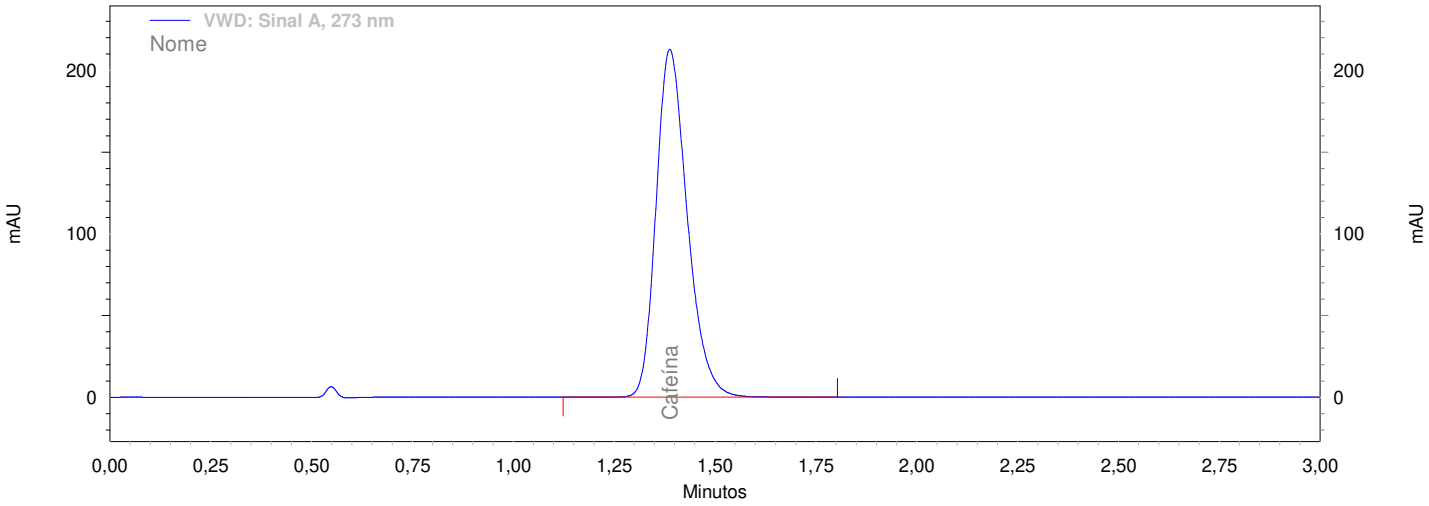

Channel A


Resultados VWD: Sinal A, 273 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	1,388	19226676	0,000


Totais		19226676	0,000

Teste de Sinal Ruído da Linha de Base - RELB


Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\RELB.met
Data: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03-00).rslt\RELB_018.dat
Usuário: QPackSA (QPackSA)
Adquirido: 27/09/2024 08:57:23 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:53:12 (GMT -03:00)
TAG: HPL28 **Amostra:** RELB
Vial: 10 **Volume:** 20 µL

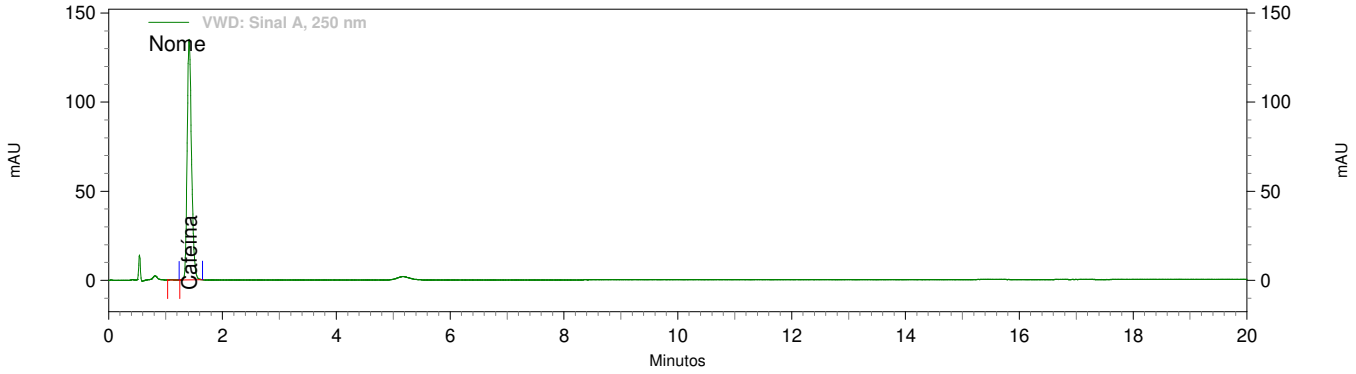

ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE

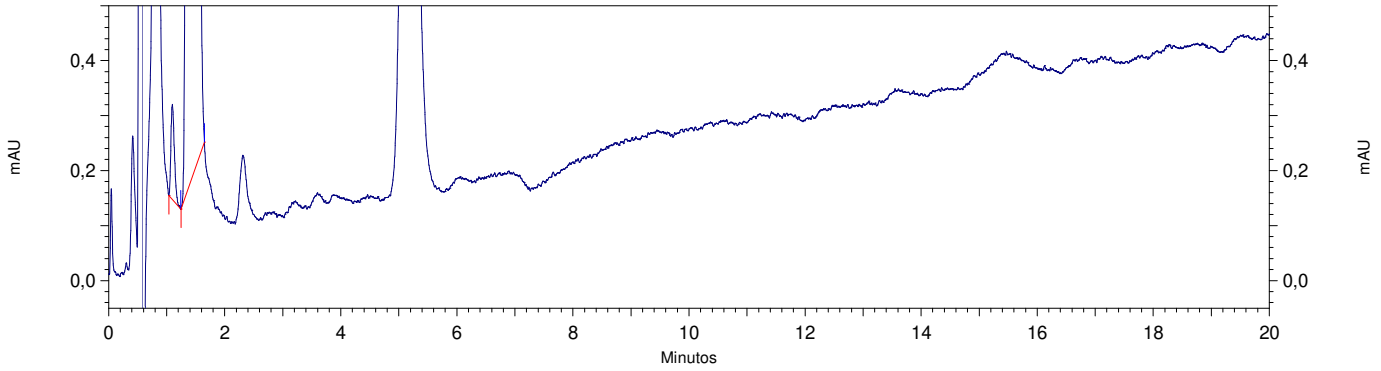


RUÍDO

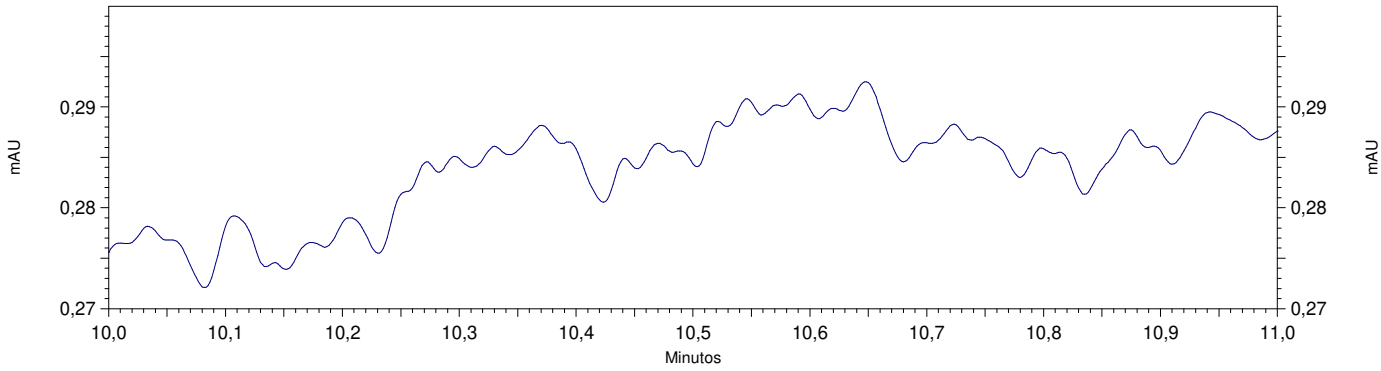

Teste de Sinal Ruído da Linha de Base - RELB

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\RELB.met
Data: C:\Users\Laboratorio\Desktop\QUALIFICAÇÃO\DETECTOR VWD 2024\QUALIFICAÇÃO VWD.seq2024-09-27 08-12-54 (GMT -03-00).rslt\RELB_018.dat
Usuário: QPackSA (QPackSA)
Adquirido: 27/09/2024 08:57:23 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 09:53:12 (GMT -03:00)
TAG: HPL28 **Amostra:** RELB
Vial: 10 **Volume:** 20 µL

ALTURA DO PICO

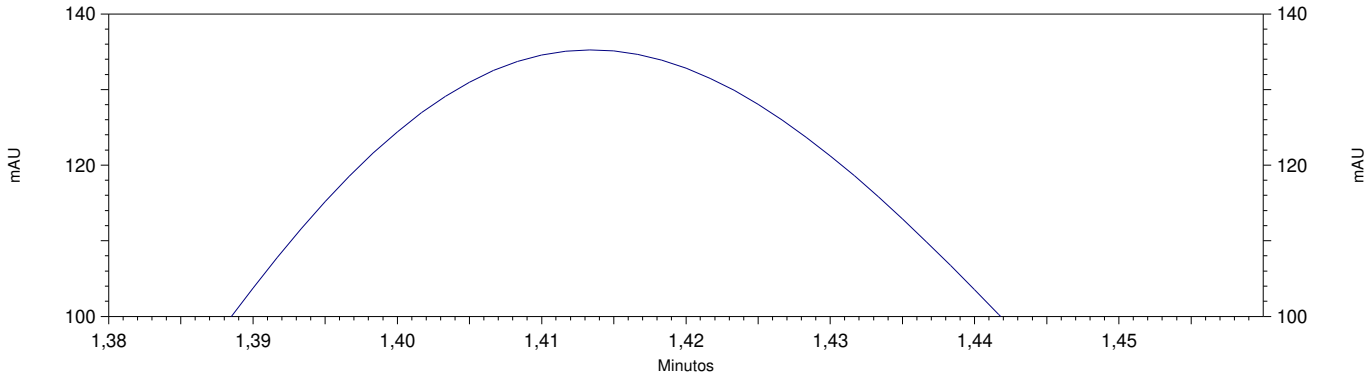

Resultados DAD: Sinal A, 250 nm/Lb:4 nm


Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	Cafeína	1,367	103	24

Totais			103	24

Teste de Gradiente dos Canais - Gradiente AB

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Result\HPL28.39 2024-09-27 13-27-08 (GMT -03-00).rslt\Gradiente AB_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\QUALIFICAÇÃO\Method\GRADIENTE.met
Adquirido: 27/09/2024 12:02:41 (GMT -03:00)
Impresso: 27/09/2024 13:49:44 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL28 Amostra: Gradiente AB
Vial: 2 Volume: 0 µL

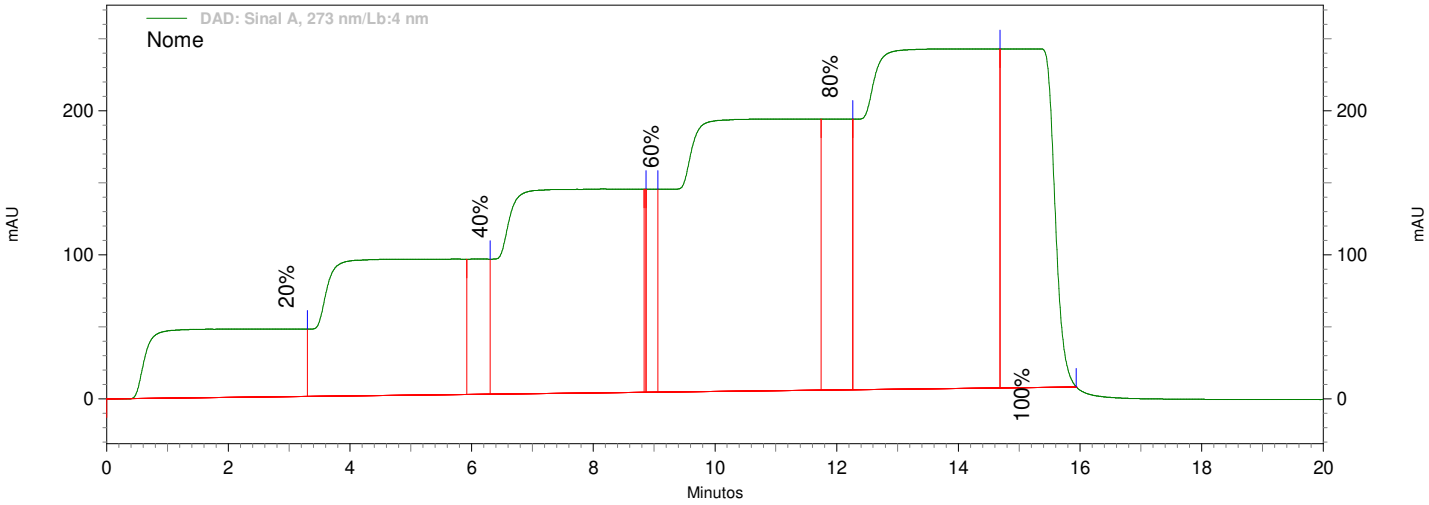

Channel A

Resultados DAD:
Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount	Altura
20%	2,953	15880347	0,000	98417
40%	6,140	4565575	0,000	196907
	8,867	591291	0,000	295651
60%	8,947	3429392	0,000	295720
80%	11,887	12304972	0,000	394641
	14,647	69641571	0,000	493809
100%	15,040	27335873	0,000	493429

Totais		133749021	0,000	2268574