

Teste PCIN - Detector FID BACK

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-11-41-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN - Branco_01
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-05 16:13:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

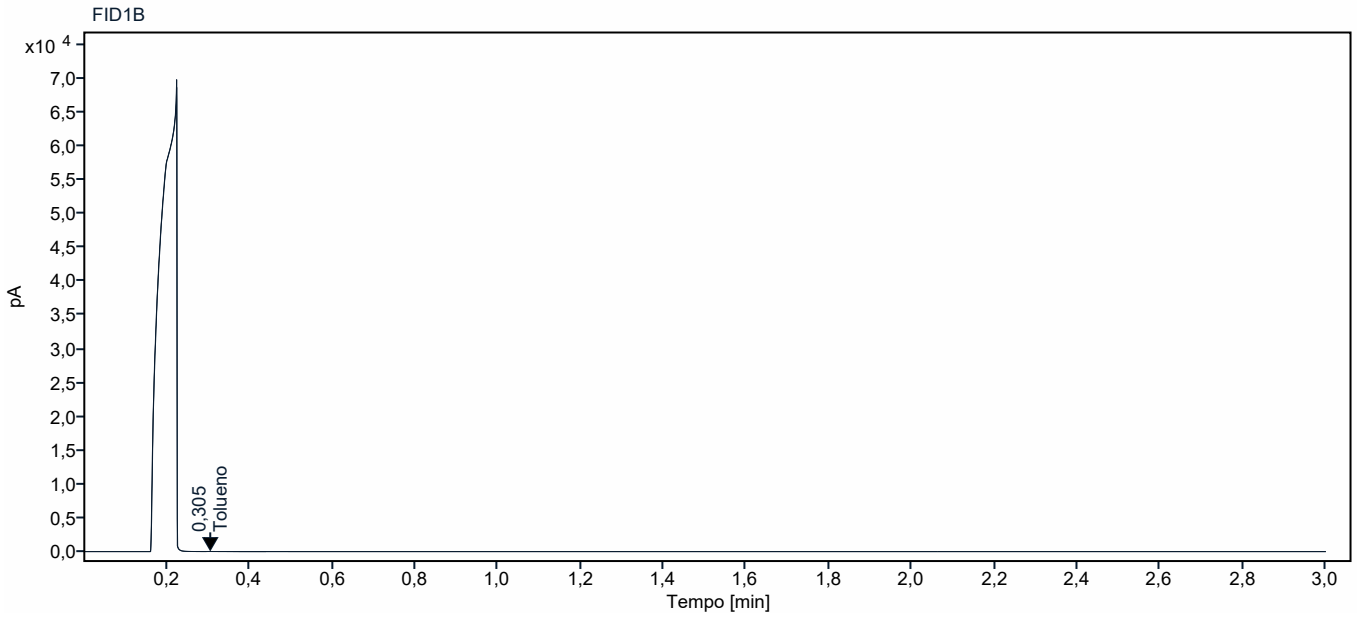

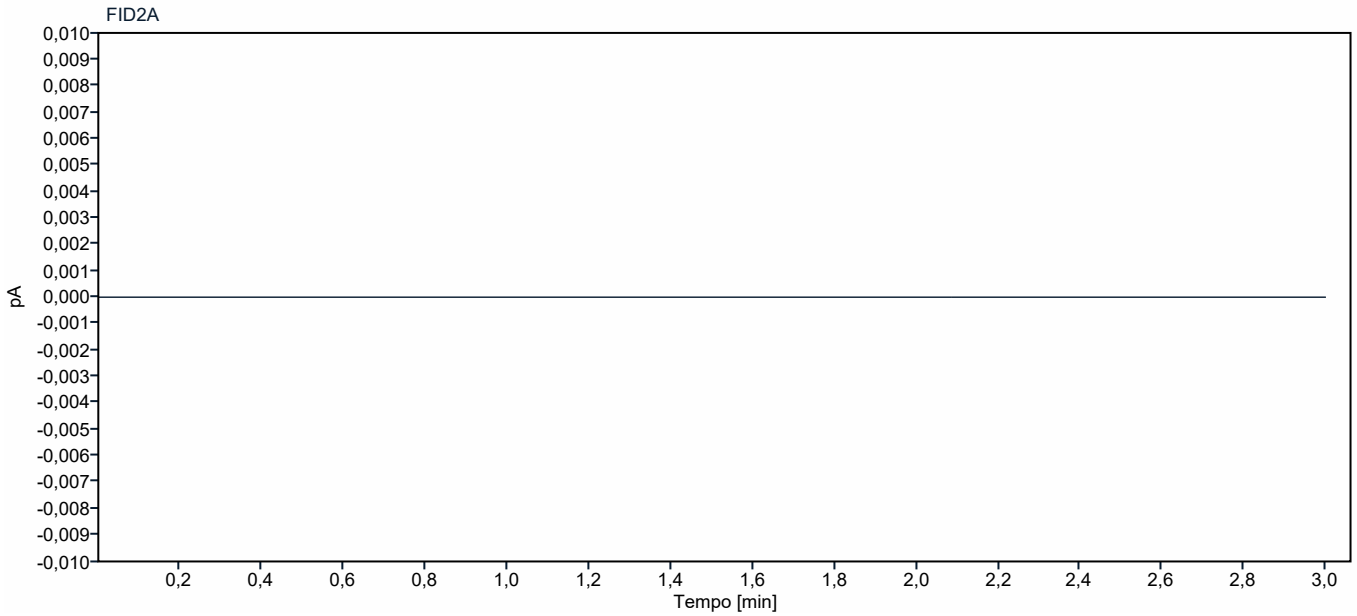

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,305	Tolueno	0,1699	1,0919	6,998	100,0000
		Soma	**1,0919**		


Teste PCIN - Detector FID BACK

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-16-32-03-00-02.dx
Nome da amostra:	PCIN_01
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:19:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

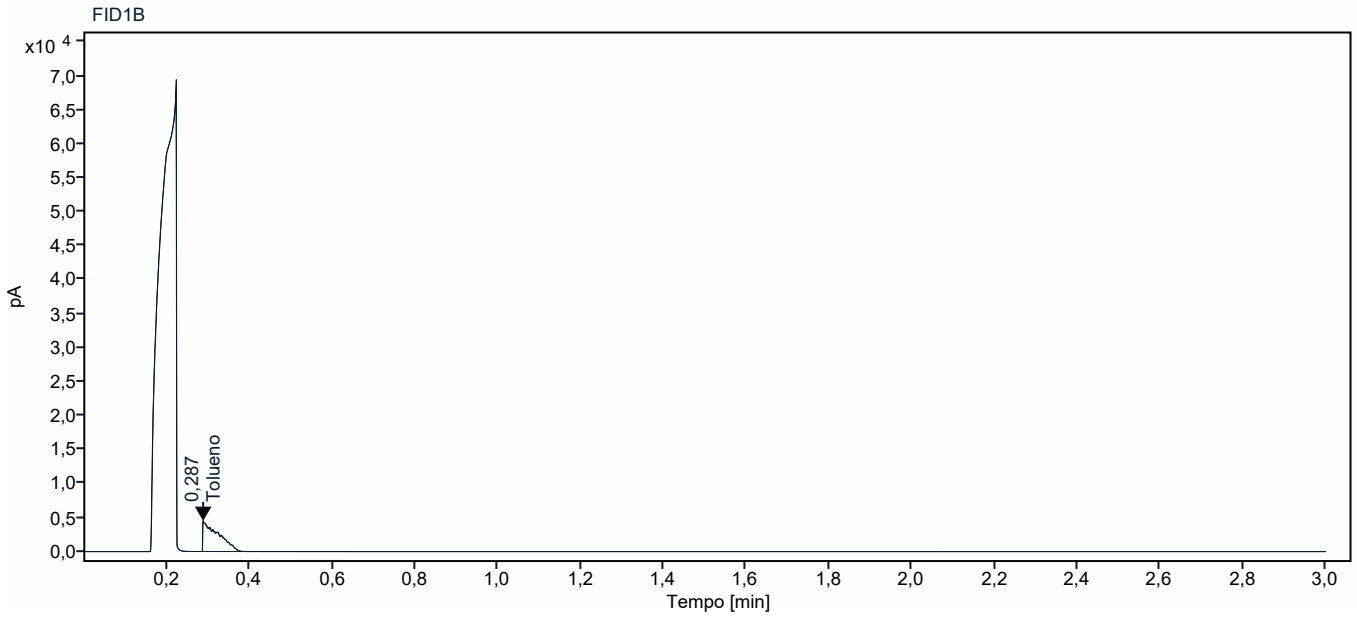

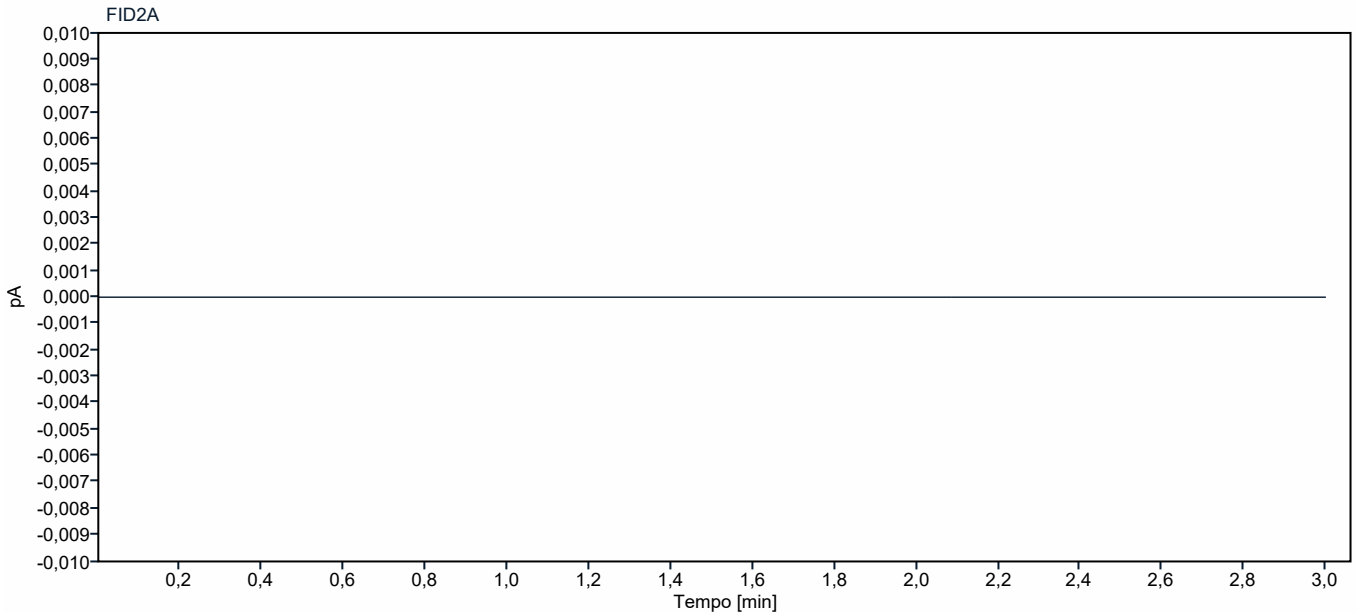

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,287	Tolueno	0,1298	11736,0292	4494,715	100,0000
		Soma	**11736,0292**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-22-23-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN_02
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:25:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

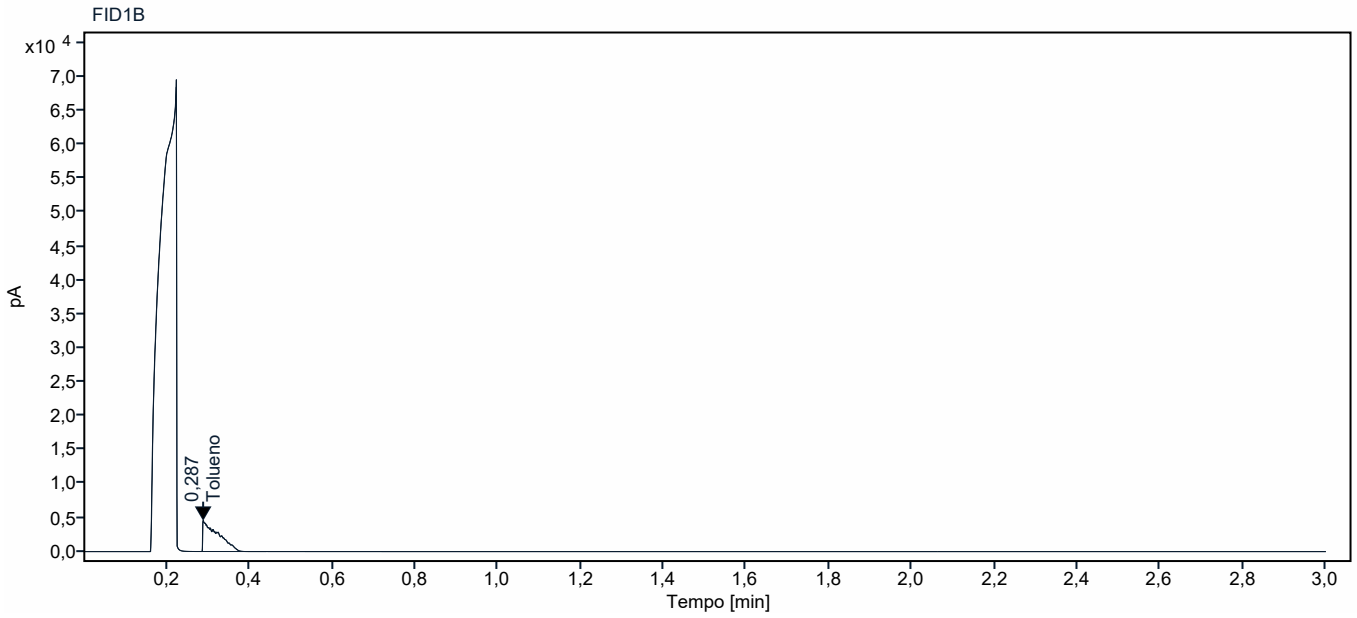

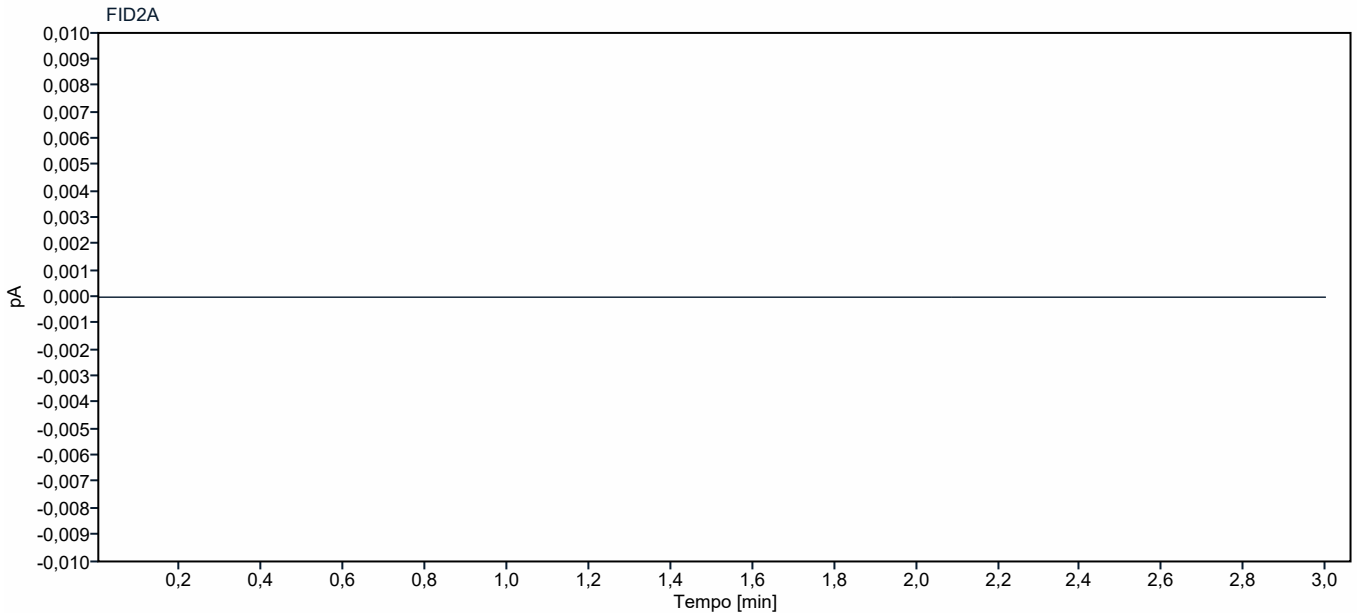

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,287	Tolueno	0,1699	11765,1378	4528,463	100,0000
		Soma	**11765,1378**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-28-08-03-00-04.dx
Nome da amostra:	PCIN_03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:30:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

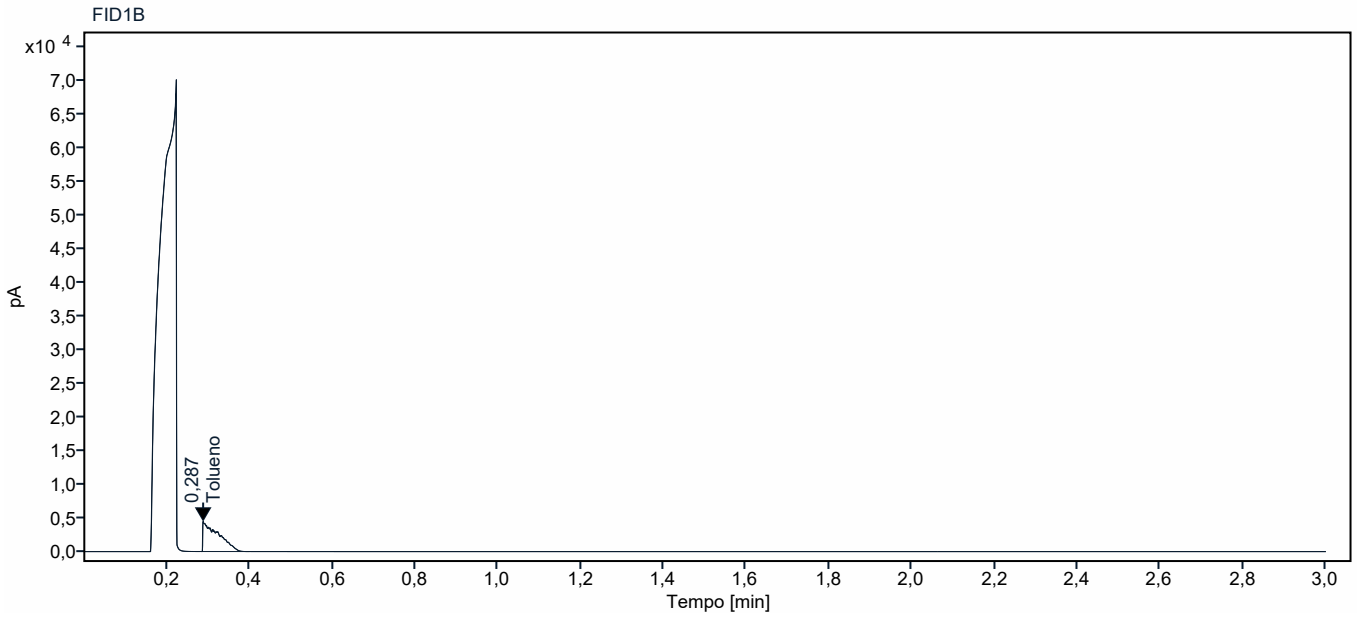

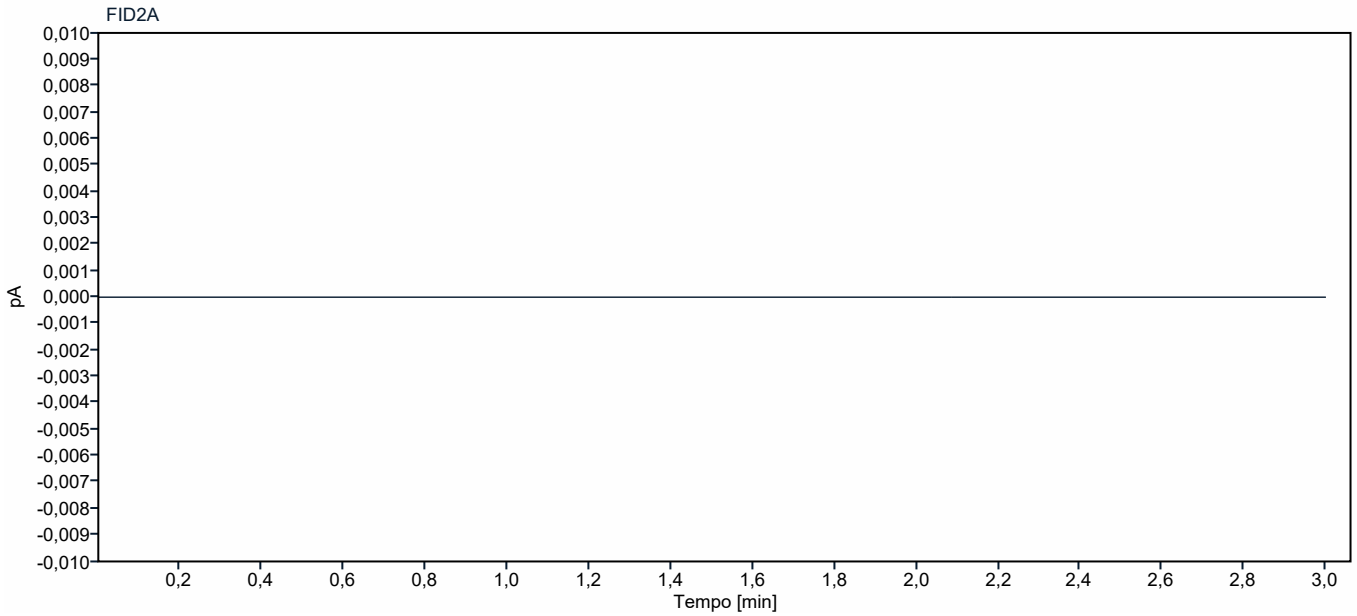

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,287	Tolueno	0,1156	11672,1472	4433,038	100,0000
		Soma	**11672,1472**		


Teste PCIN - Detector FID BACK

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-33-56-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN - Branco_02
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-05 16:36:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

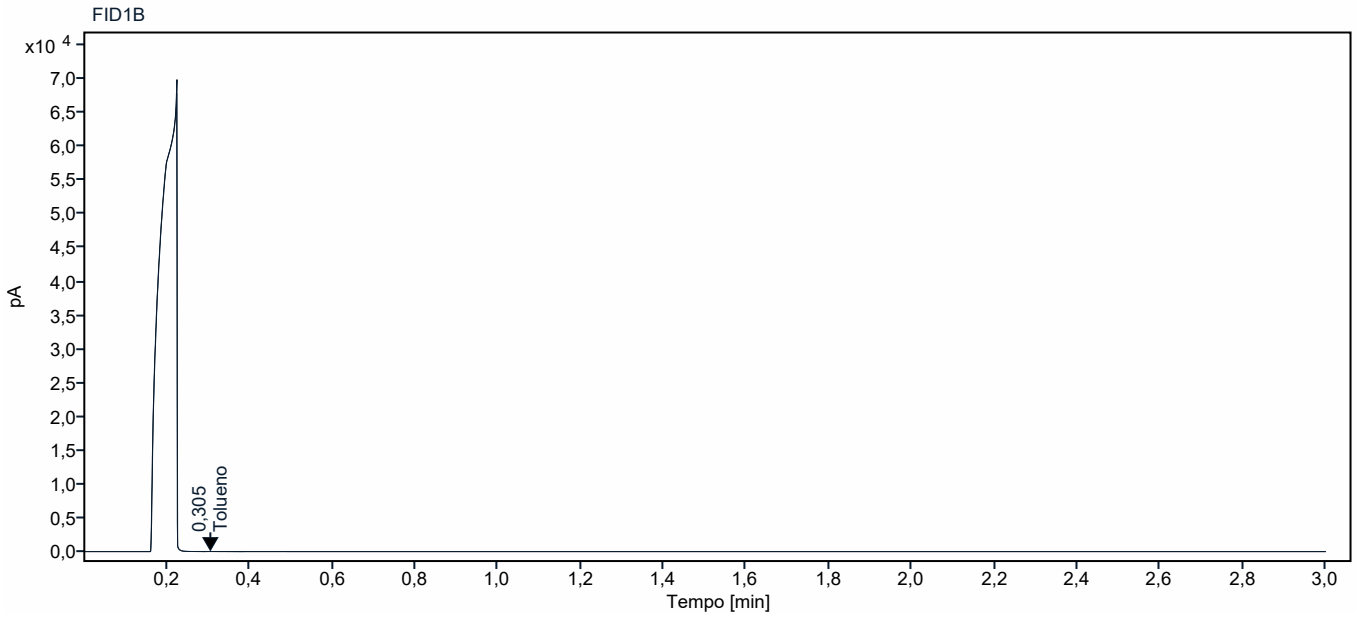

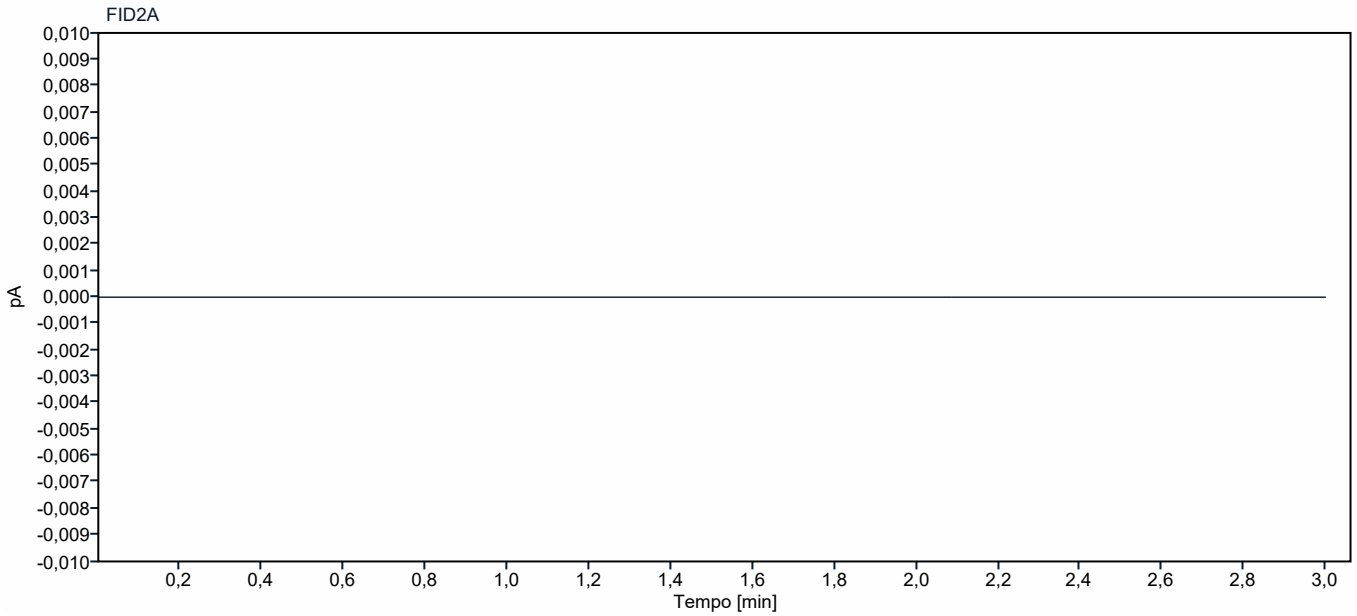

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,305	Tolueno	0,1015	24,0249	9,881	100,0000
		Soma	**24,0249**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-39-55-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN_04
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:42:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

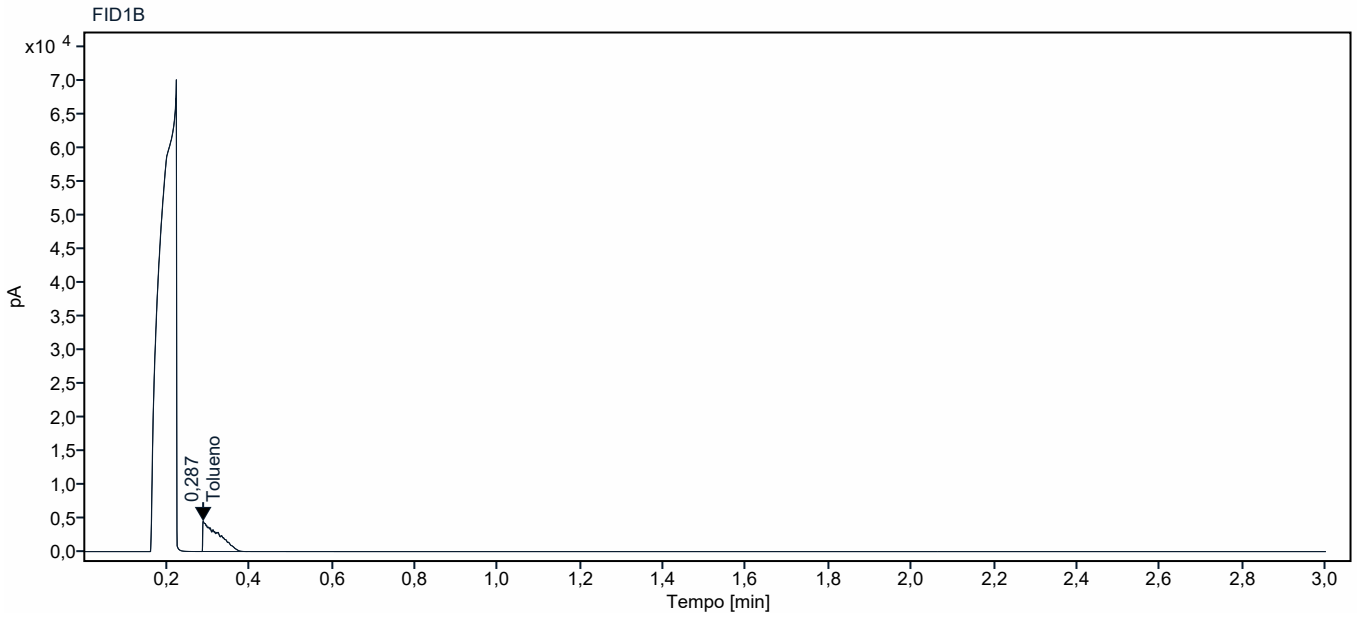

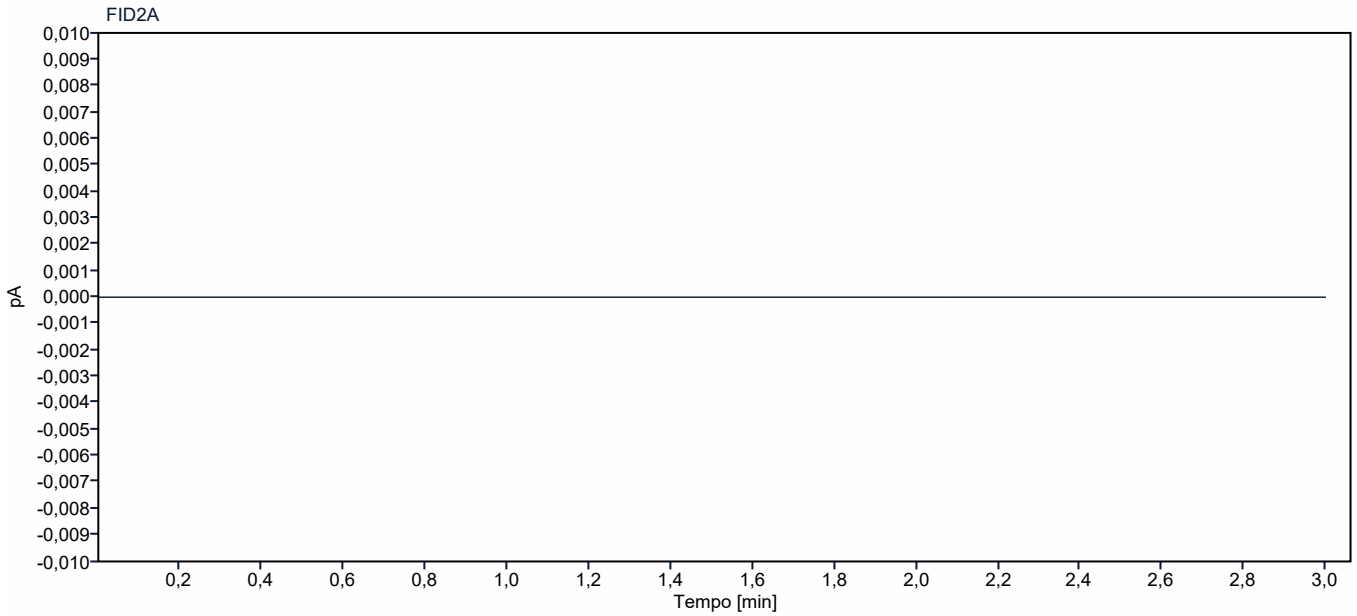

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,287	Tolueno	0,1133	11691,7640	4489,530	100,0000
		Soma	**11691,7640**		


Teste PCIN - Detector FID BACK

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-45-41-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN_05
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:48:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

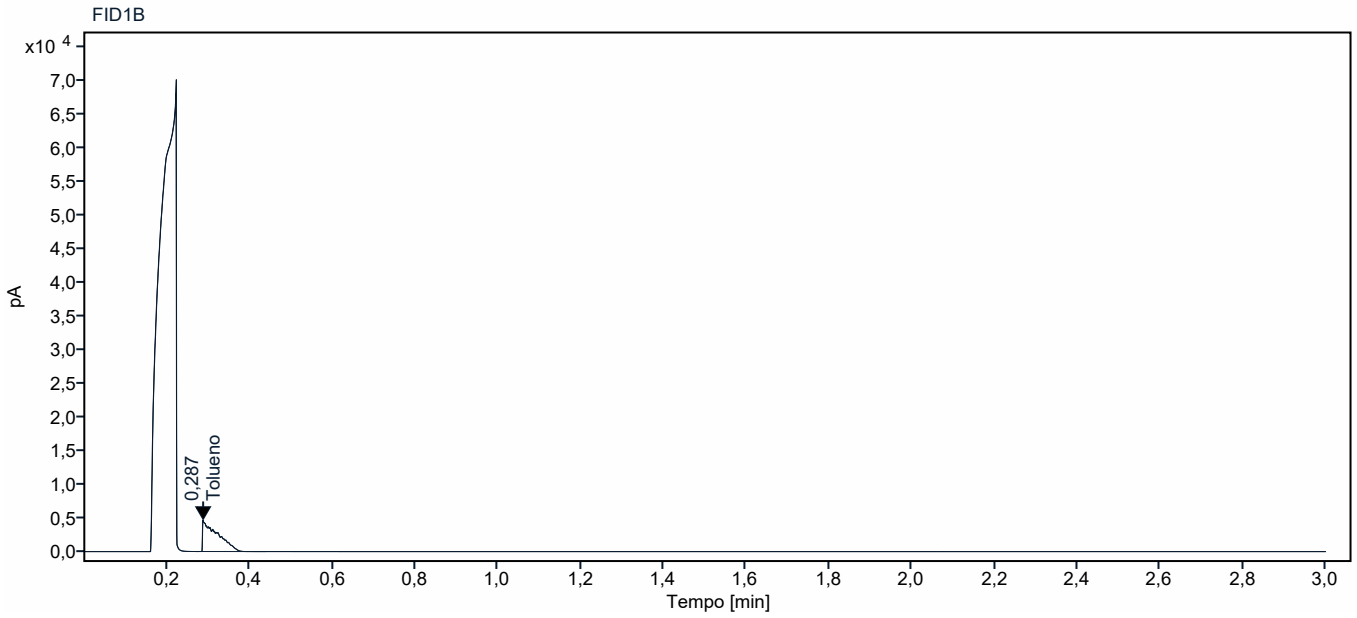

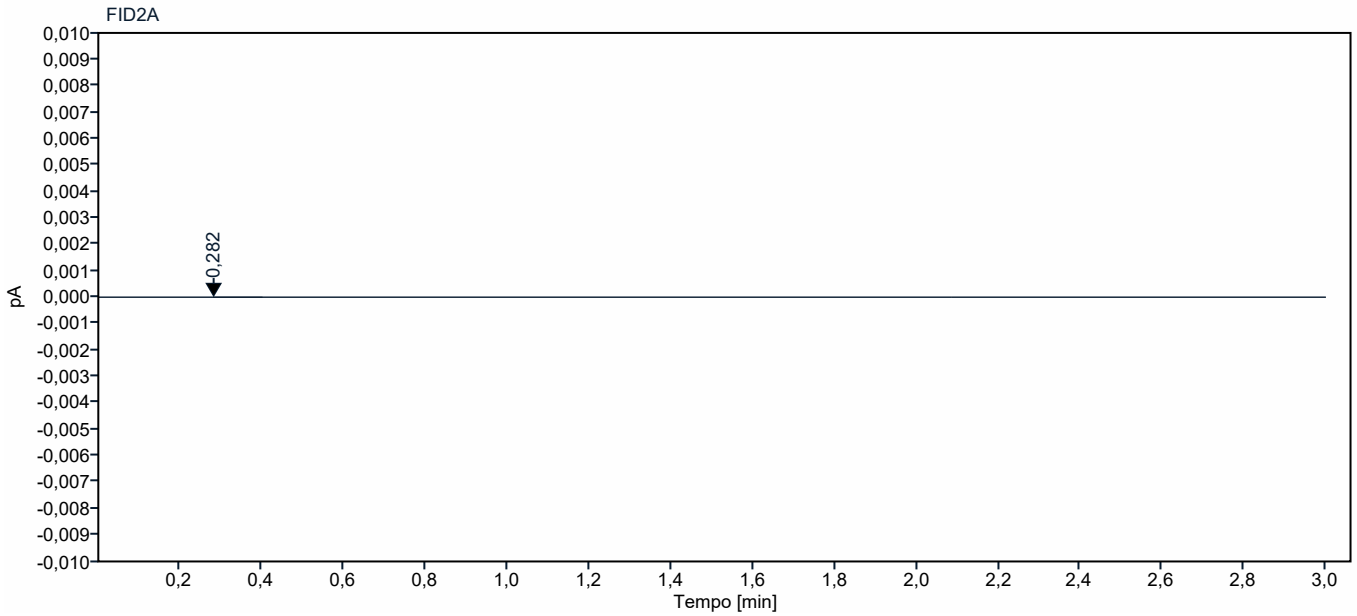

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,287	Tolueno	0,1699	11757,4100	4589,600	100,0000
		Soma	**11757,4100**		

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,282		0,1204	0,0000	0,000	100,0000
		Soma	**0,0000**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-51-28-03-00-08.dx
Nome da amostra:	PCIN_06
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-05 16:54:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

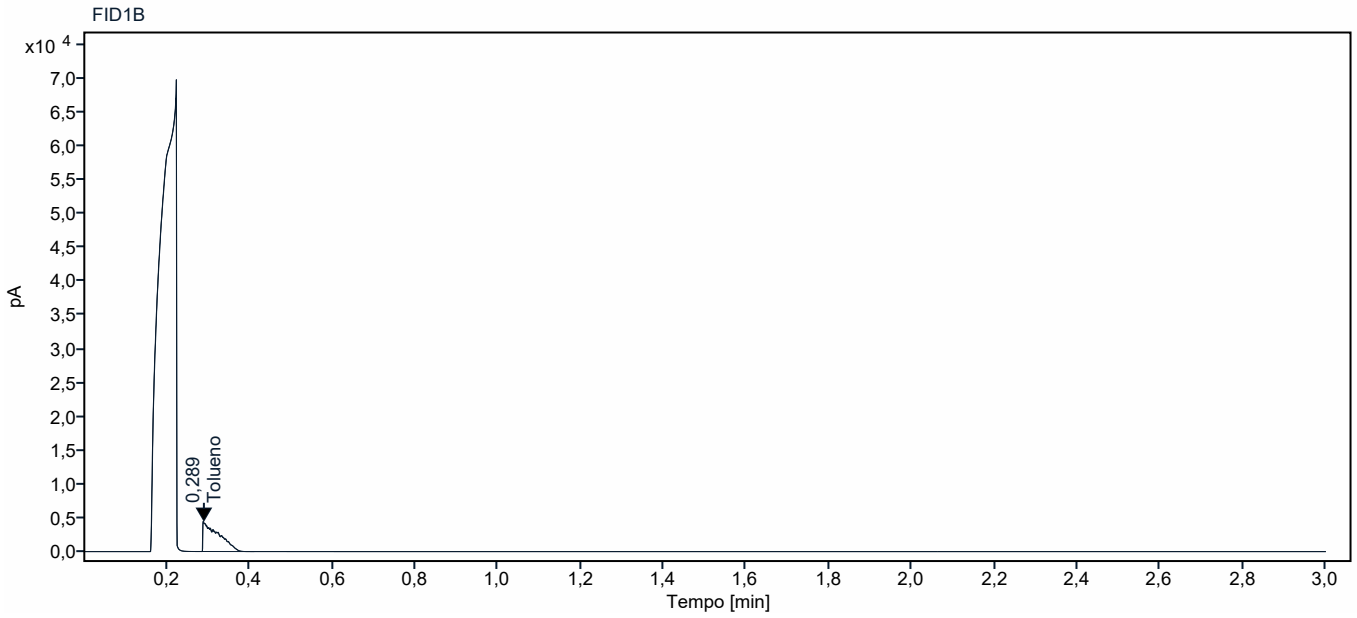

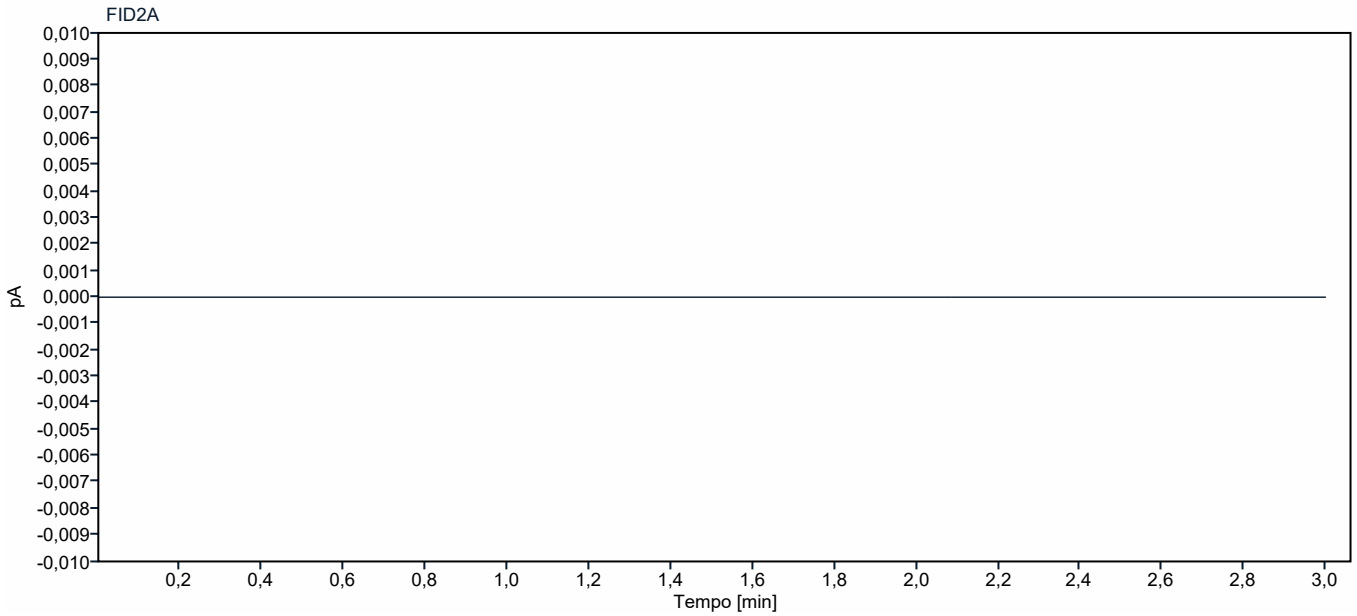

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,289	Tolueno	0,1534	11711,6656	4379,734	100,0000
		Soma	**11711,6656**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 16-57-16-03-00-09-r001.dx
Nome da amostra:	PCIN - Branco_03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-05 16:59:59-03:00	**Injeção:**	1 de 3
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

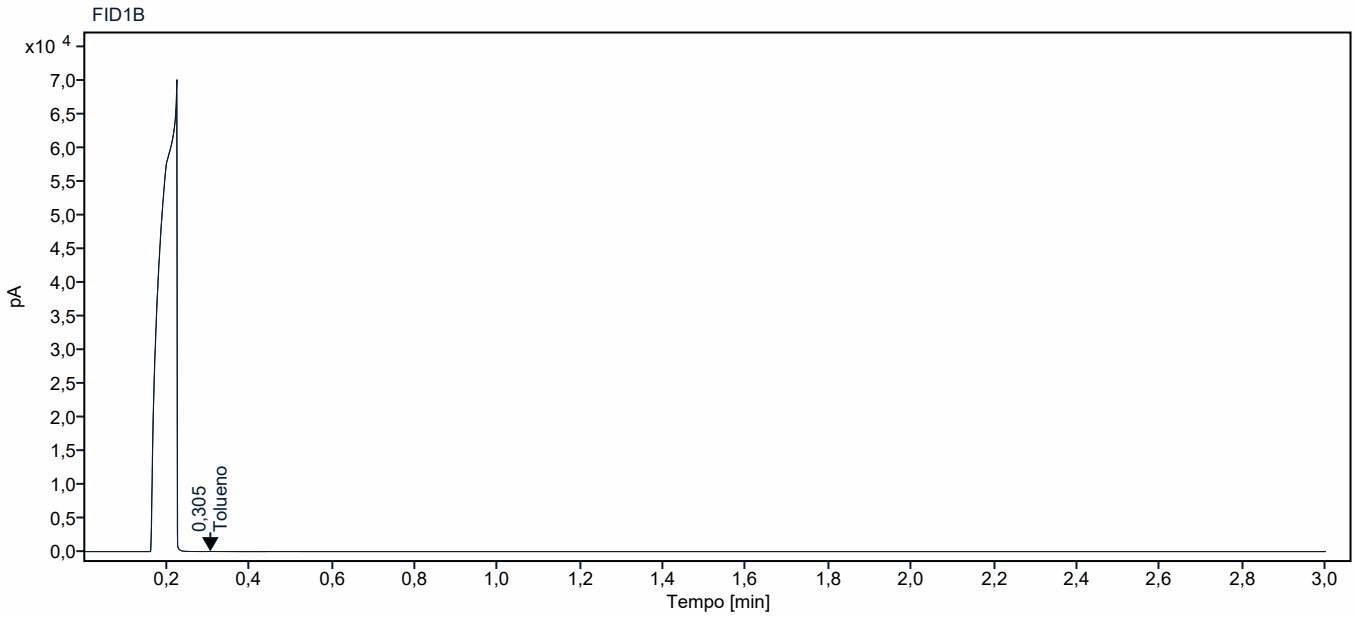

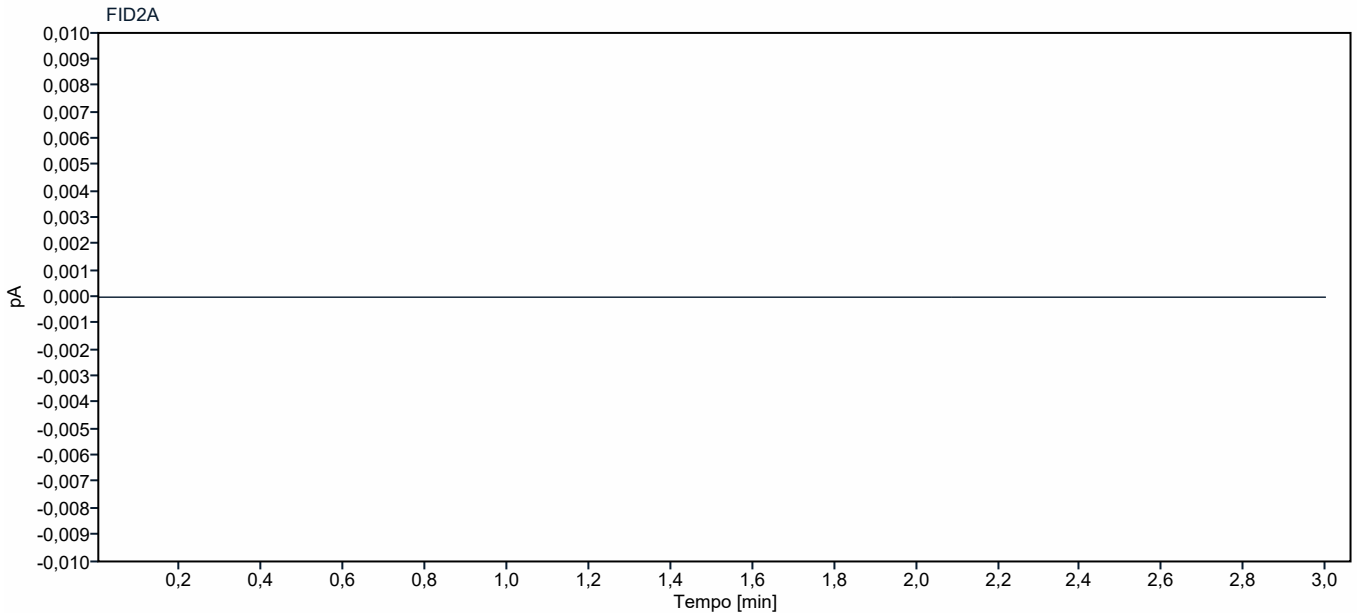


Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,305	Tolueno	0,1699	2,6317	7,408	100,0000
		Soma	**2,6317**		

Teste PCIN - Detector FID BACK

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 17-03-03-03-00-09-r002.dx
Nome da amostra:	PCIN - Branco_03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-05 17:05:49-03:00	**Injeção:**	2 de 3
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

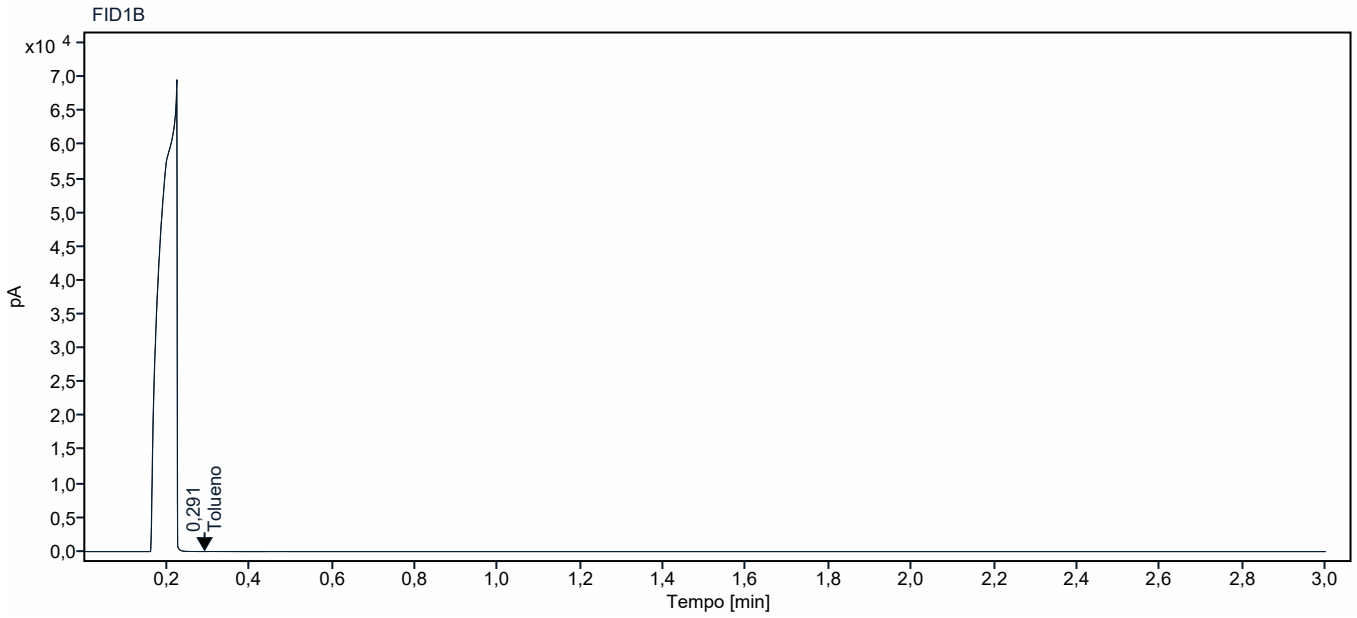

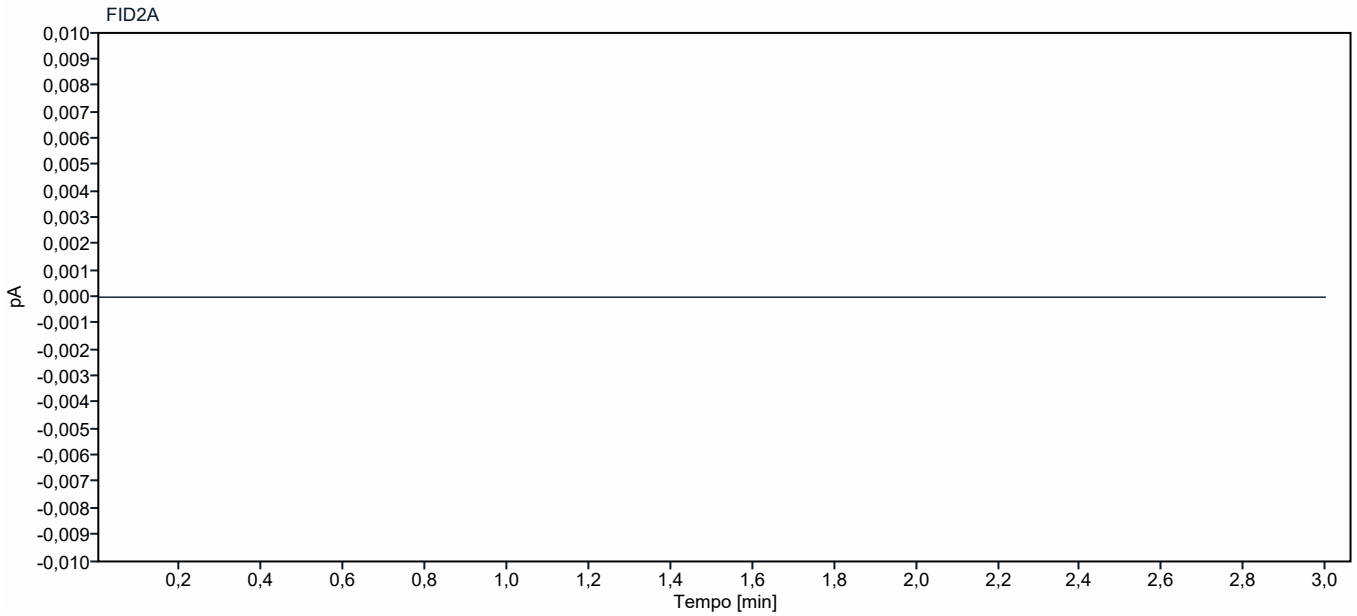

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,291	Tolueno	0,1699	1,4007	3,324	100,0000
		Soma	**1,4007**		


Teste PCIN - Detector FID BACK


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação105.rslt\2023-10-05 17-08-53-03-00-09-r003.dx
Nome da amostra:	PCIN - Branco_03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-05 17:11:38-03:00	**Injeção:**	3 de 3
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-05 17:08:45-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

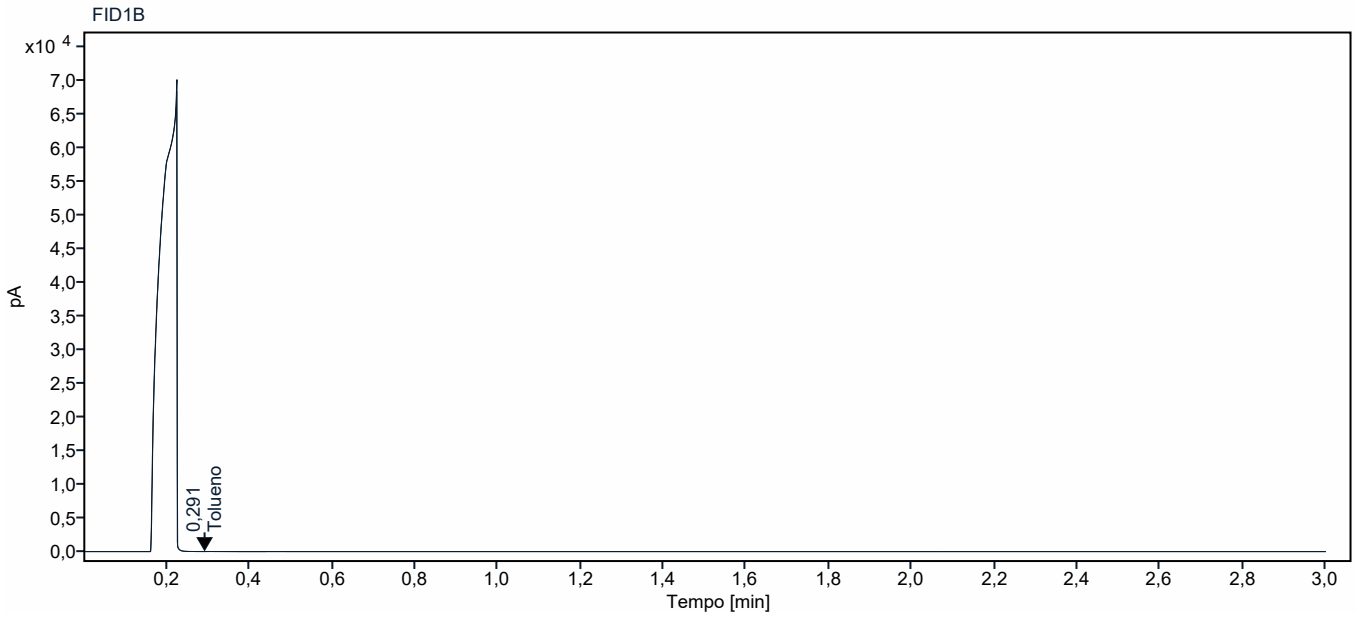

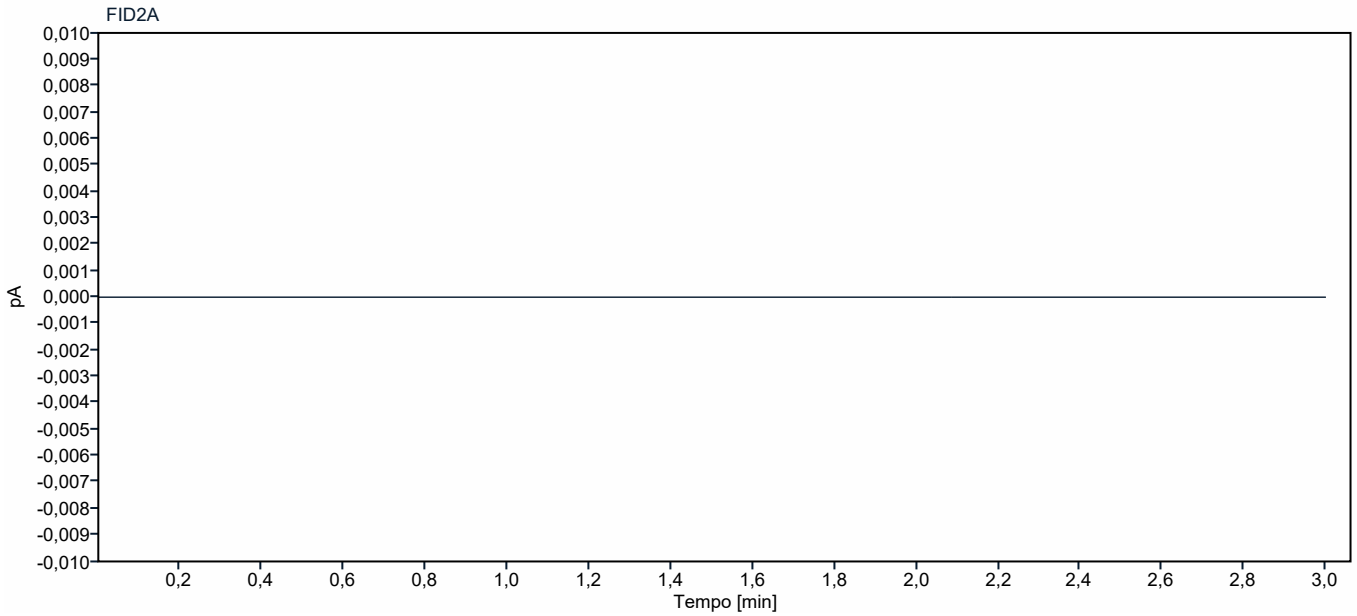

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,291	Tolueno	0,1699	1,6252	3,265	100,0000
		Soma	**1,6252**		