
Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-17-47-03-00-01.dx
Nome da amostra: PCIN - Branco_01
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-06 11:20:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

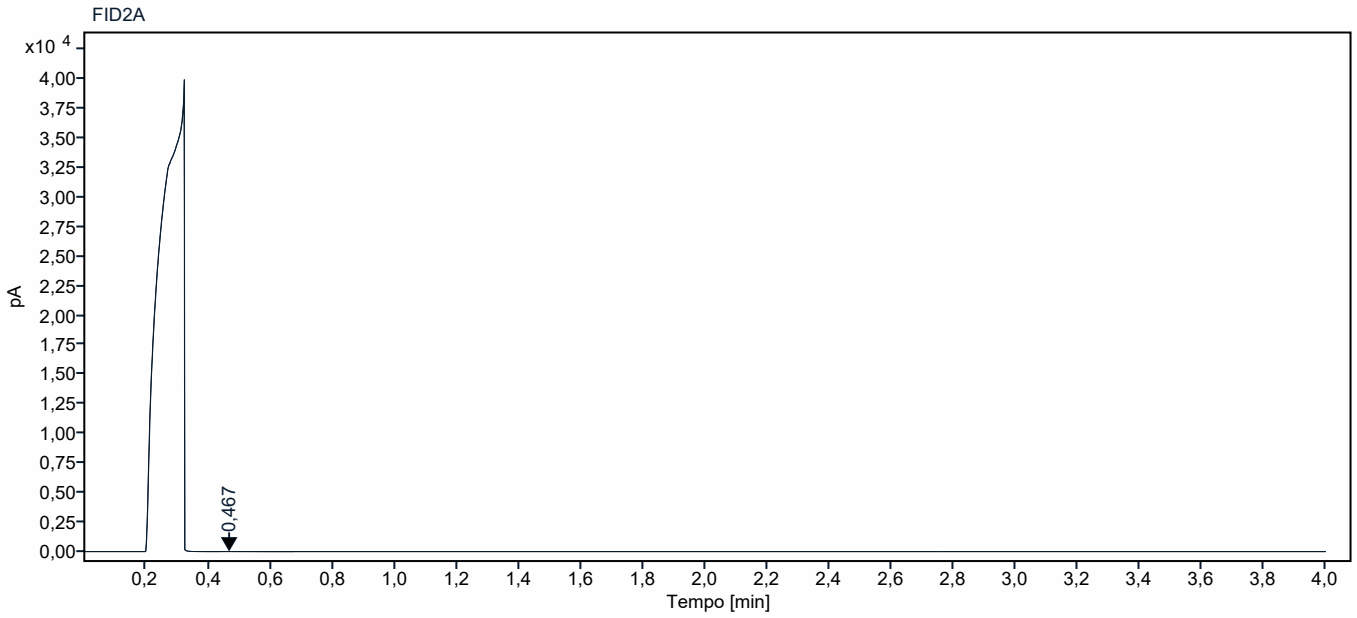

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,467		0,2958	14,8590	5,025	100,0000
		Soma	**14,8590**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-24-23-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN_01
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 11:27:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

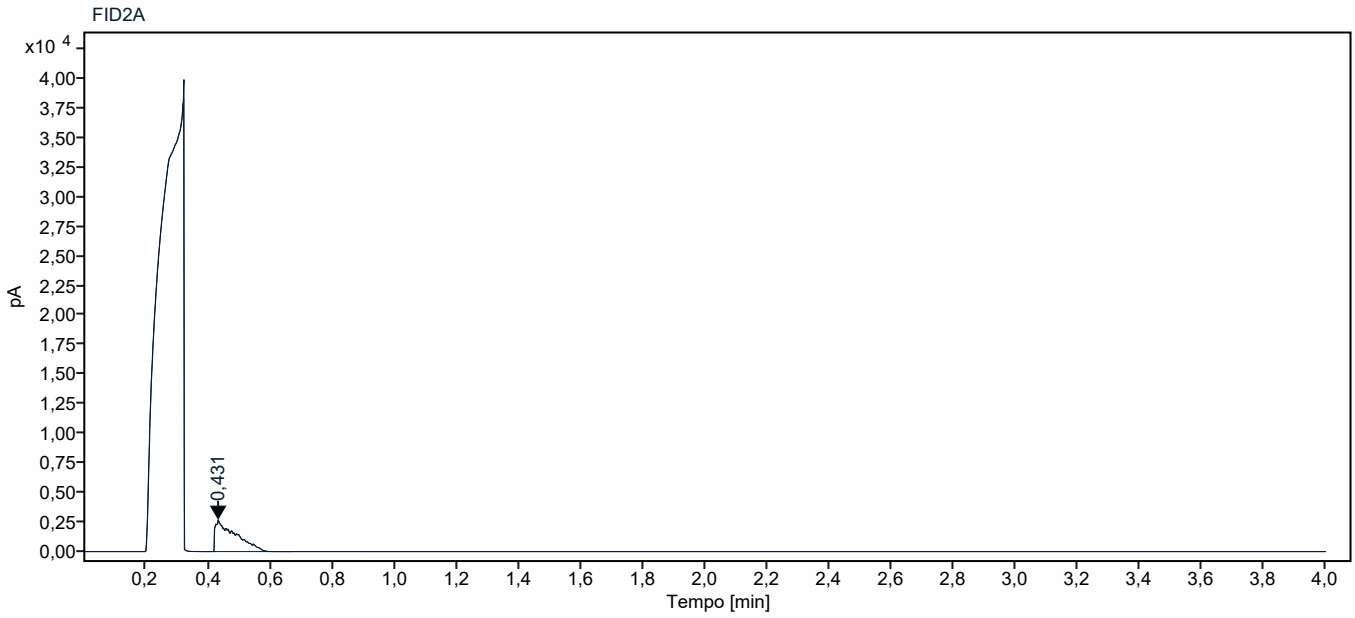

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,431		0,2958	12111,7881	2673,075	100,0000
		Soma	**12111,7881**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-31-11-03-00-03.dx
Nome da amostra: PCIN_02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 11:33:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

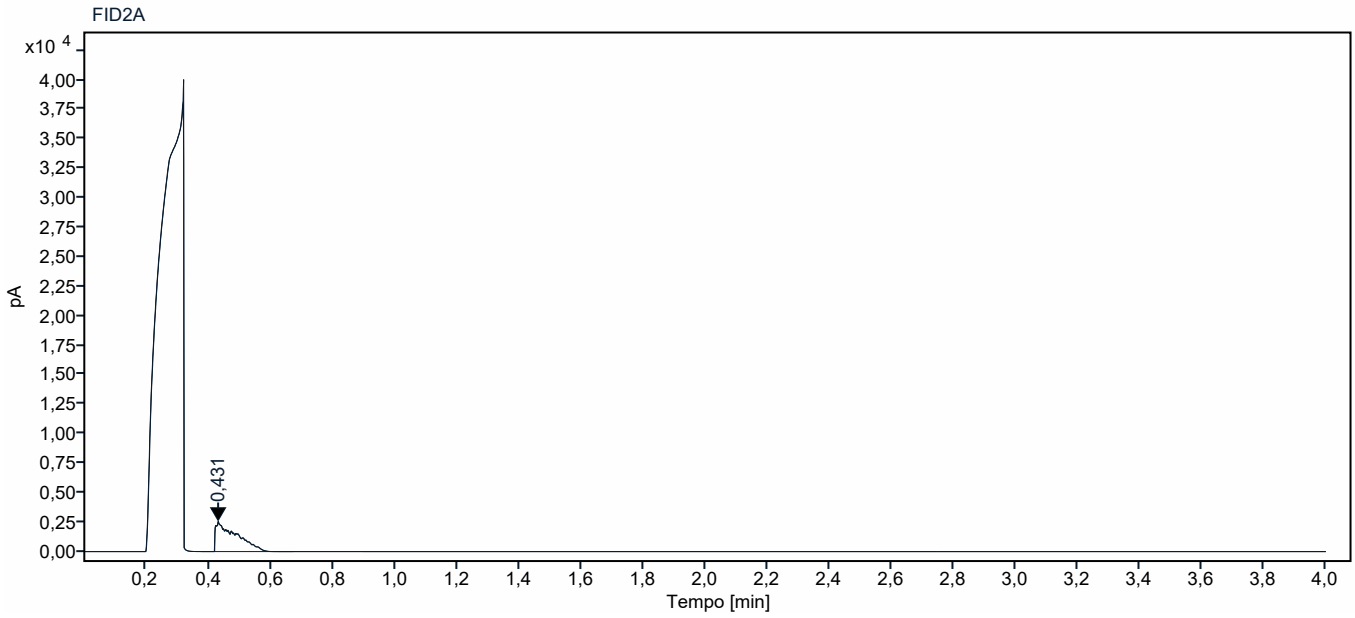

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,431		0,2958	11816,2477	2541,471	100,0000
		Soma	**11816,2477**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-38-04-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN_03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 11:40:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

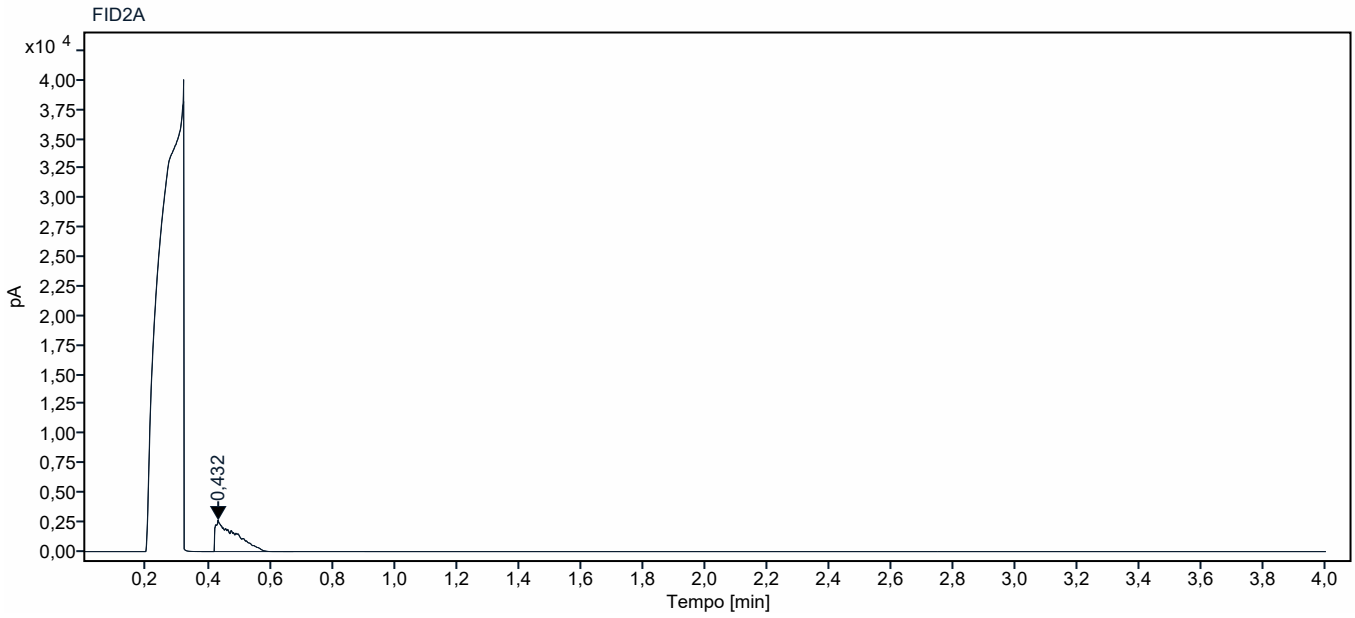


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,432		0,2958	11973,8527	2645,249	100,0000
		Soma	**11973,8527**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-44-50-03-00-05.dx
Nome da amostra: PCIN - Branco_02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-06 11:47:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

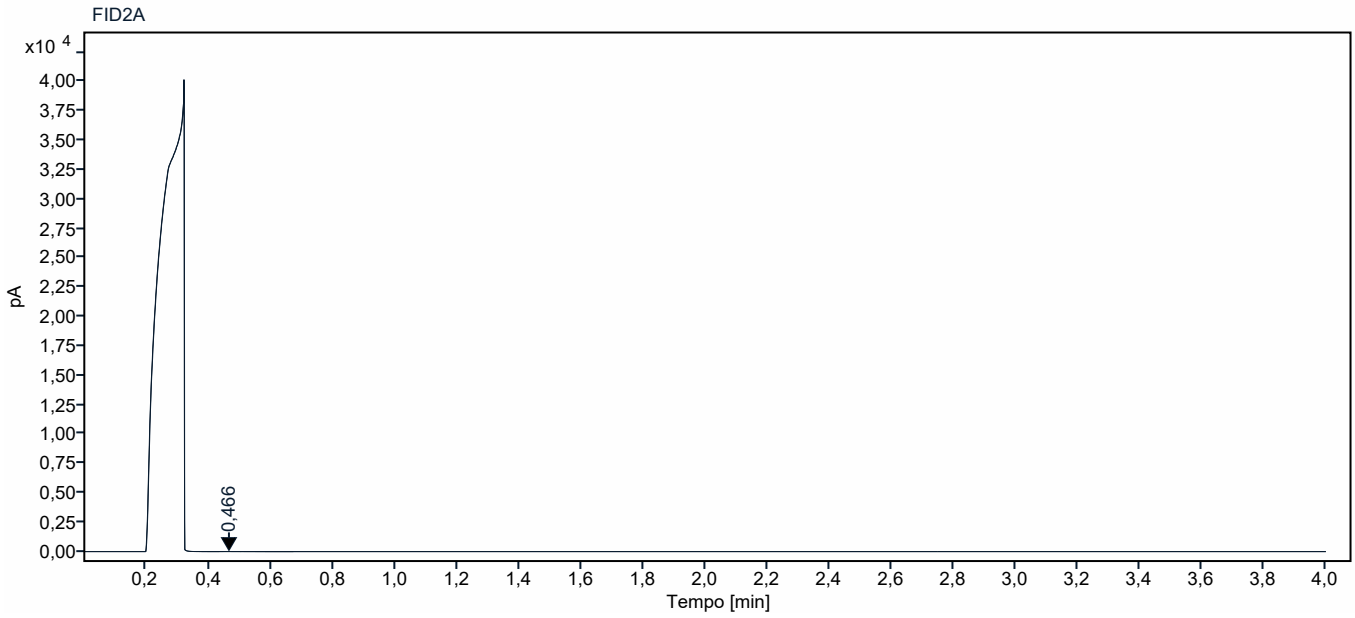


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,466		0,2958	14,3620	4,955	100,0000
		Soma	**14,3620**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-51-39-03-00-06.dx
Nome da amostra: PCIN_04
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 11:54:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

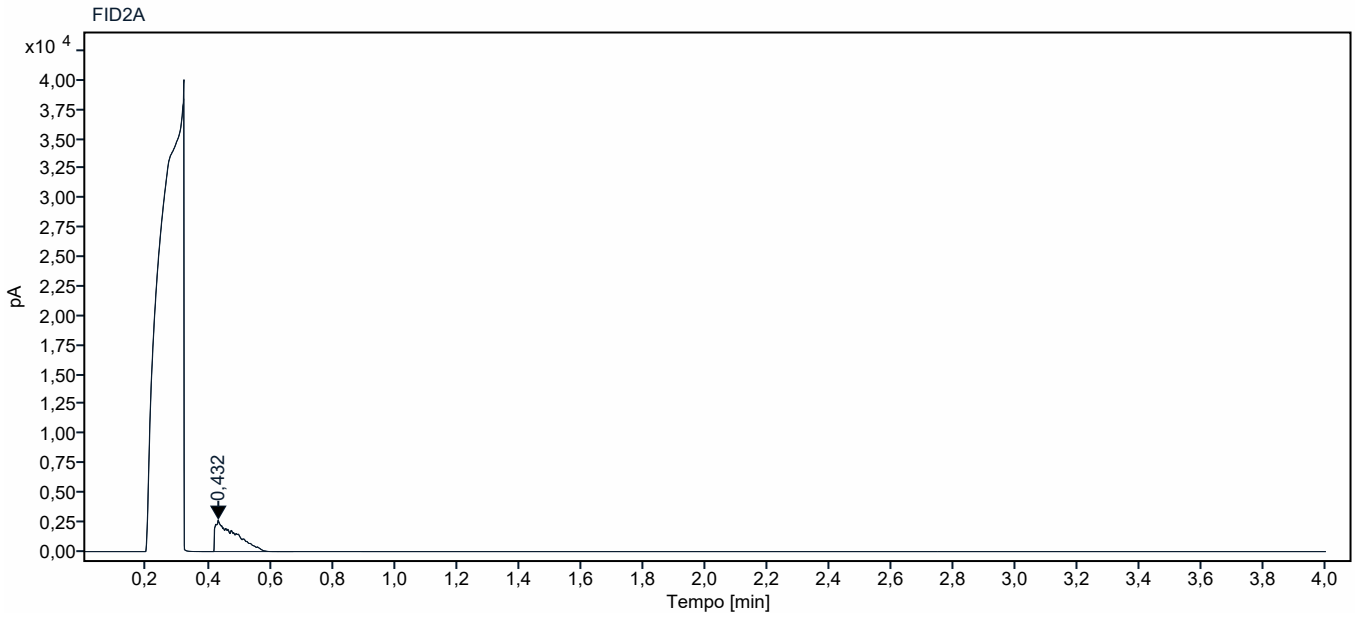


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,432		0,2958	12069,3803	2681,607	100,0000
		Soma	**12069,3803**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 11-58-27-03-00-07.dx
Nome da amostra: PCIN_05
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 12:01:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

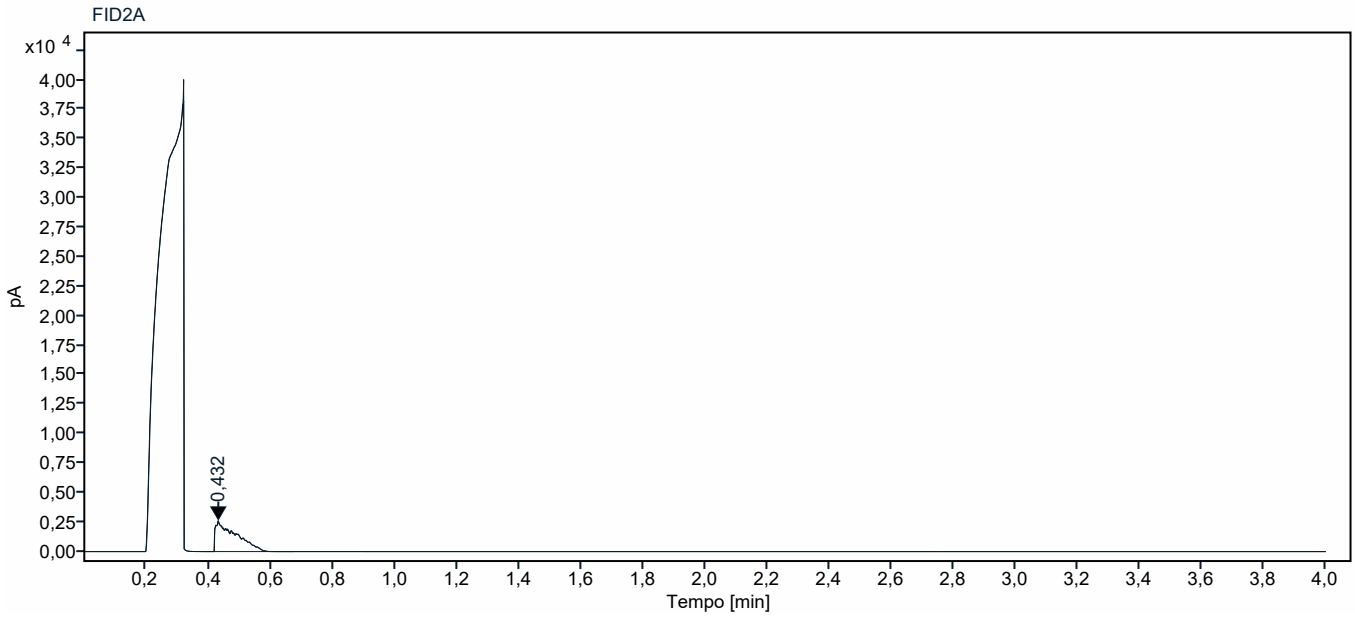


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,432		0,2958	11957,1167	2617,173	100,0000
		Soma	**11957,1167**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 12-05-17-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN_06
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2023-10-06 12:08:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

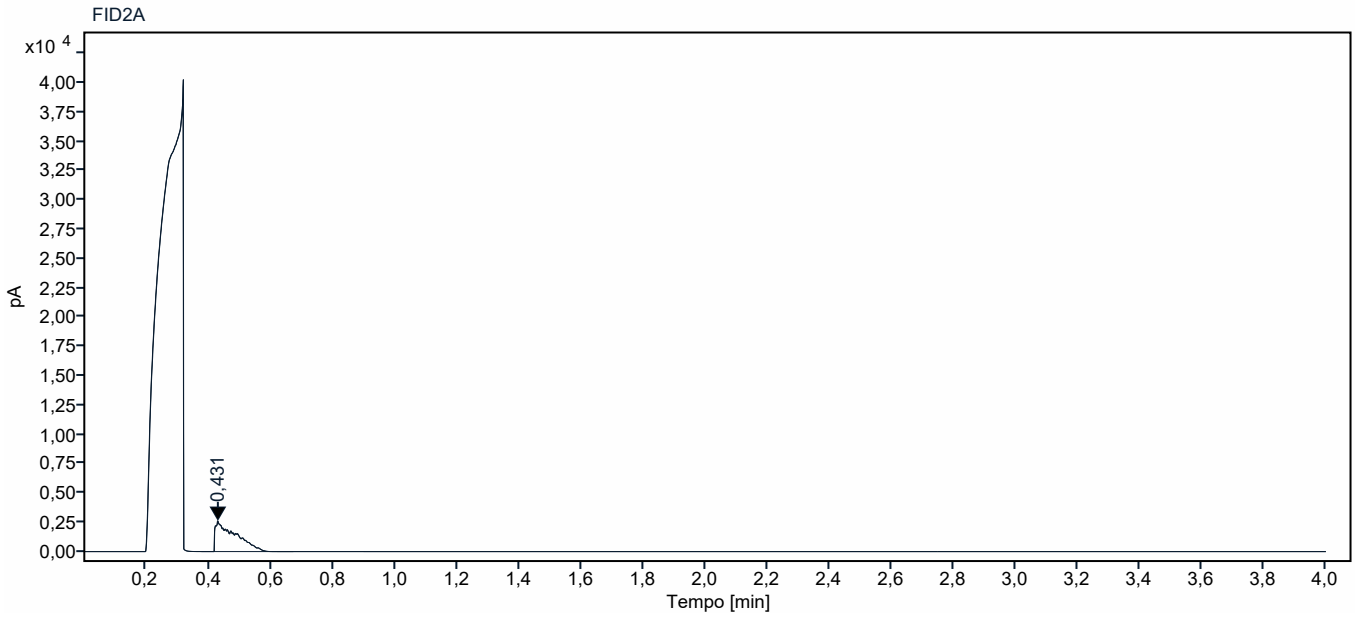


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,431		0,2958	11826,2493	2612,218	100,0000
		Soma	**11826,2493**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 02\Setembro\Qualificação_FRONT124.rslt\2023-10-06 12-12-07-03-00-09.dx
Nome da amostra: PCIN - Branco_03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2023-10-06 12:14:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT_.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-06 12:25:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

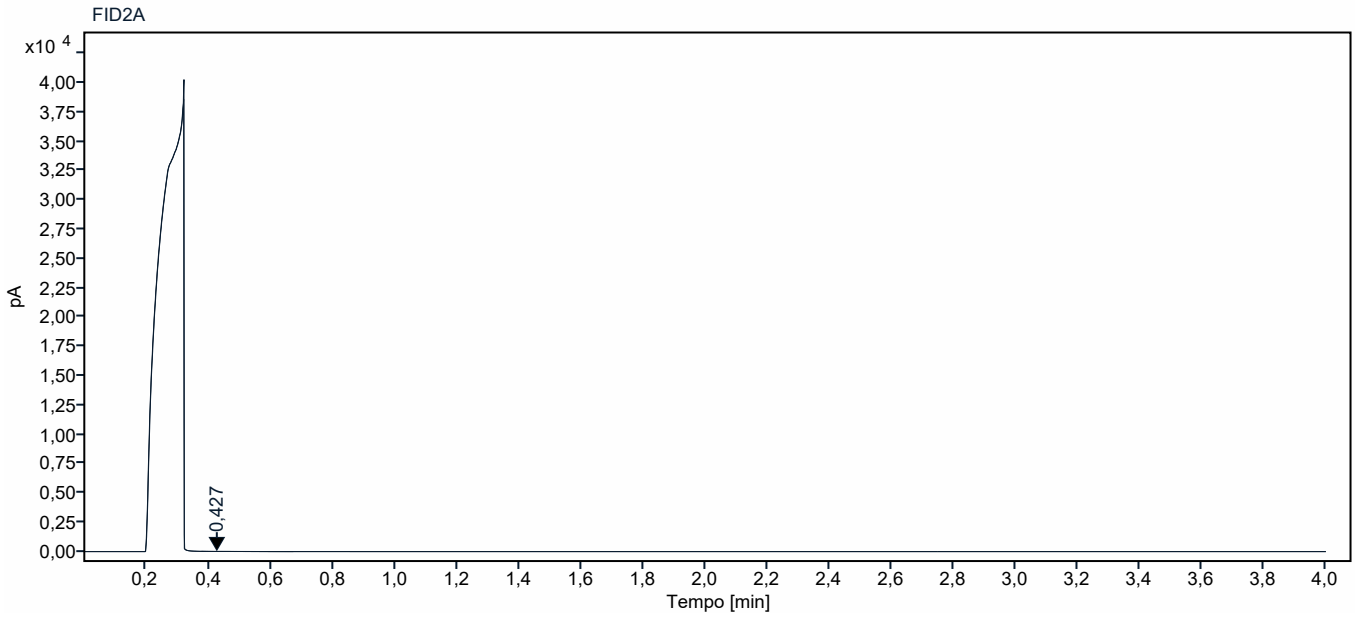

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,427		0,2958	74,7281	8,518	100,0000
		Soma	**74,7281**		