
16.1 VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TITULADOR



EXATIDÃO DO VOLUME DAS BURETAS





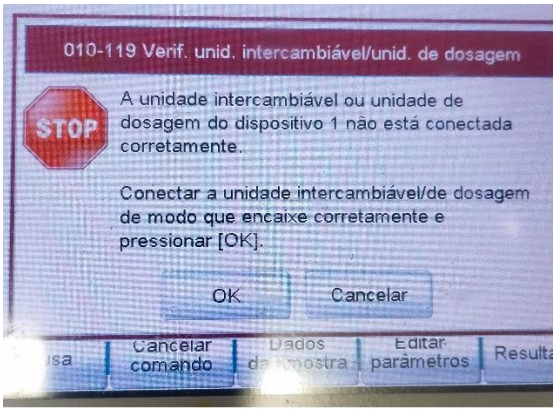








57.6477 g


63.4609 g


70.4538 g



78.6091 g


87.9156 g



98.4002 g



110.0392 g


FATORAÇÃO DO TITULANTE

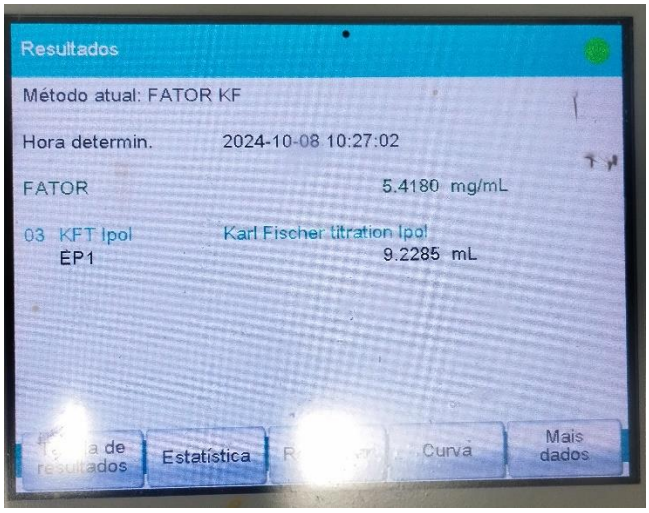



REPETIBILIDADE DE LEITURA DO PADRÃO

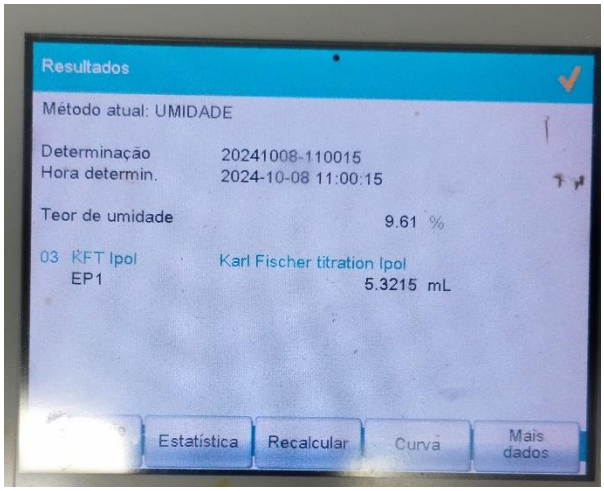

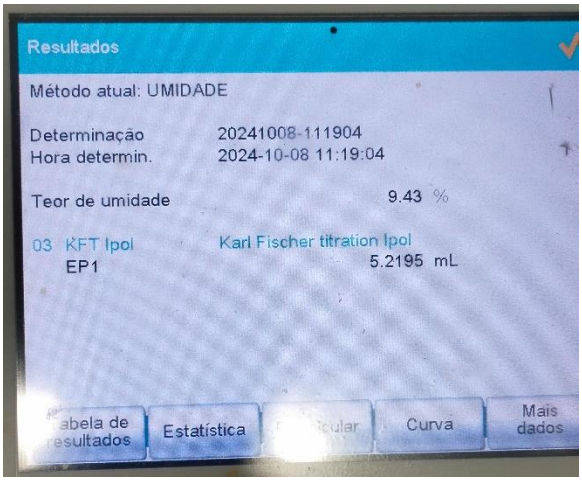

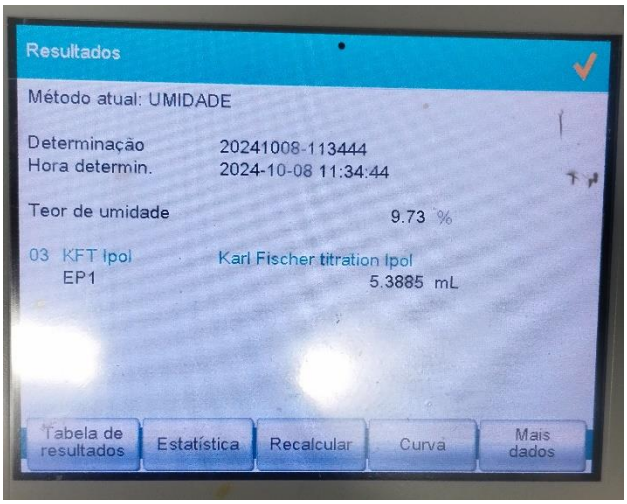
Resultados
Método atual: UMIDADE
Determinação 20241008-113444
Hora determin. 2024-10-08 11:34:44
Teor de umidade 9.73 %
03 KFT Ipol Karl Fischer titration Ipol
EP1 5.3885 mL
Tabela de resultados
Estatística
Recalcular
Curva
Mais dados

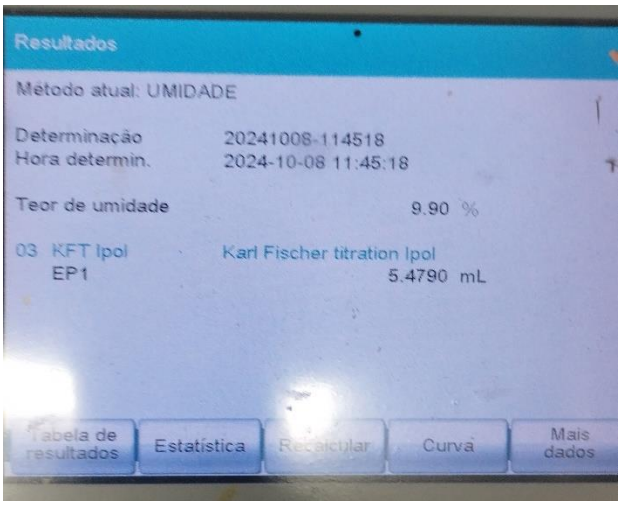
Resultados
Método atual: UMIDADE
Determinação 20241008-114518
Hora determin. 2024-10-08 11:45:18
Teor de umidade 9.90 %
03 KFT Ipol Karl Fischer titration Ipol
EP1 5.4790 mL
Tabela de resultados
Estatística
Recalcular
Curva
Mais dados

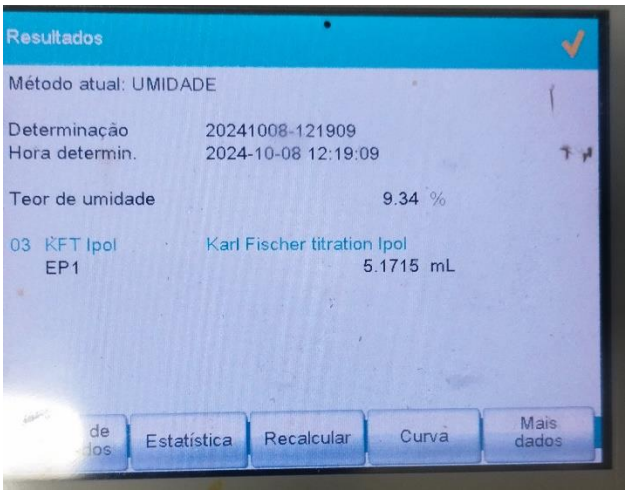
Resultados
Método atual: UMIDADE
Determinação 20241008-121909
Hora determin. 2024-10-08 12:19:09
Teor de umidade 9.34 %
03 KFT Ipol Karl Fischer titration Ipol
EP1 5.1715 mL
Estatística
Recalcular
Curva
Mais dados