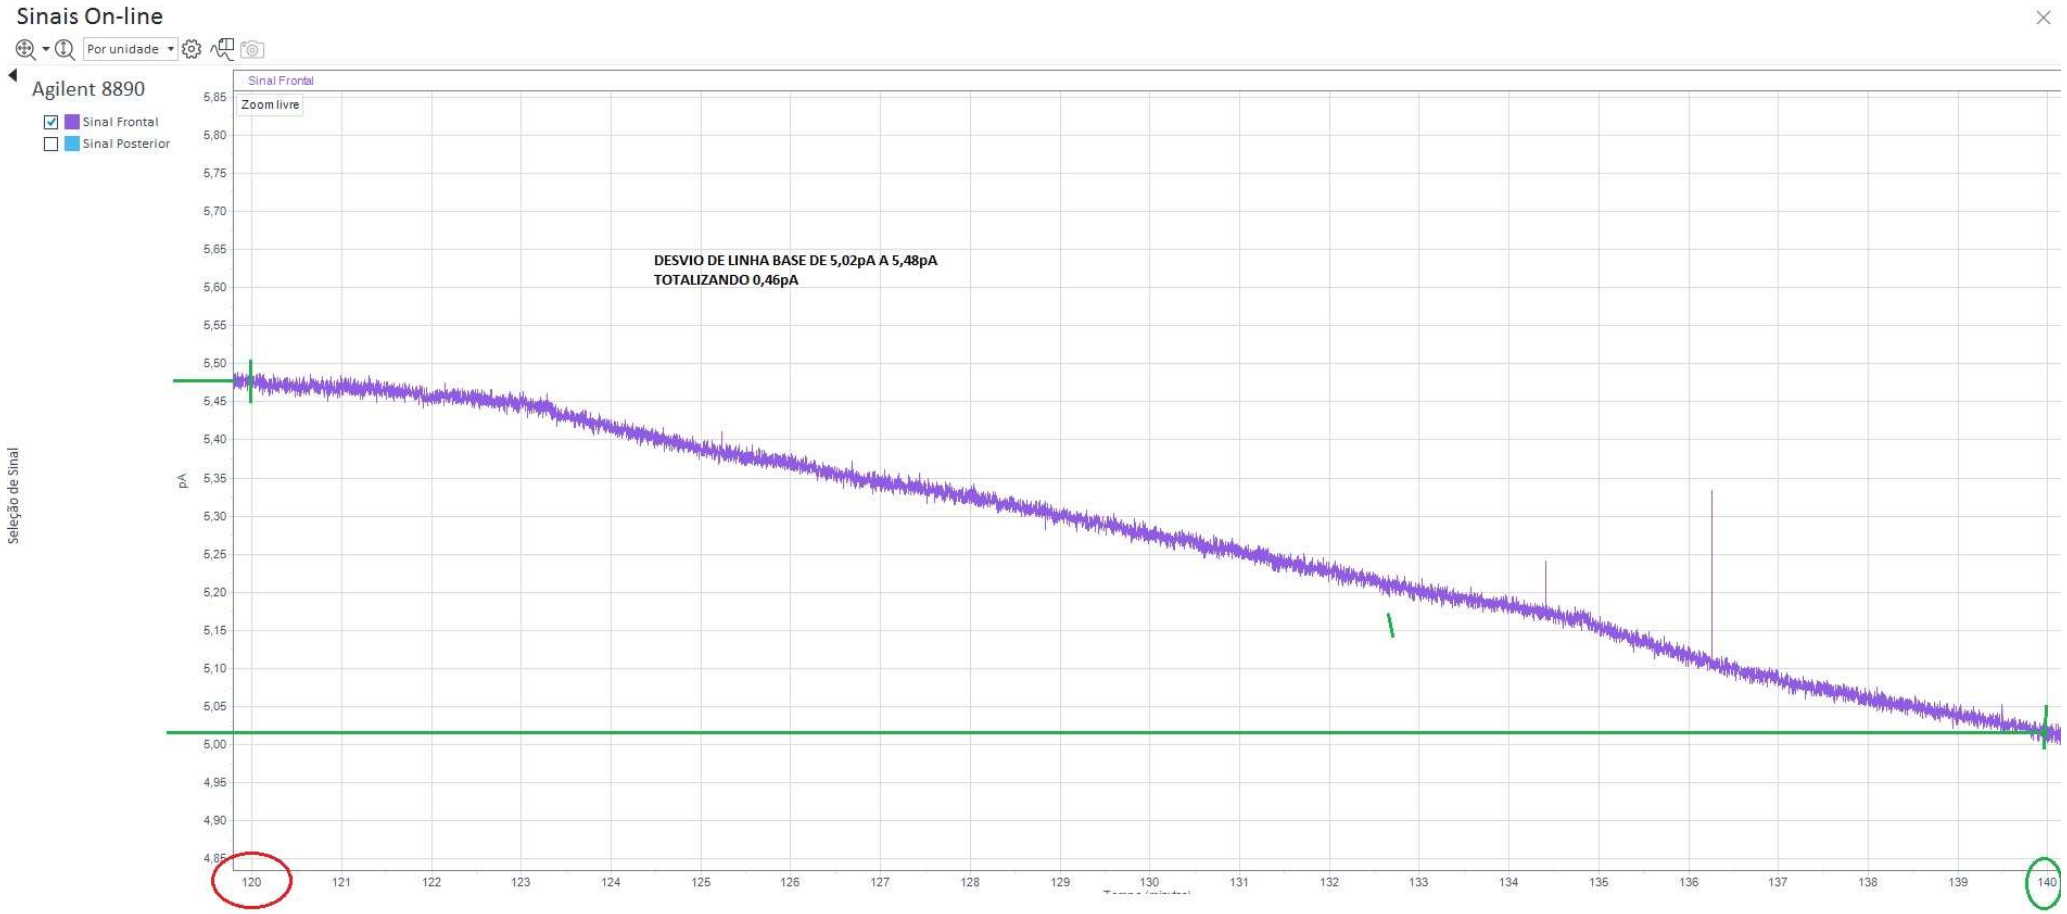

Sinais On-line
Por unidade
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Seleção de Sinal
Sinal Frontal
Zoom livre
DESVIO DE LINHA BASE DE 5,02pA A 5,48pA
TOTALIZANDO 0,46pA
pA
5,85
5,80
5,75
5,70
5,65
5,60
5,55
5,50
5,45
5,40
5,35
5,30
5,25
5,20
5,15
5,10
5,05
5,00
4,95
4,90
4,85
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-11-10-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_01FRONT
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 10:12:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	

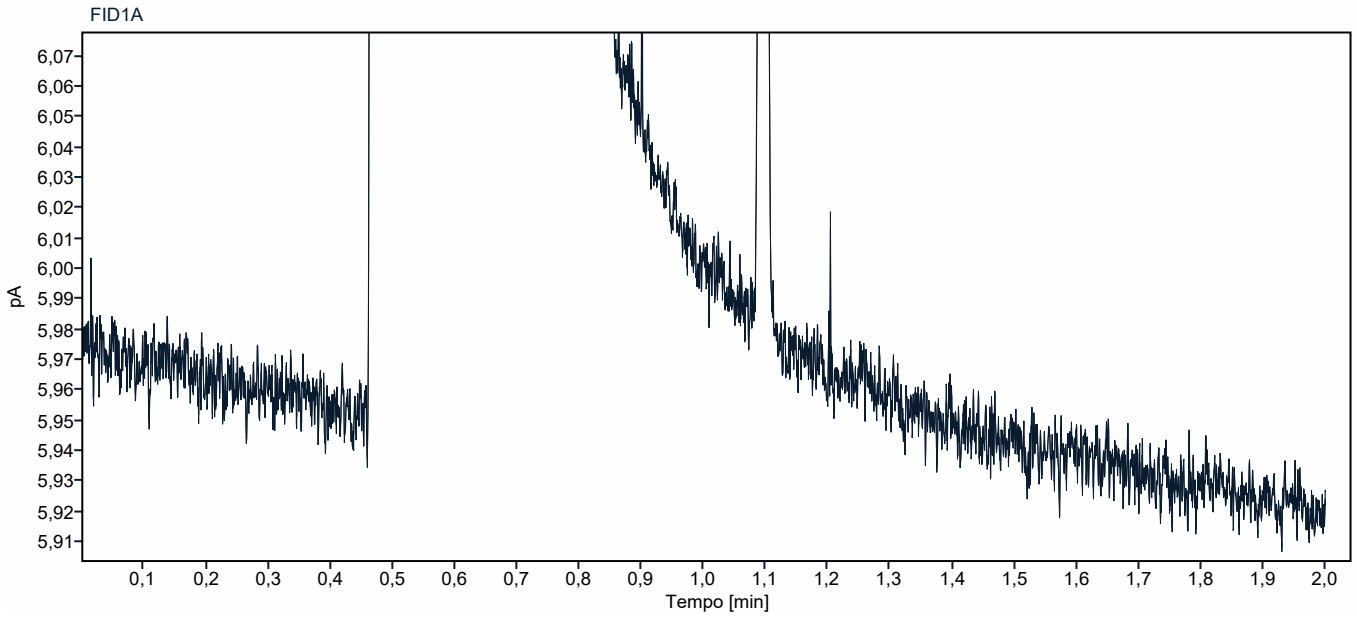


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010101057.rslt\2024-10-10 10-14-44-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN PC_1 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:16:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5
Série #:

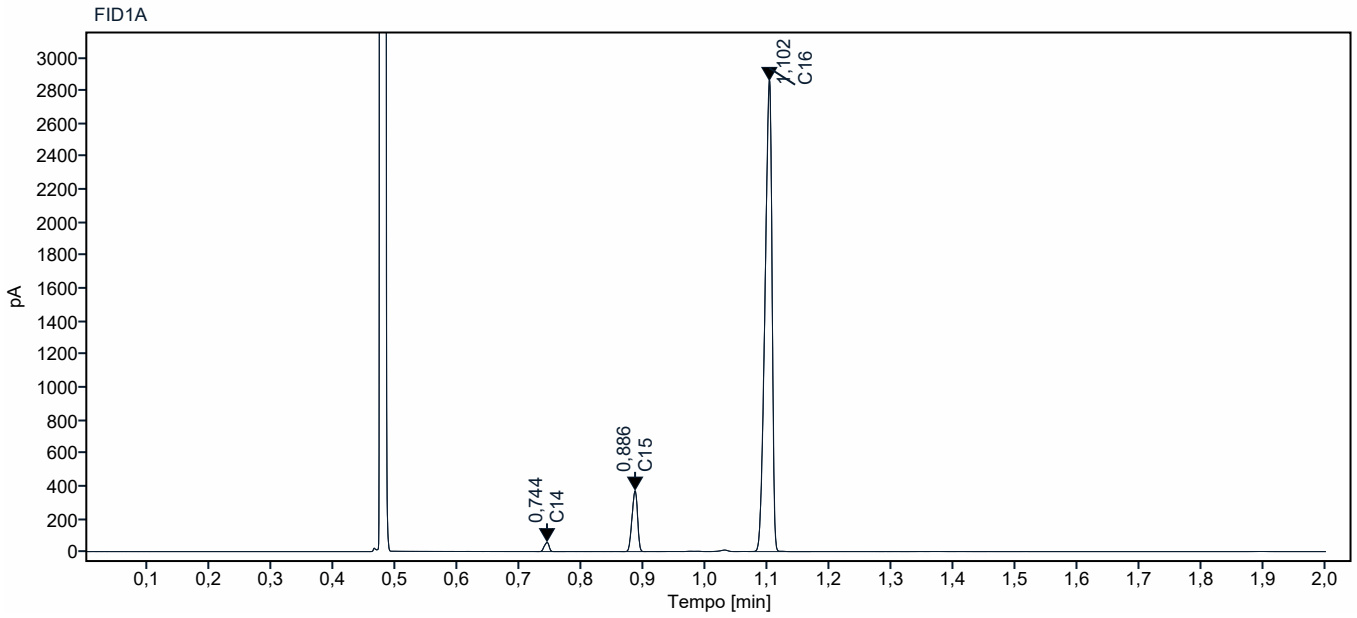


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744	C14	0,0468	29,8644	55,092	1,1915
0,886	C15	0,0395	229,5081	367,768	9,1569
1,102	C16	0,1013	2247,0266	2854,656	89,6516
		Soma	**2506,3992**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-18-06-03-00-03.dx
Nome da amostra: PCIN PC_2 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:19:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

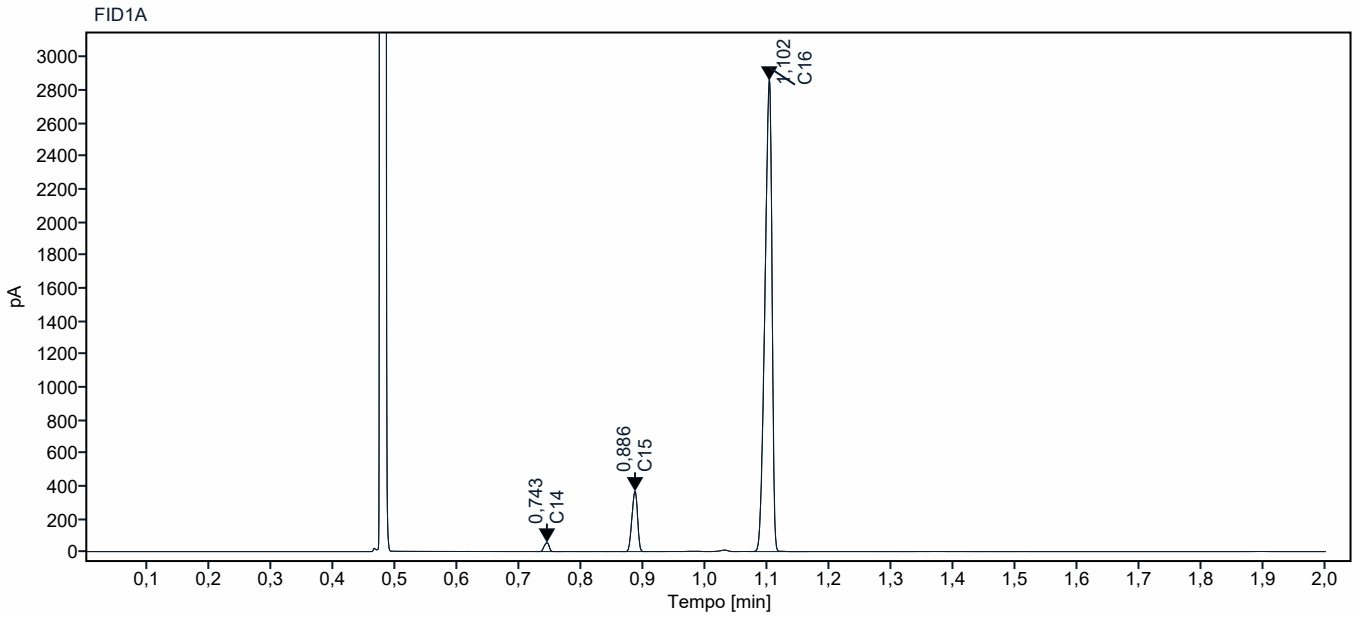


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0451	29,9996	53,574	1,1901
0,886	C15	0,0382	230,7686	364,528	9,1546
1,102	C16	0,0965	2260,0282	2855,348	89,6553
		Soma	**2520,7964**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-21-24-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN PC_3 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:22:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

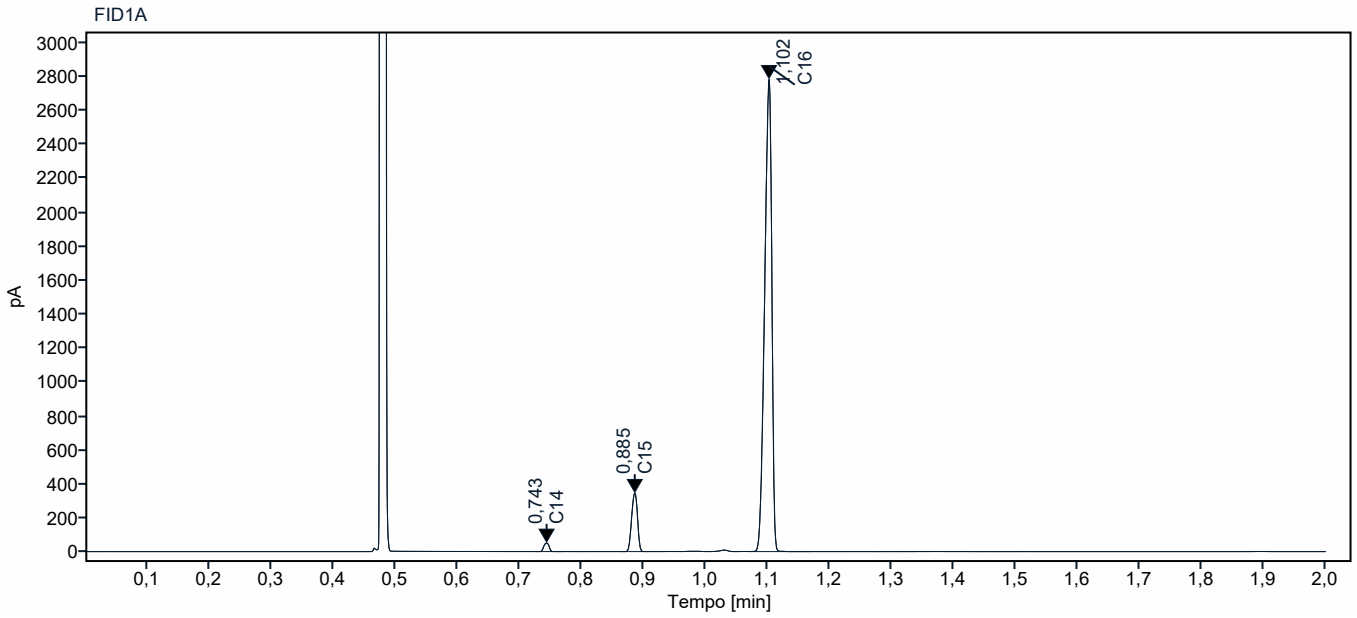

Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0431	29,5479	50,230	1,1926
0,885	C15	0,0386	226,9948	342,832	9,1617
1,102	C16	0,1006	2221,0997	2778,823	89,6457
		Soma	**2477,6424**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-24-42-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_02 FRONT
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 10:25:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	


Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	

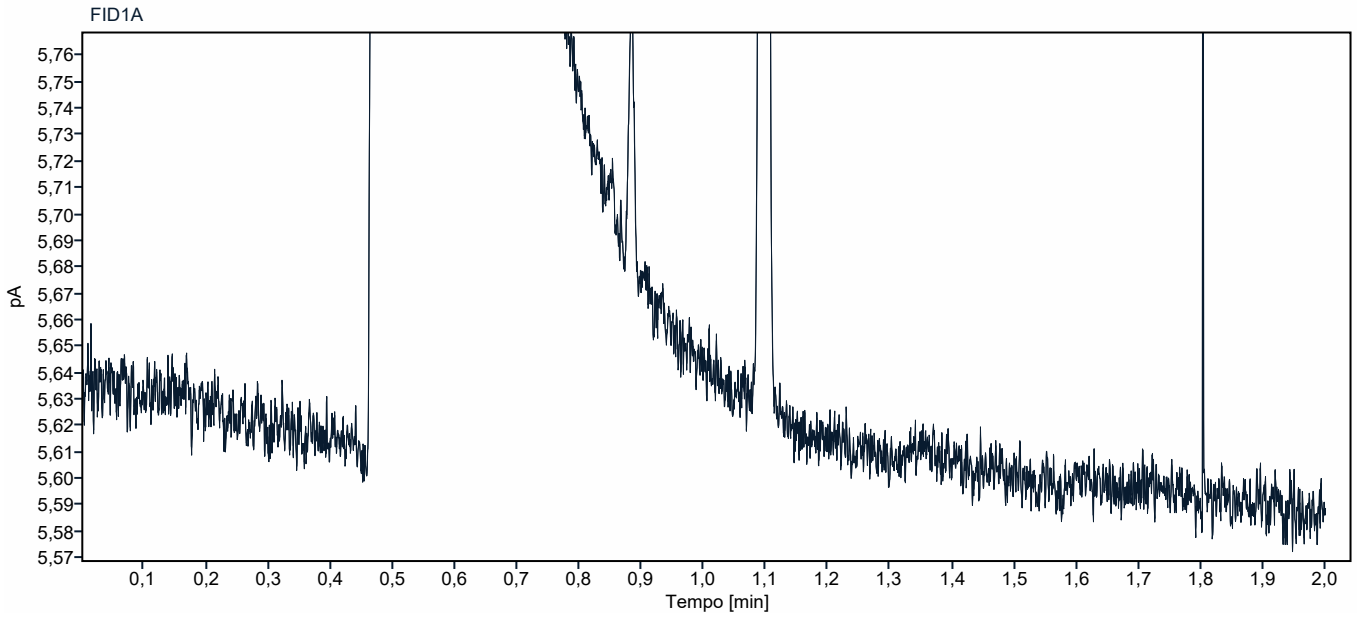

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-28-00-03-00-06.dx
Nome da amostra: PCIN PC_4 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:29:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

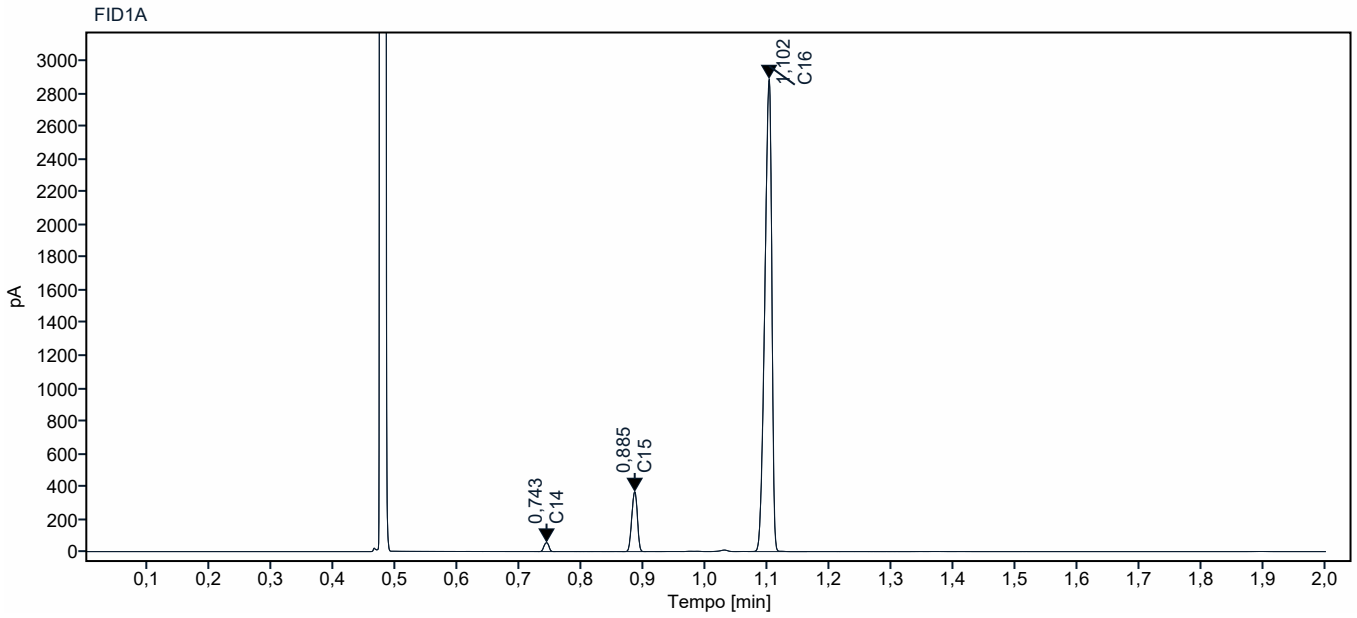


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0280	30,0720	53,943	1,1937
0,885	C15	0,0387	230,9792	363,563	9,1684
1,102	C16	0,0954	2258,2593	2887,558	89,6380
		Soma	**2519,3105**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-31-16-03-00-07.dx
Nome da amostra: PCIN PC_5 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:32:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

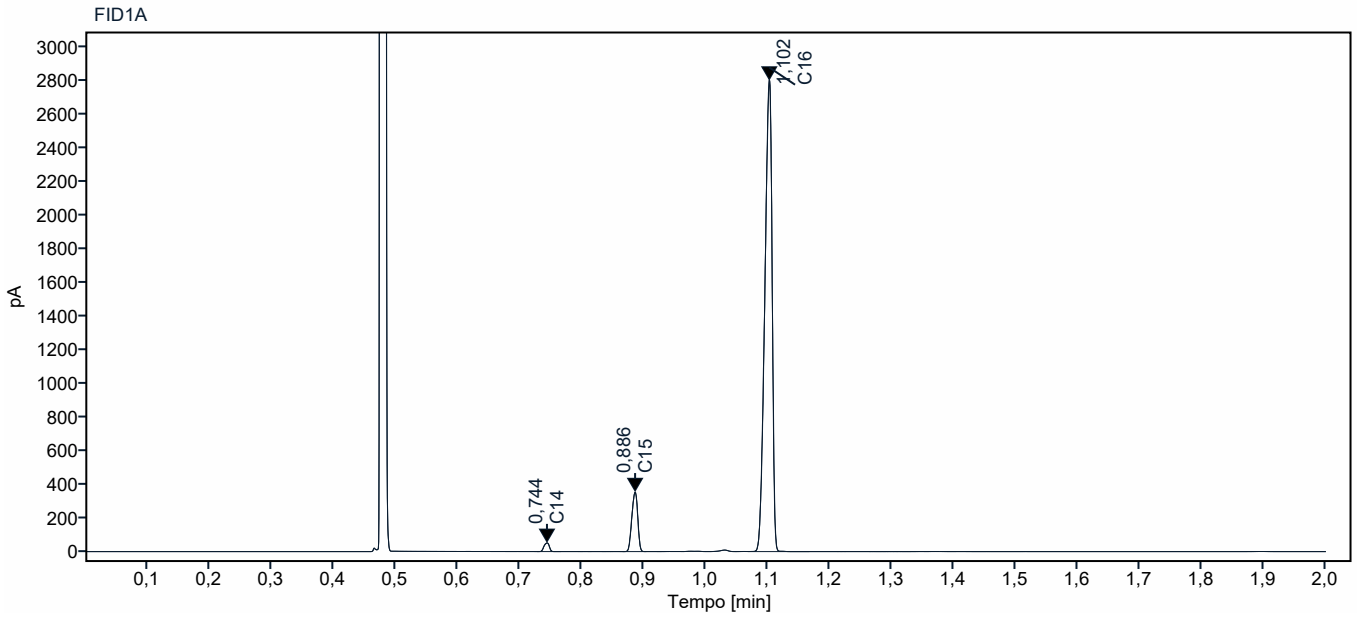


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744	C14	0,0385	30,3334	50,724	1,1912
0,886	C15	0,0382	233,2759	352,211	9,1610
1,102	C16	0,0994	2282,7838	2792,580	89,6477
		Soma	**2546,3931**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-34-33-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN PC_6 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:35:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

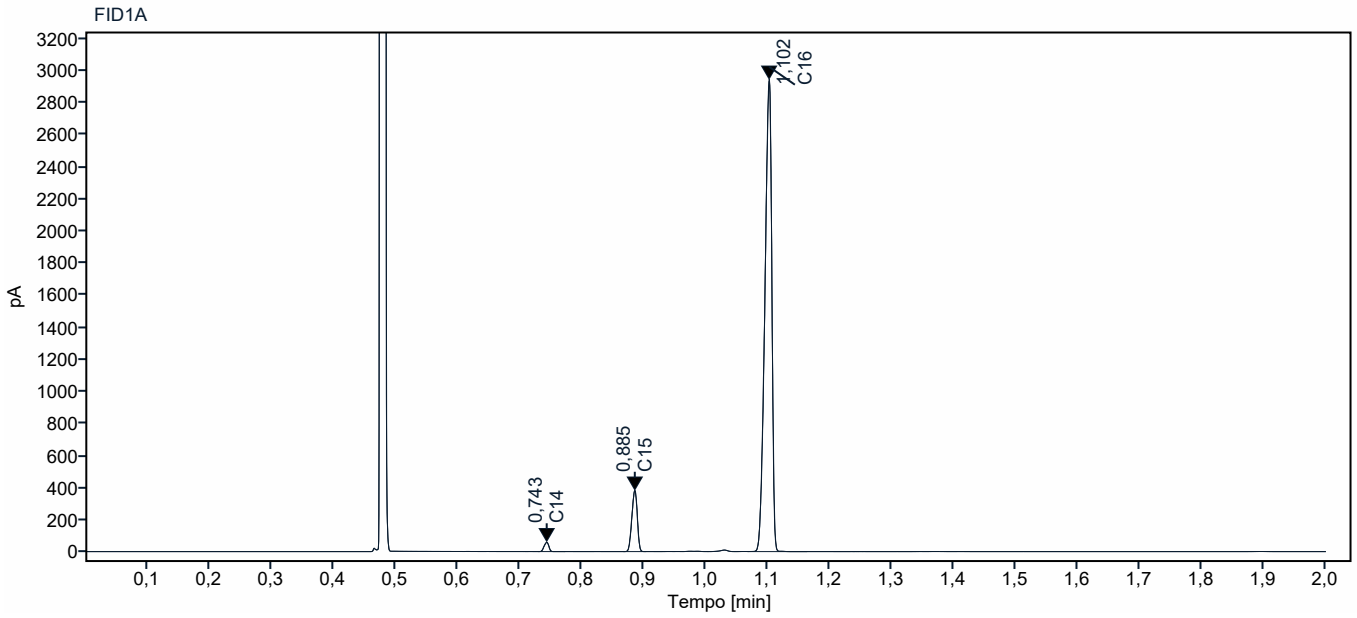

Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0436	30,2526	57,082	1,1903
0,885	C15	0,0368	232,6788	377,892	9,1552
1,102	C16	0,0955	2278,5645	2937,567	89,6545
		Soma	**2541,4959**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-37-50-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_03 FRONT
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 10:39:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	


Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	

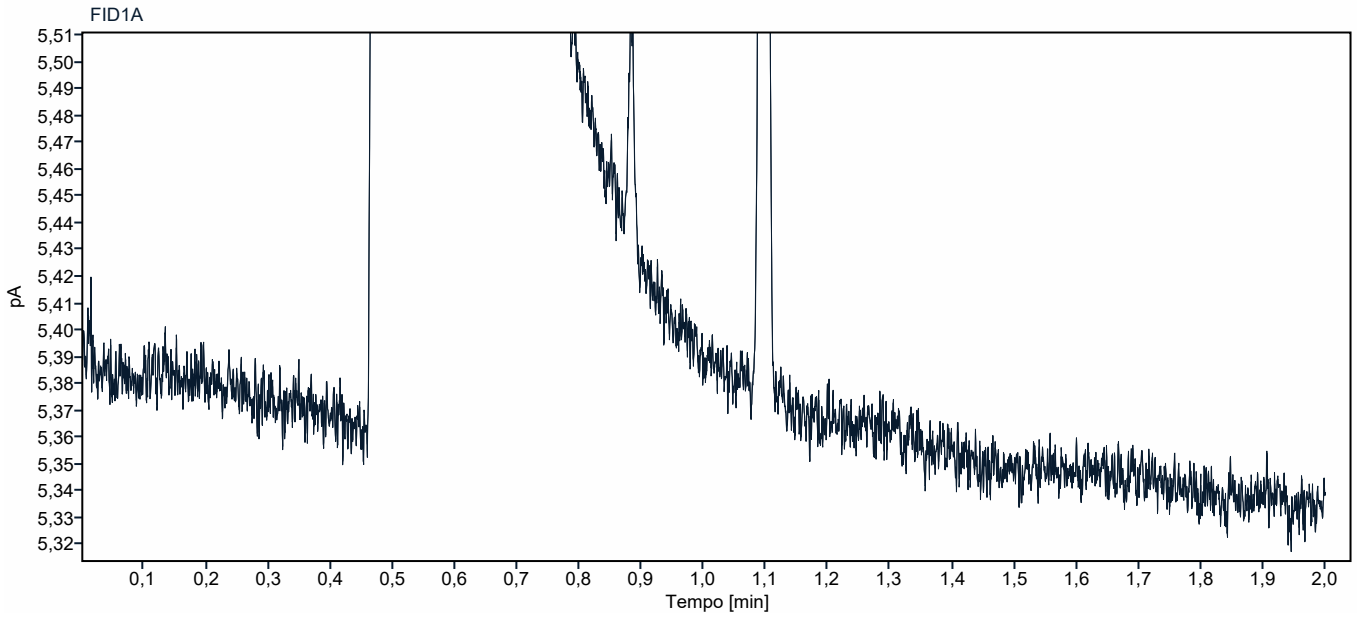

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-41-08-03-00-10.dx
Nome da amostra: LDFI_1 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:42:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

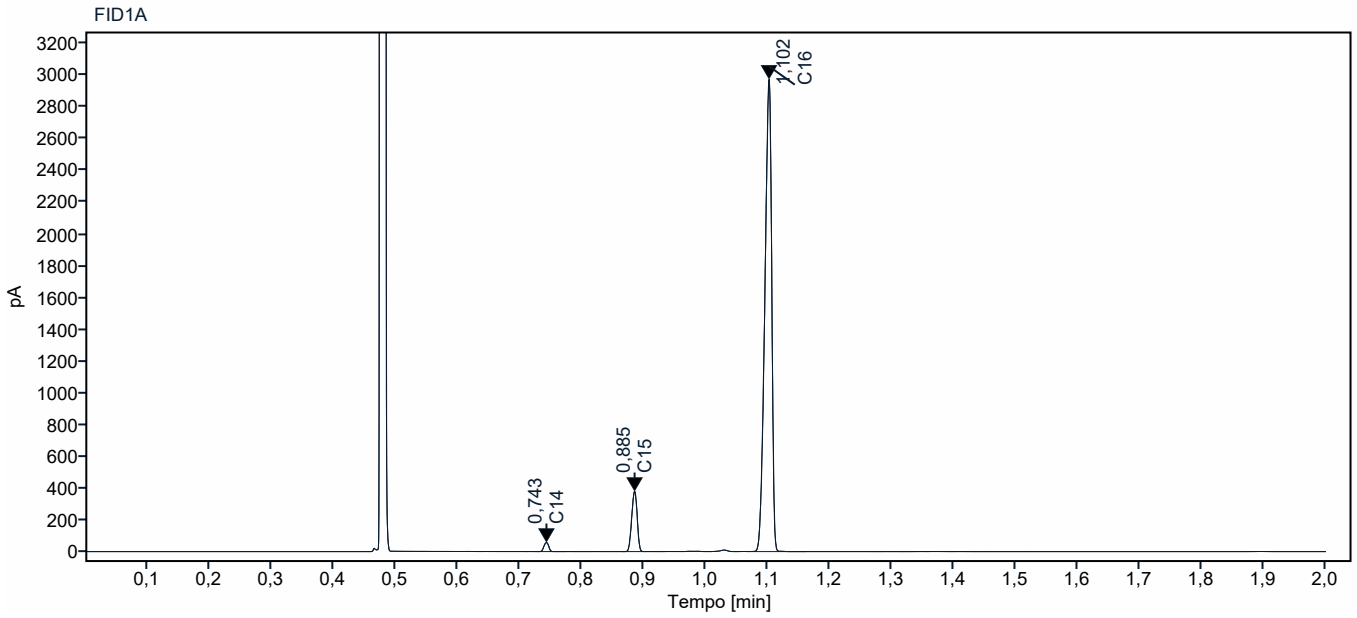


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0464	30,2818	55,988	1,1908
0,885	C15	0,0384	232,9284	376,908	9,1596
1,102	C16	0,0942	2279,7936	2968,804	89,6496
		Soma	**2543,0037**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-44-26-03-00-11.dx
Nome da amostra: LDFI_2 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:45:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

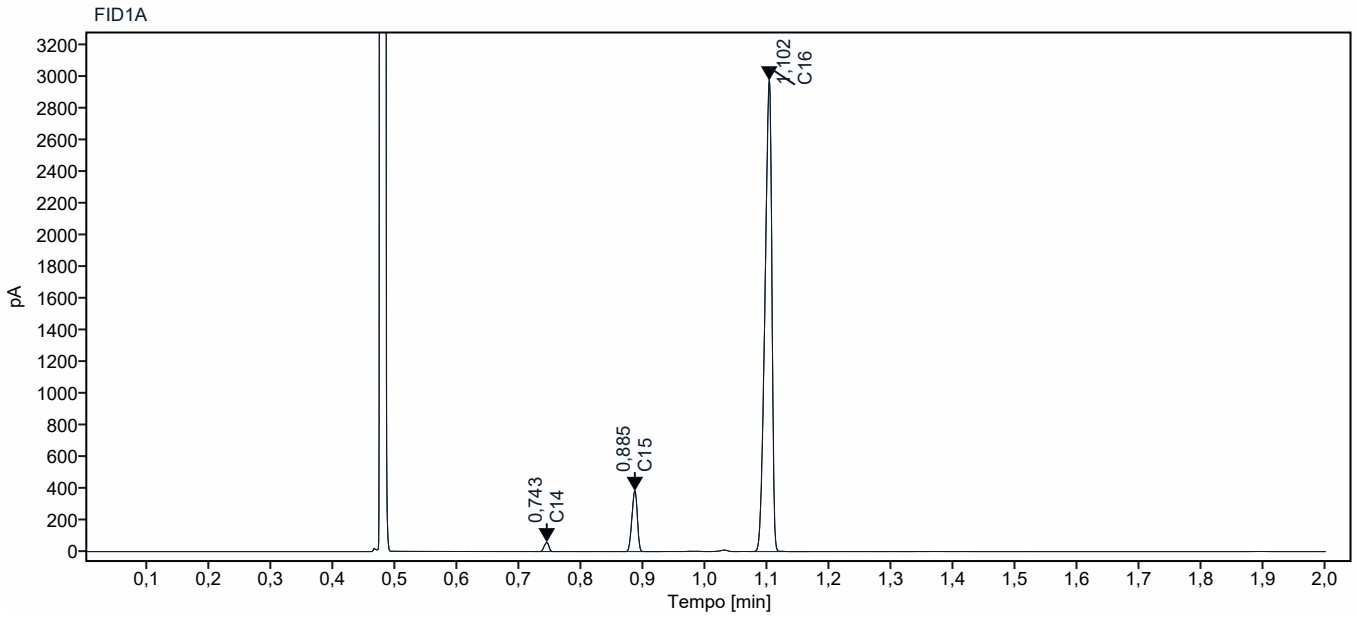


Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,743	C14	0,0360	30,3244	57,341	1,1882
0,885	C15	0,0580	233,5782	380,385	9,1523
1,102	C16	0,0995	2288,2273	2966,540	89,6595
		Soma	**2552,1300**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT


Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 101057.rslt\2024-10-10 10-47-40-03-00-12.dx
Nome da amostra: LDFI_3 FRONT
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 10:48:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK FRONT-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	RTX-5		
Série #:			

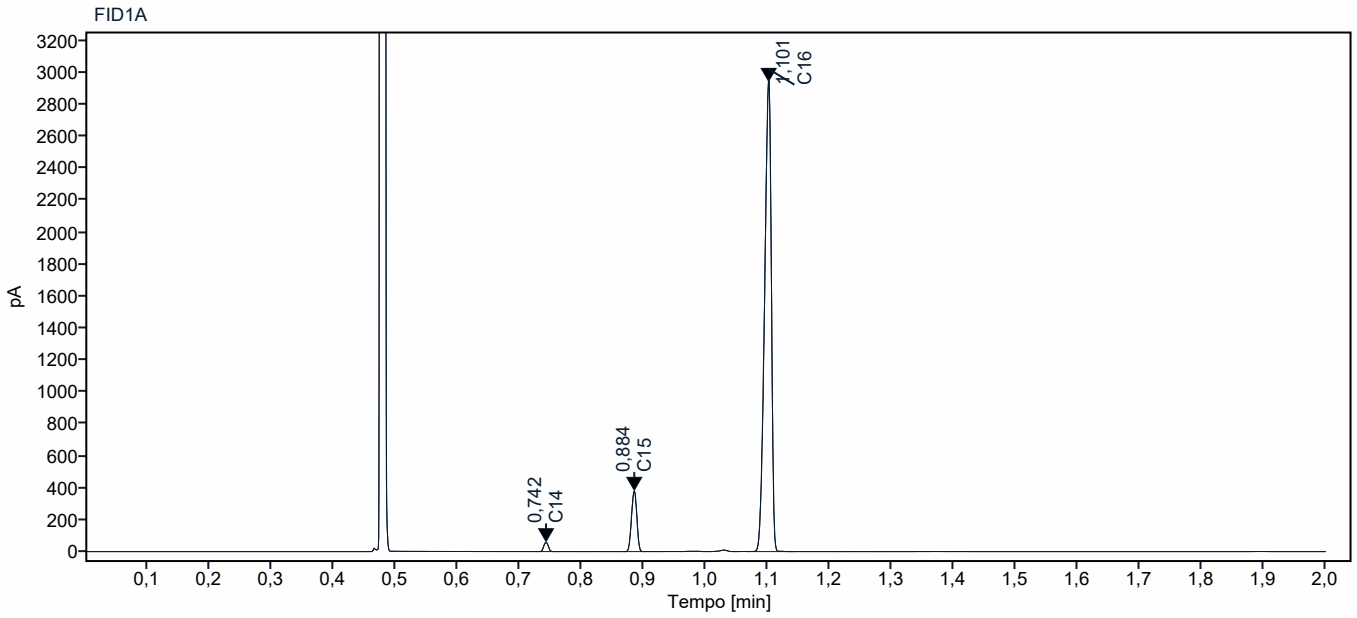

Sinal: FID1A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,742	C14	0,0324	29,5696	56,473	1,1922
0,884	C15	0,0363	227,2661	377,319	9,1633
1,101	C16	0,0755	2223,3300	2933,455	89,6444
		Soma	**2480,1656**		

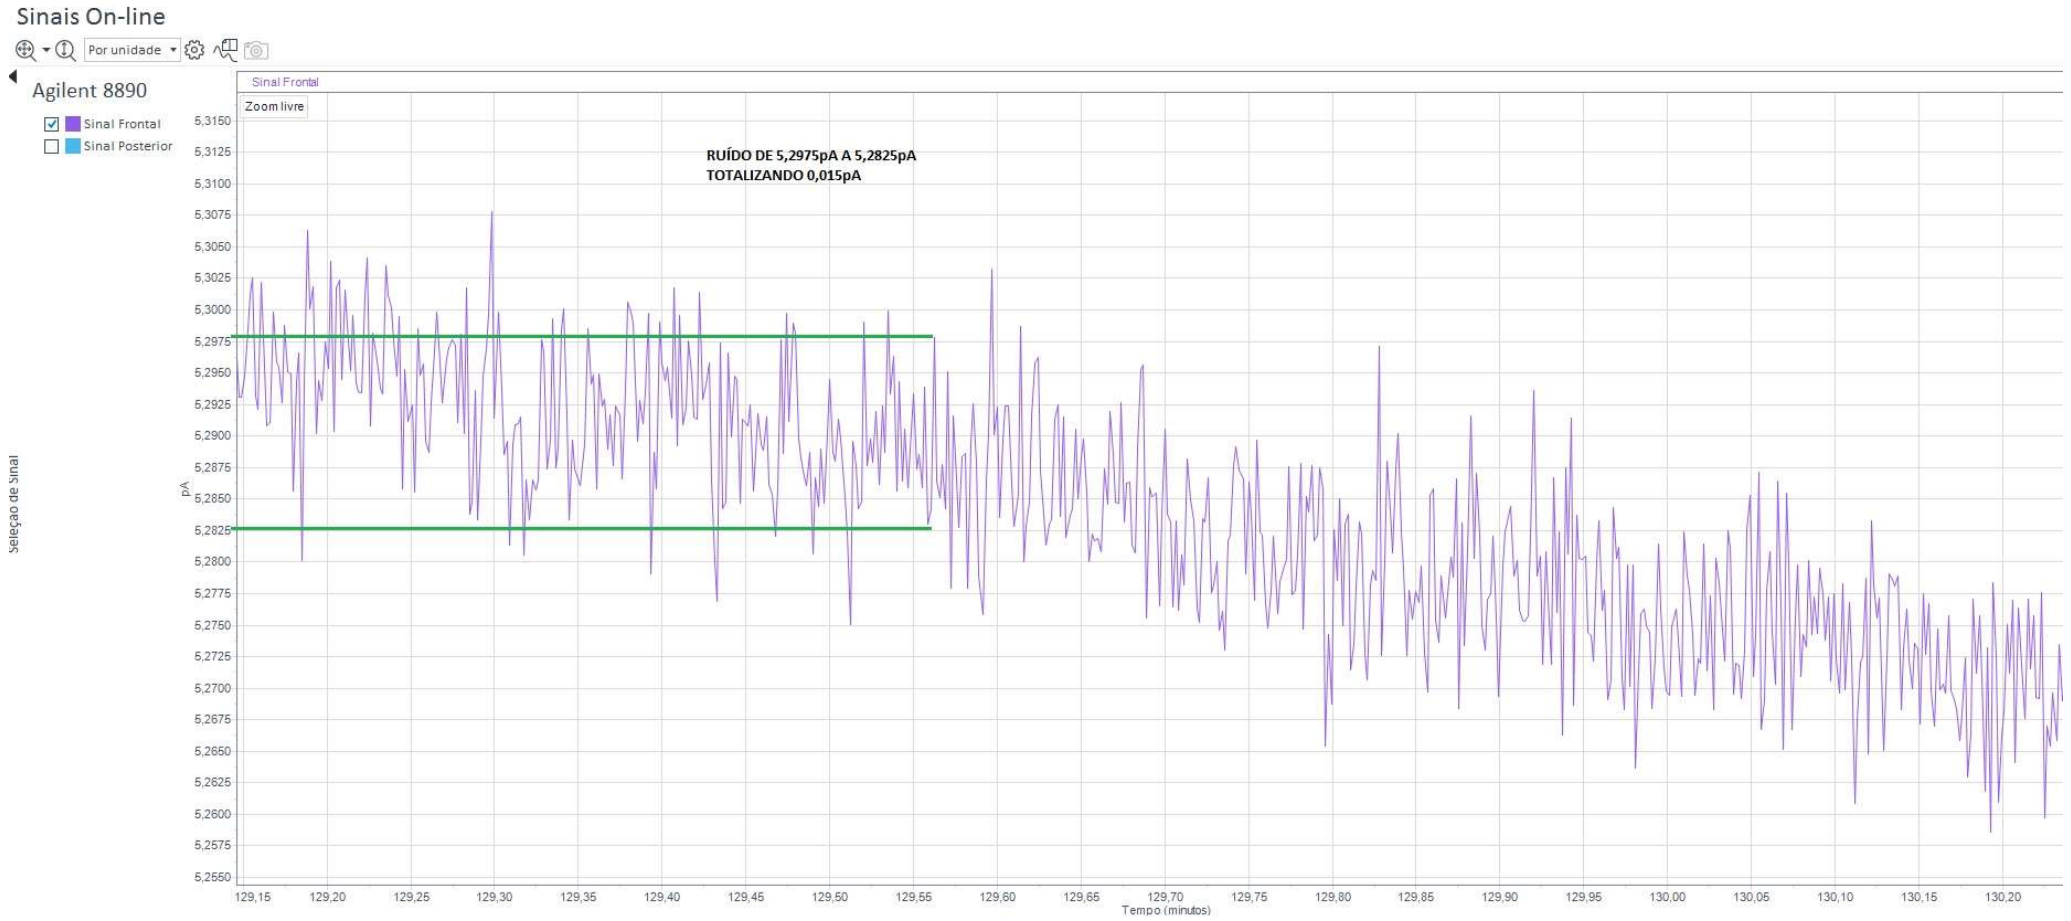
Sinais On-line
Por unidade
Agilent 8890
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Seleção de Sinal
Sinal Frontal
Zoom livre
RUÍDO DE 5,2975pA A 5,2825pA
TOTALIZANDO 0,015pA
pA
5,3150
5,3125
5,3100
5,3075
5,3050
5,3025
5,3000
5,2975
5,2950
5,2925
5,2900
5,2875
5,2850
5,2825
5,2800
5,2775
5,2750
5,2725
5,2700
5,2675
5,2650
5,2625
5,2600
5,2575
5,2550
129,15
129,20
129,25
129,30
129,35
129,40
129,45
129,50
129,55
129,60
129,65
129,70
129,75
129,80
129,85
129,90
129,95
130,00
130,05
130,10
130,15
130,20
Tempo (minutos)