
Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-03-36-03-00-01.dx
Nome da amostra:	Branco PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 16:06:06-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	


Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

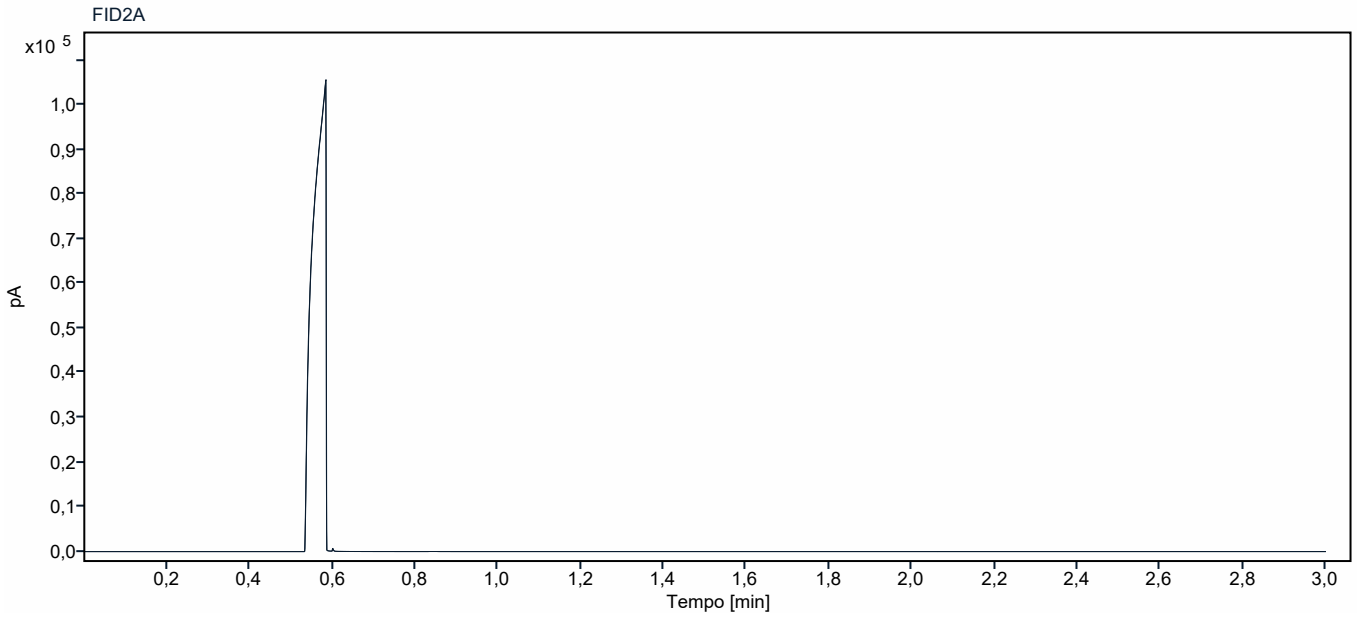

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-09-09-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:11:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

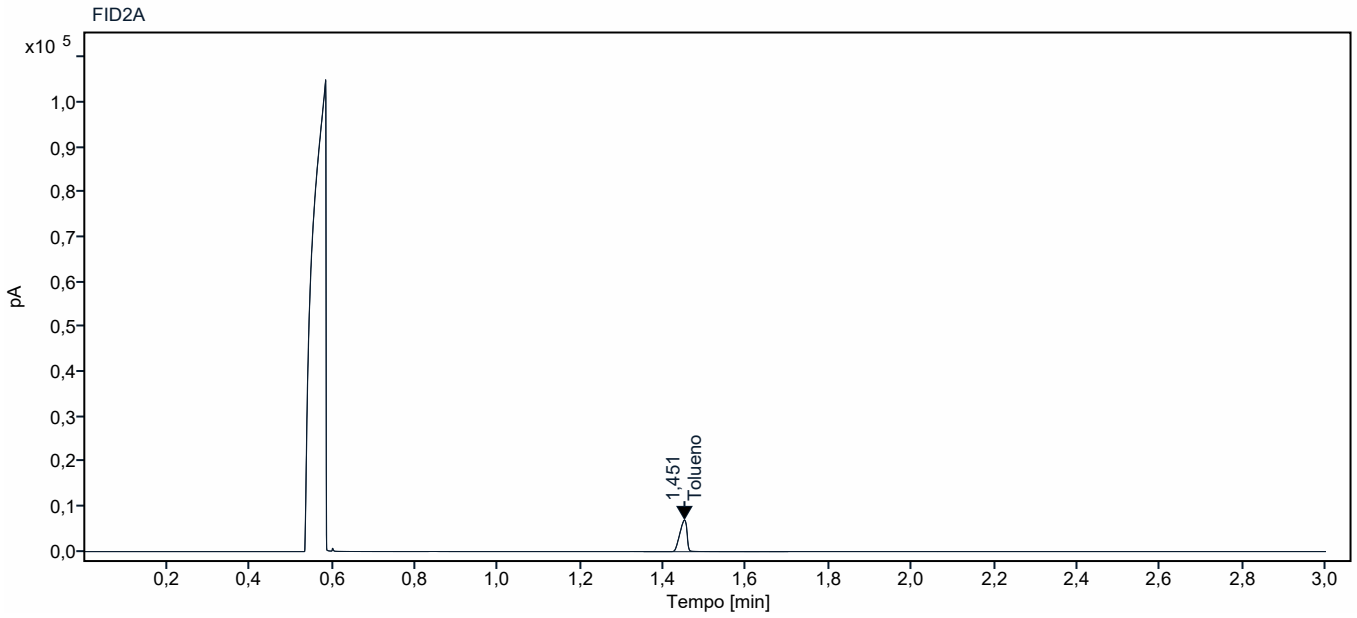

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,451	Tolueno	0,3493	8882,5756	6993,728	100,0000
		Soma	**8882,5756**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-14-17-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:16:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

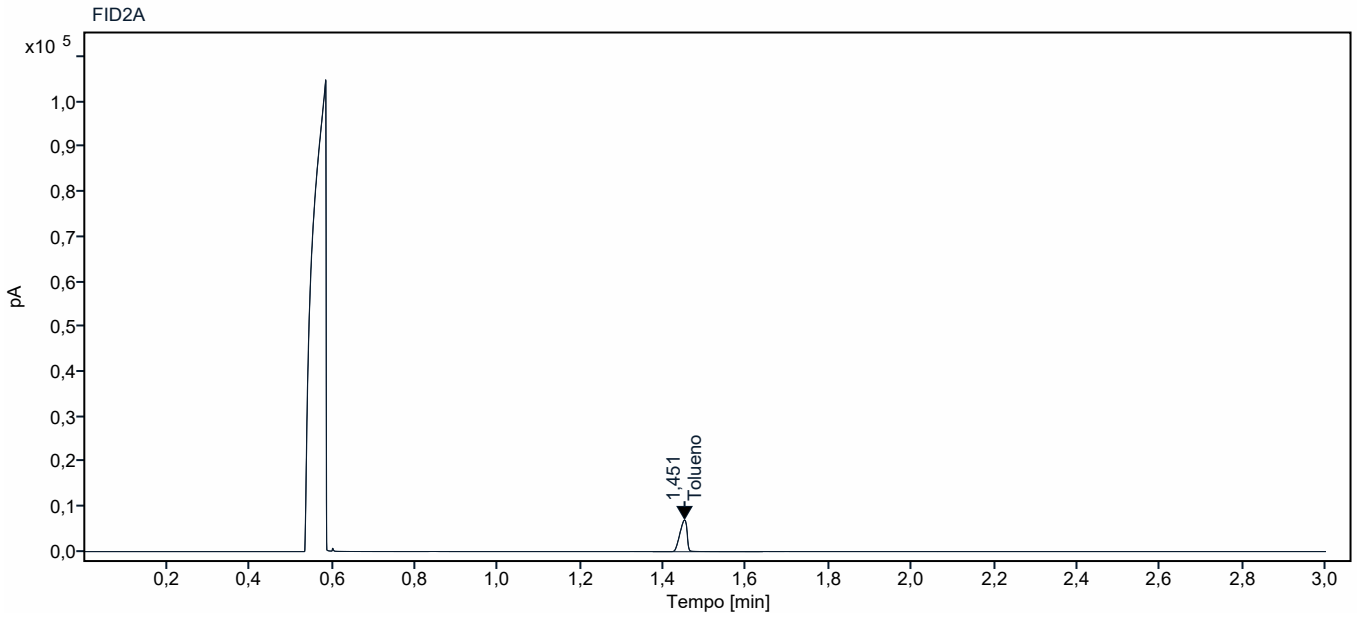

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,451	Tolueno	0,2654	8933,8974	6987,516	100,0000
		Soma	**8933,8974**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-19-24-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:21:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

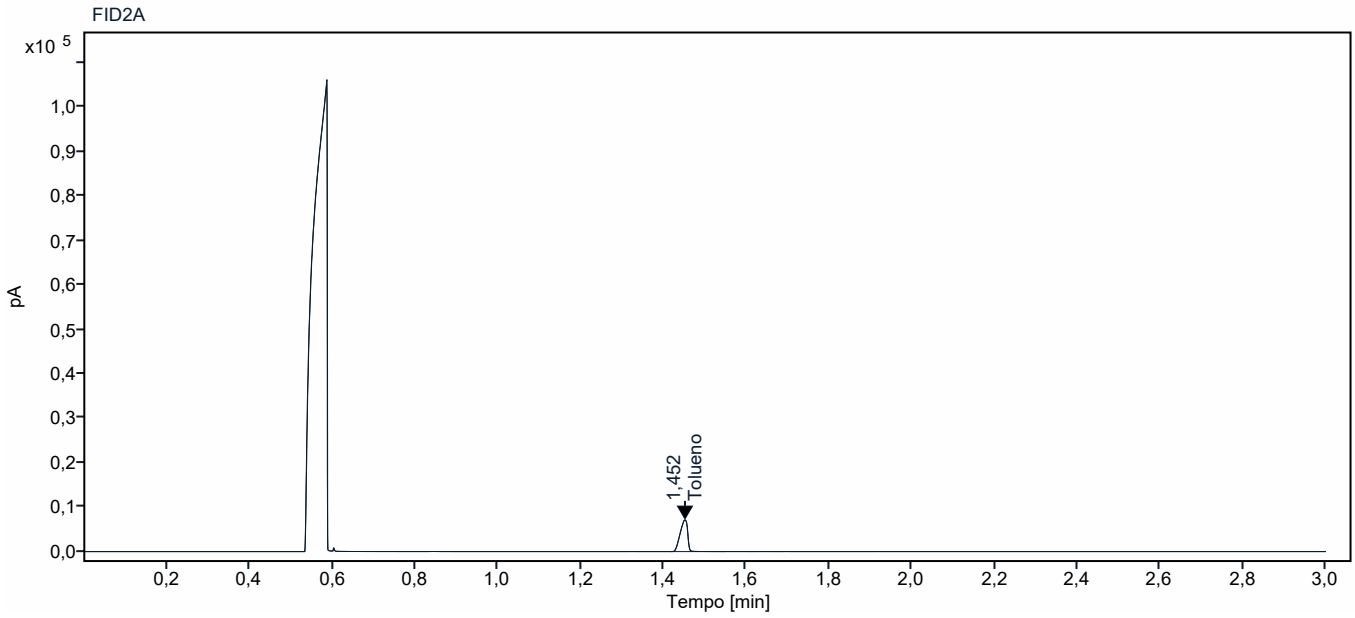

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,452	Tolueno	0,1339	8949,9846	7110,093	100,0000
		Soma	**8949,9846**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-24-28-03-00-05.dx
Nome da amostra:	Branco PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 16:26:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

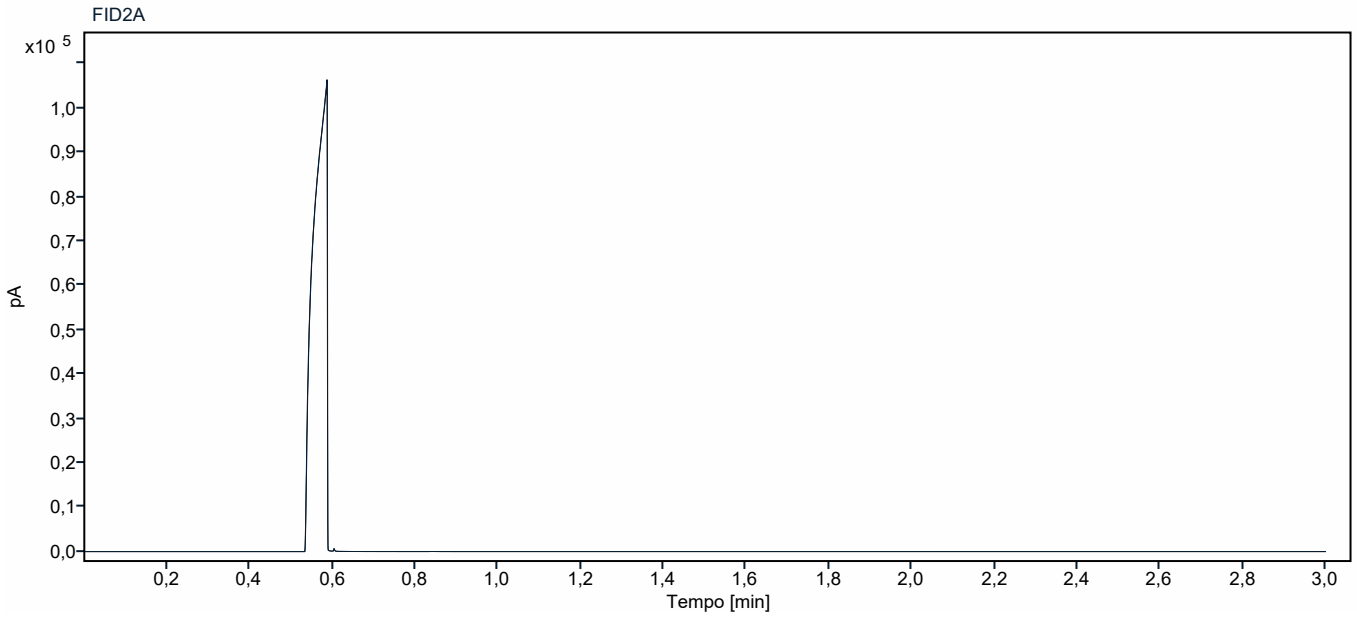


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-29-42-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN 04
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:31:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

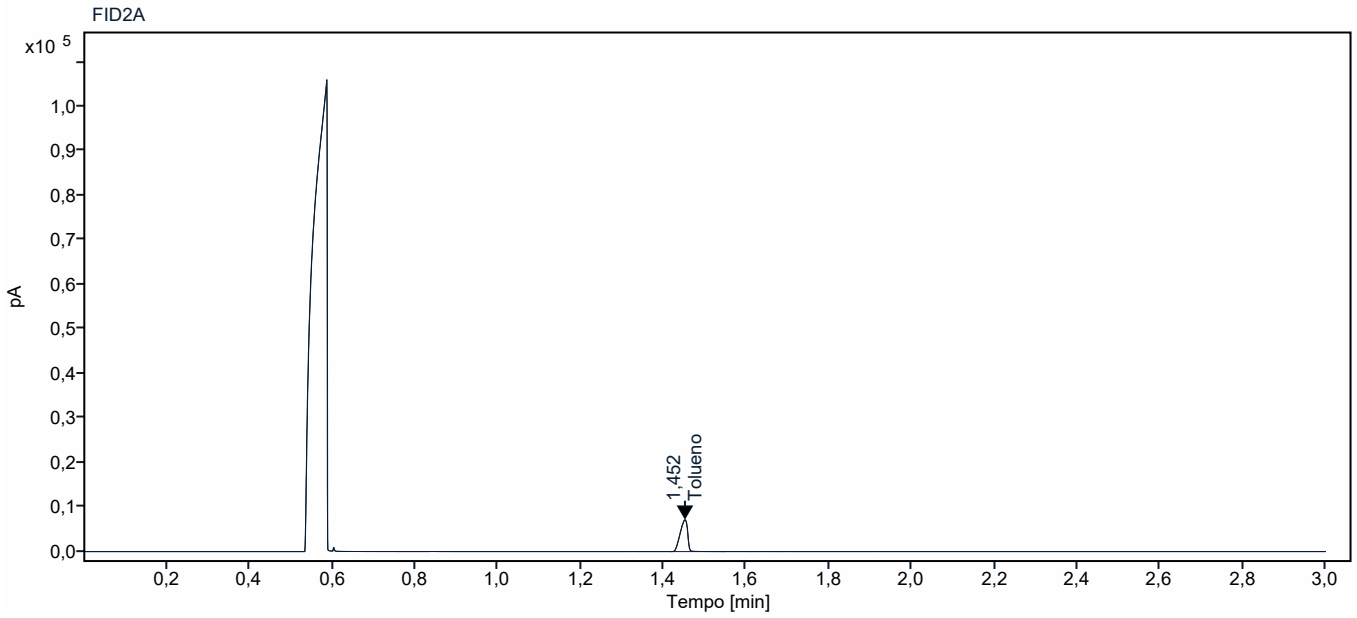

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,452	Tolueno	0,1344	8942,2746	7143,312	100,0000
		Soma	**8942,2746**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-34-49-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN 05
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:36:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

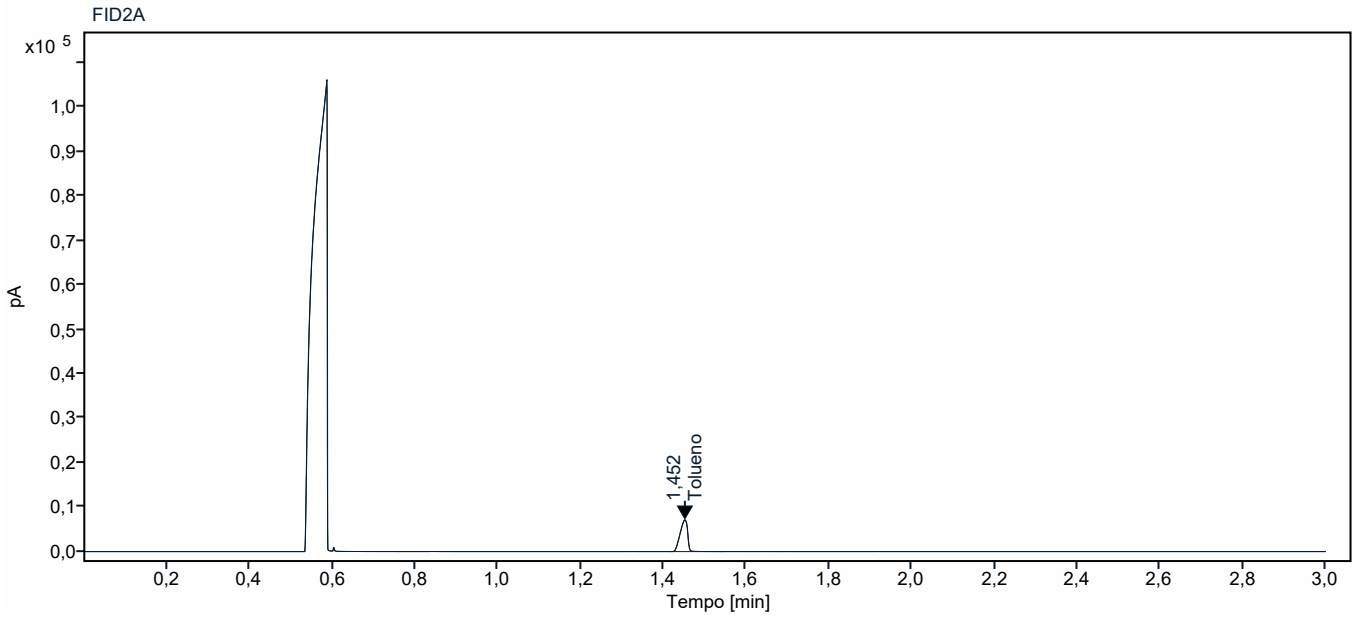

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,452	Tolueno	0,1343	8955,5266	7133,382	100,0000
		Soma	**8955,5266**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-39-54-03-00-08.dx
Nome da amostra:	PCIN 06
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 16:41:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

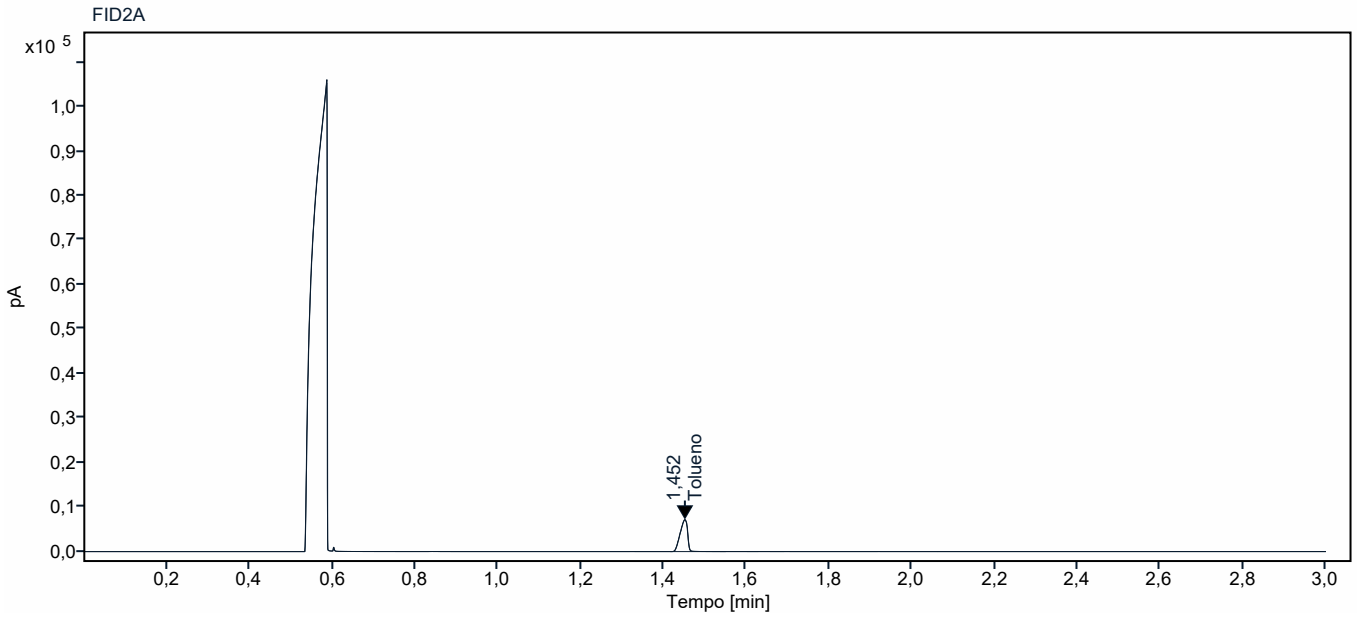

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
1,452	Tolueno	0,1338	8946,0434	7180,762	100,0000
		Soma	**8946,0434**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN FRONT 002.rslt\2023-10-10 16-45-01-03-00-09.dx
Nome da amostra:	Branco PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 16:47:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 16:54:37-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

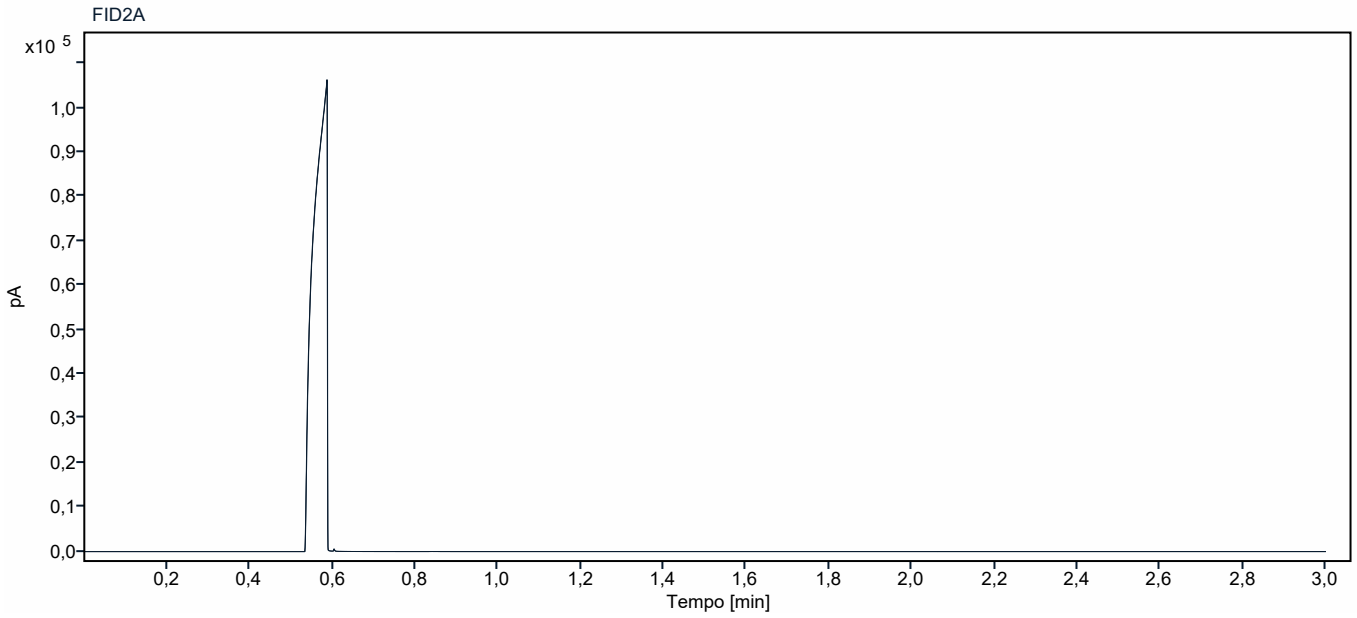


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-15-53-03-00-01.dx
Nome da amostra: Branco PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 17:17:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

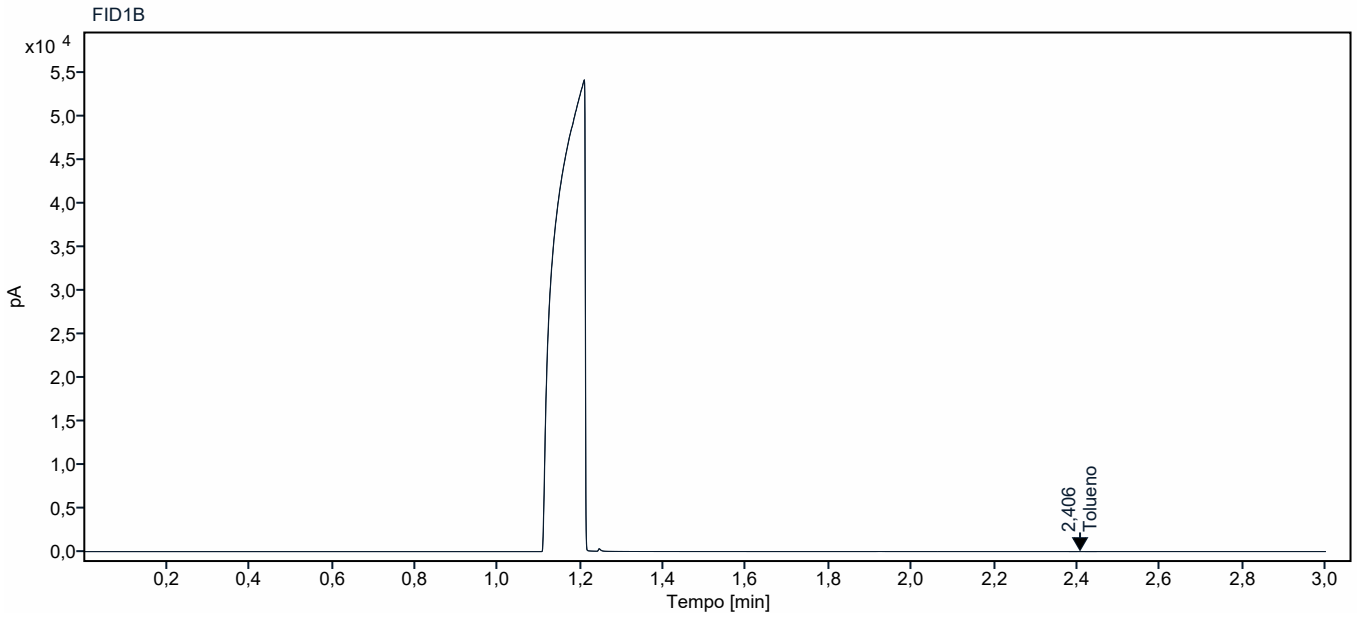

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,406	Tolueno	0,0673	3,0481	1,977	100,0000
		Soma	**3,0481**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-20-33-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 17:23:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

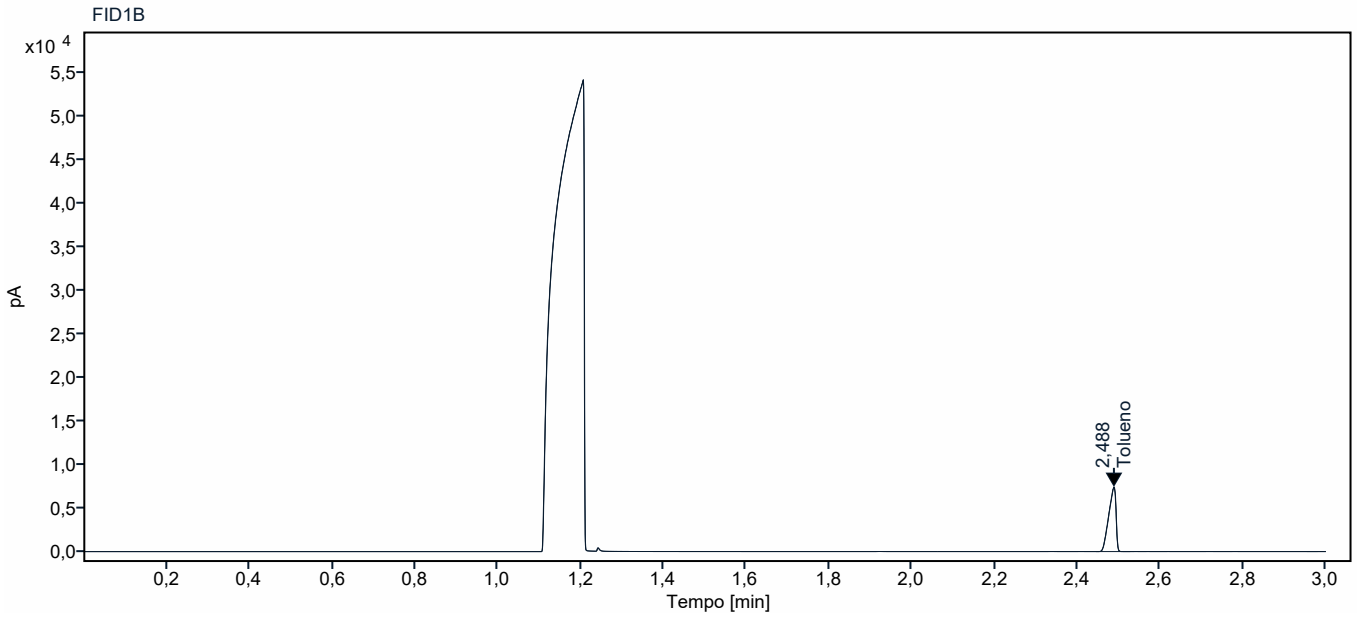

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,488	Tolueno	0,0826	8999,5792	7407,965	100,0000
		Soma	**8999,5792**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-26-47-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 17:30:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

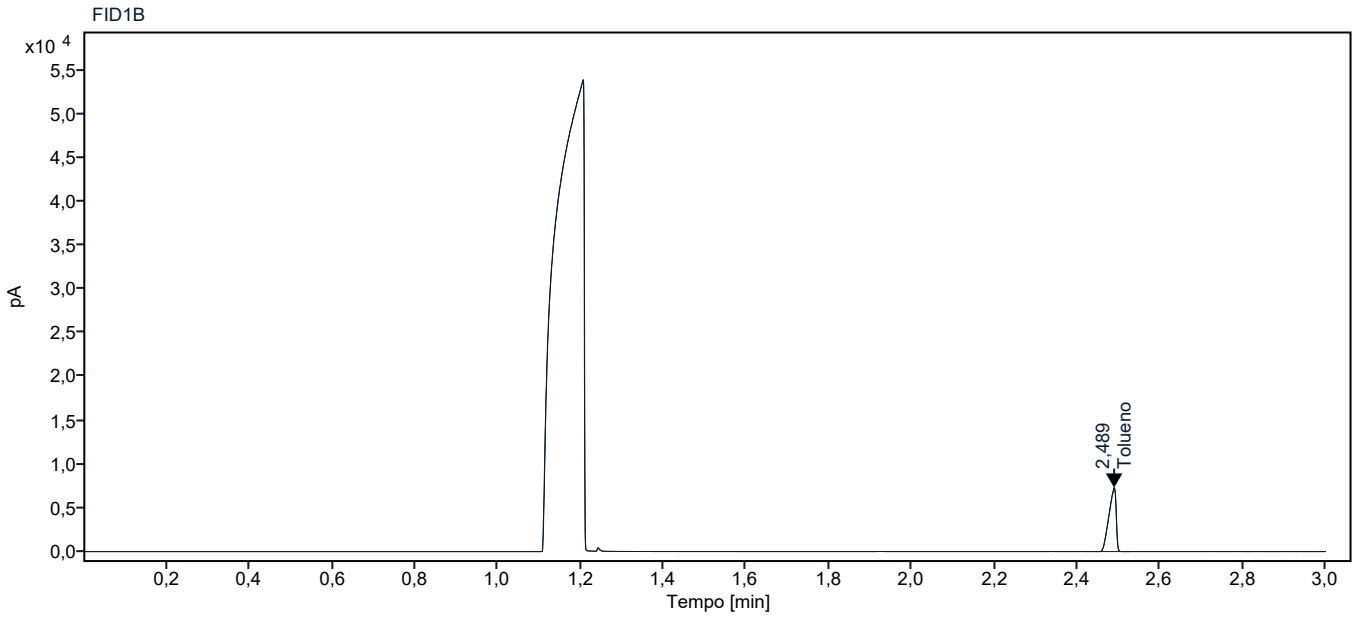

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,489	Tolueno	0,0833	8843,0170	7300,557	100,0000
		Soma	**8843,0170**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-33-08-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 17:36:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

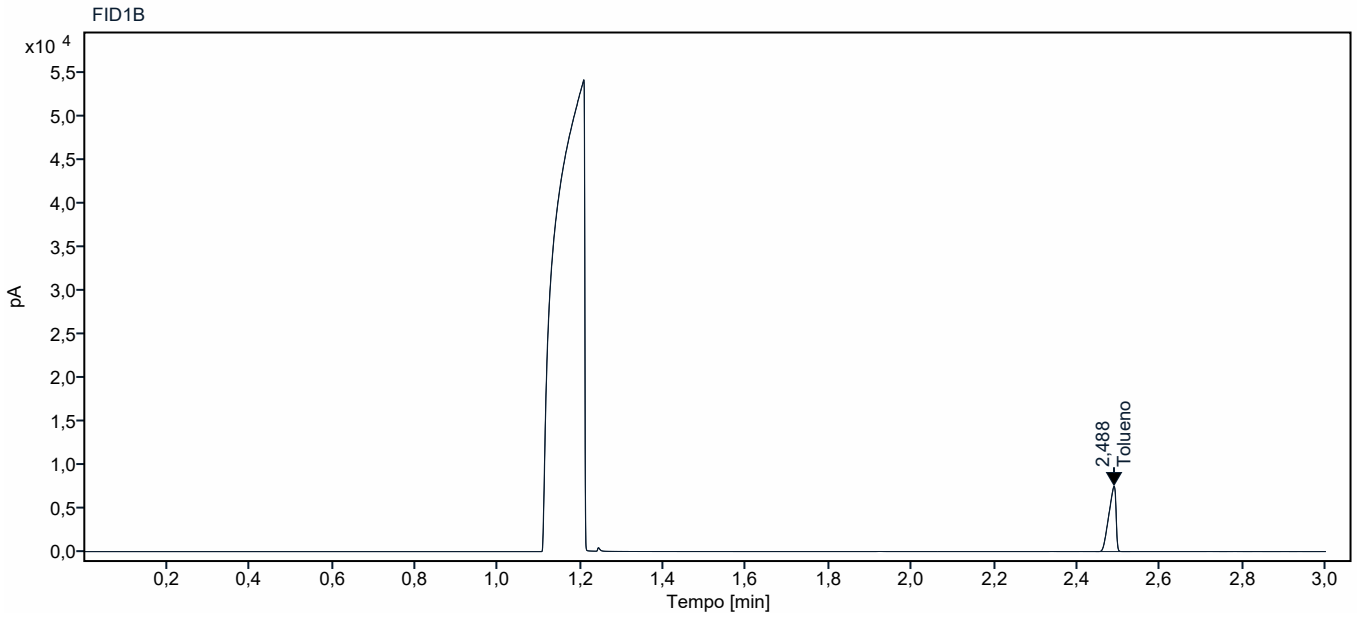

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,488	Tolueno	0,0836	9018,2483	7495,193	100,0000
		Soma	**9018,2483**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-39-22-03-00-05.dx
Nome da amostra: Branco PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 17:42:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

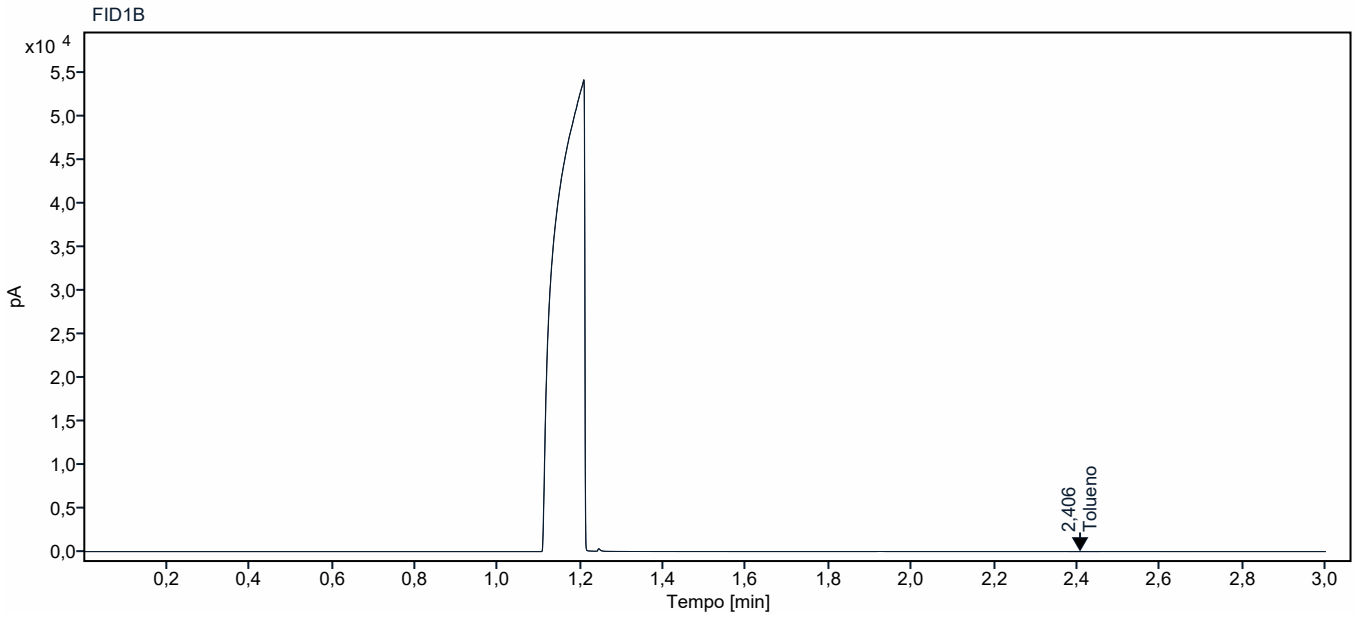

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,406	Tolueno	0,0769	2,9020	1,910	100,0000
		Soma	**2,9020**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-45-38-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN 04
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 17:48:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

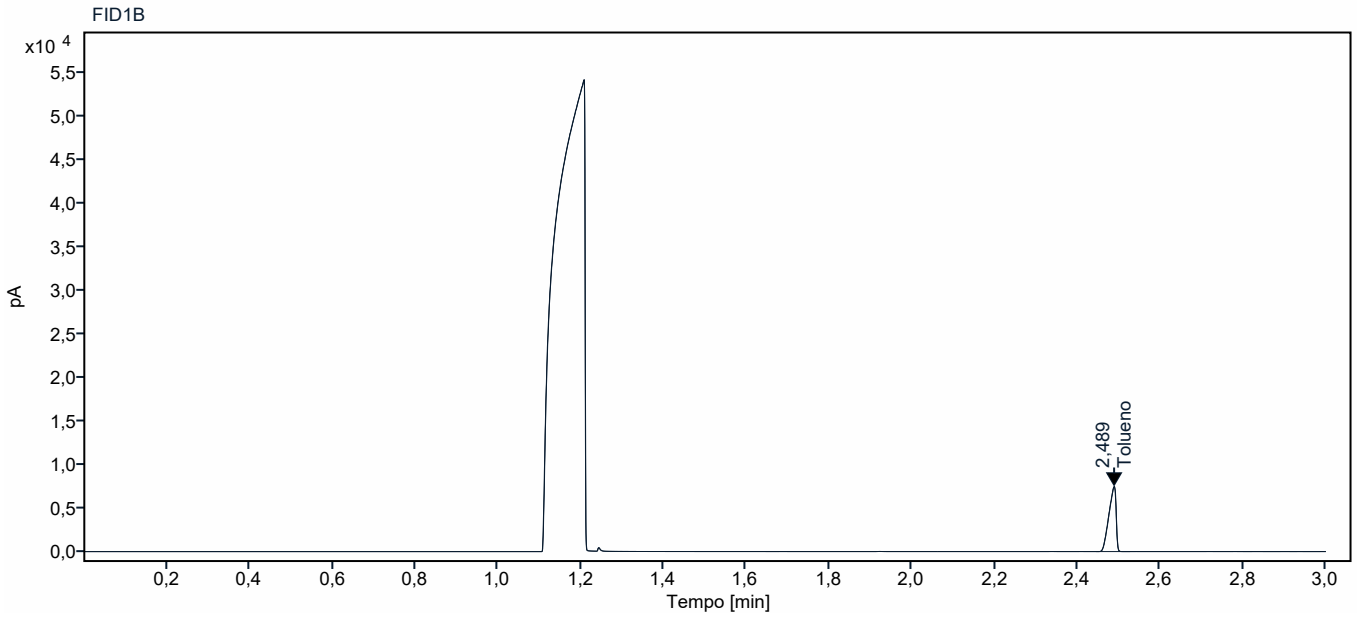

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,489	Tolueno	0,0820	9050,5641	7472,180	100,0000
		Soma	**9050,5641**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-51-45-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN 05
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 17:54:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

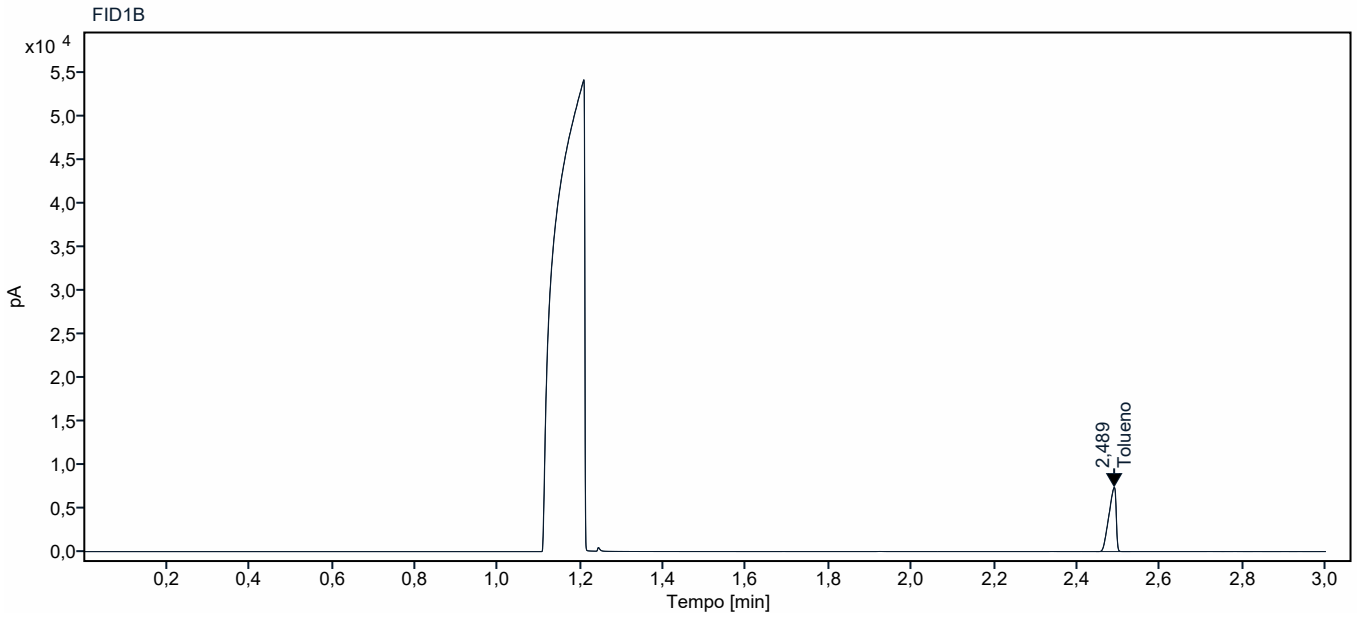

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,489	Tolueno	0,0830	8977,0512	7376,078	100,0000
		Soma	**8977,0512**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 17-57-56-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2023-10-10 18:01:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

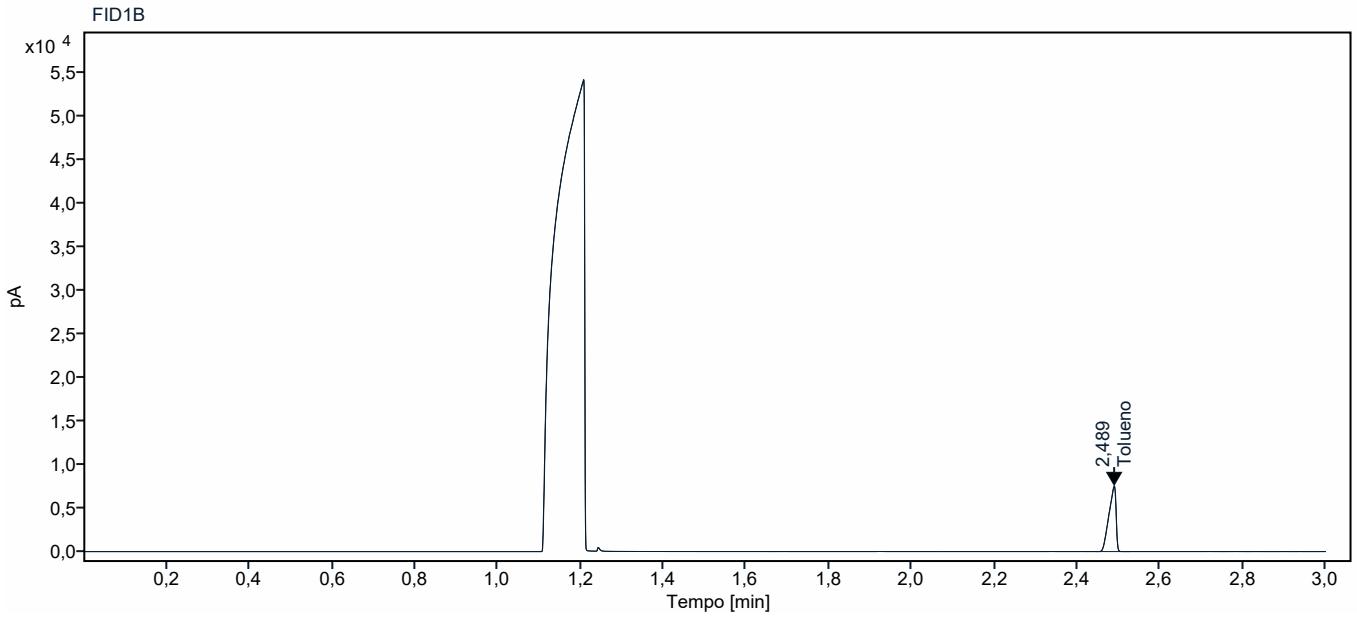

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,489	Tolueno	0,0832	8968,0455	7514,761	100,0000
		Soma	**8968,0455**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2023\Results\CG 01\Qualificação 2023\PCIN BACK 001.rslt\2023-10-10 18-04-08-03-00-09.dx
Nome da amostra: Branco PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2023-10-10 18:07:15-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração PCIN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-10-10 18:15:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

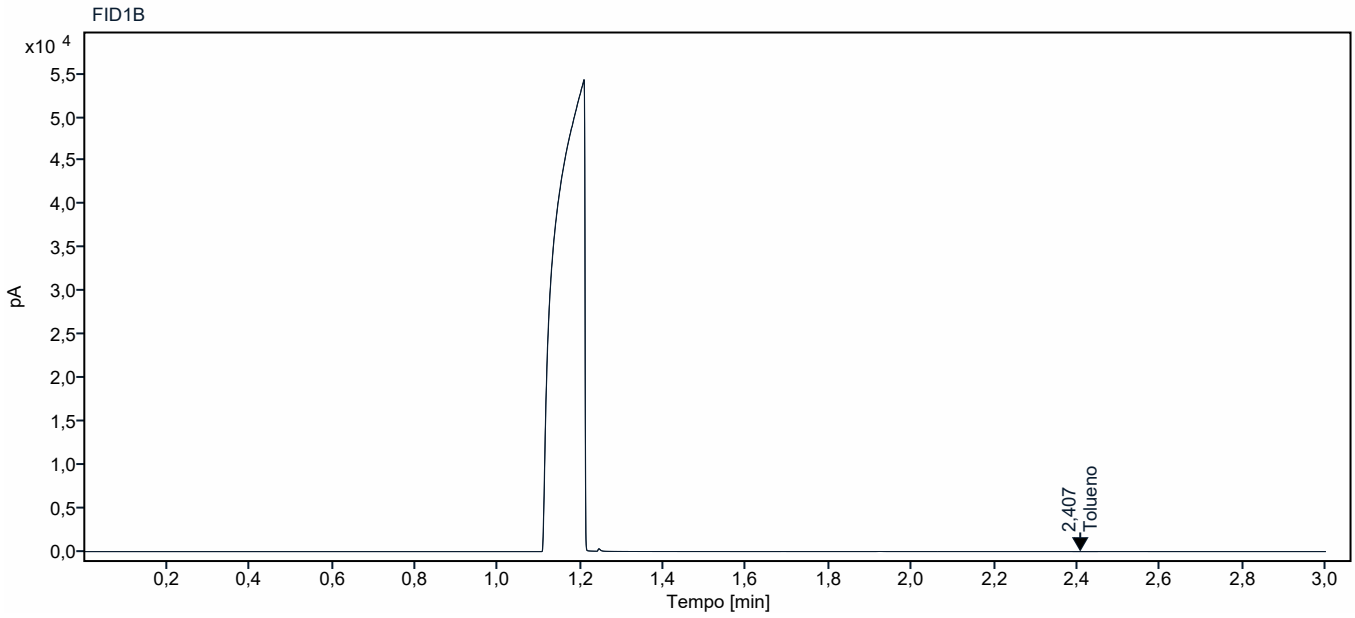

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,407	Tolueno	0,0609	2,7362	1,877	100,0000
		Soma	**2,7362**		