



Online Signals
Separate
Agilent 8890
Front Signal
Back Signal
Signal Selection
Back Signal
Free zoom
DESVIO LINHA BASE 20MIN DE 2,735pA A
2,725pA
TOTALIZANDO 0,010pA
pA
2,79
2,78
2,77
2,76
2,75
2,74
2,73
2,72
2,71
2,70
2,69
2,68
2,67
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326


Online Signals
Separate
Agilent 8890
Front Signal
Back Signal
Back Signal
Free zoom
DESVIO LINHA BASE 20MIN DE 2,735pA A
2,725pA
TOTALIZANDO 0,010pA
pA
Signal Selection

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-21-41-03-00-10.dx		
Nome da amostra:	LDFI_1 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:23:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

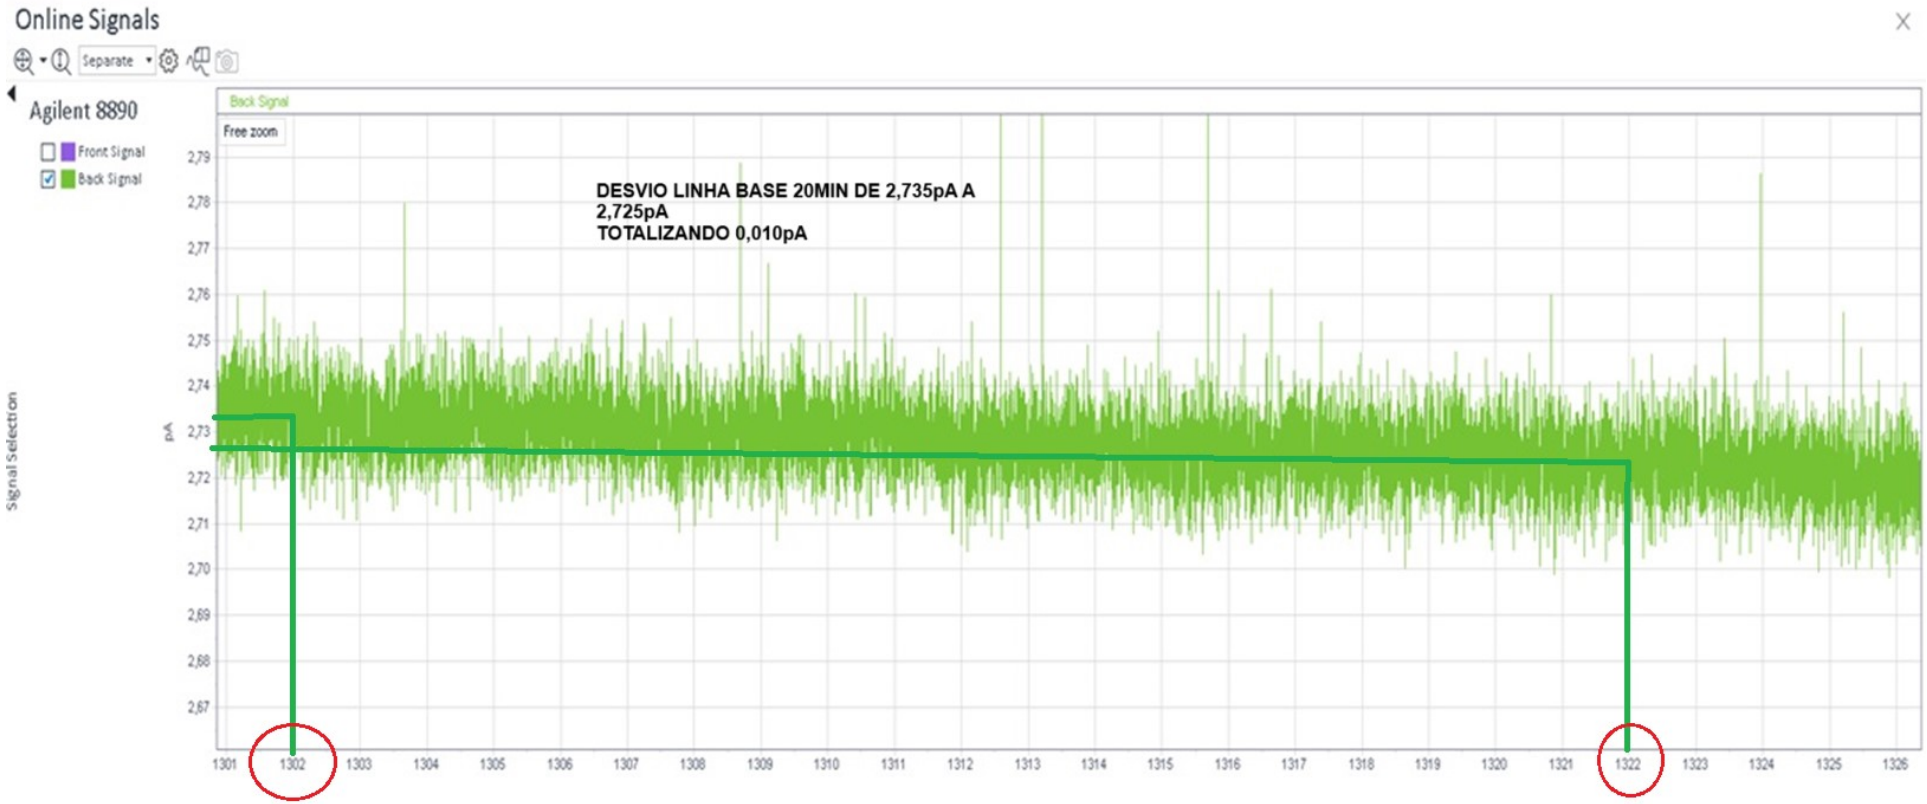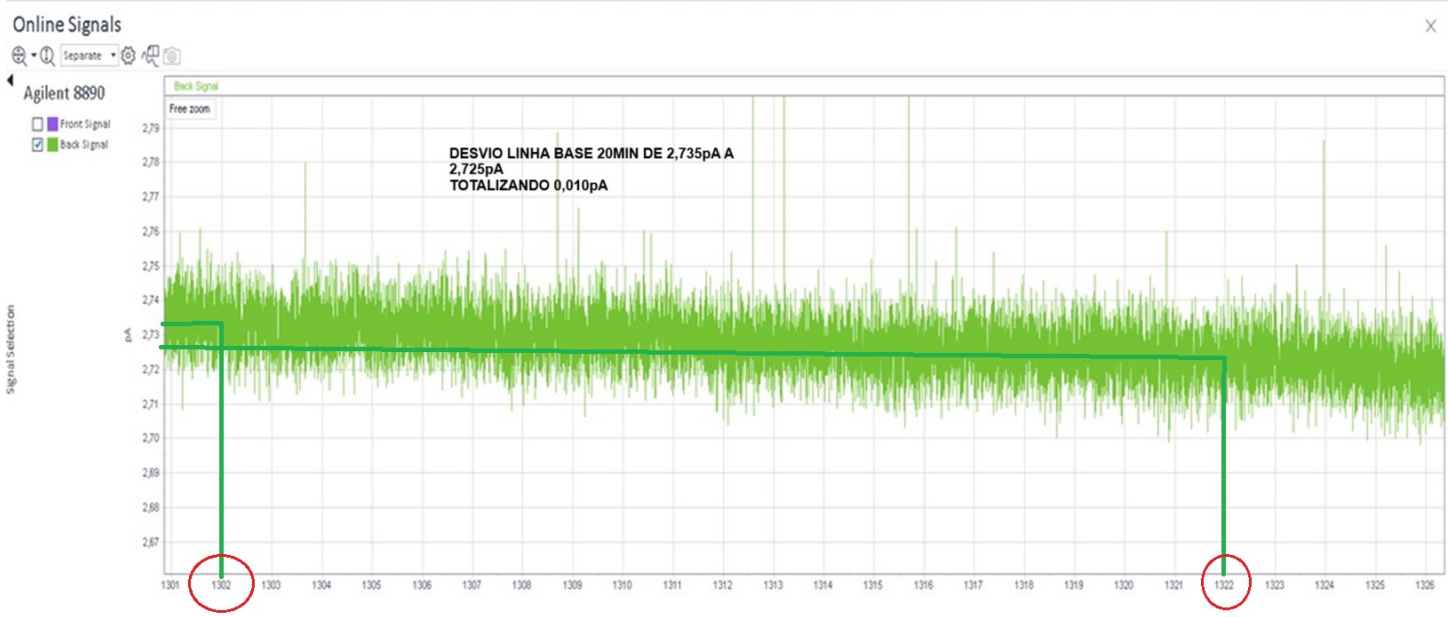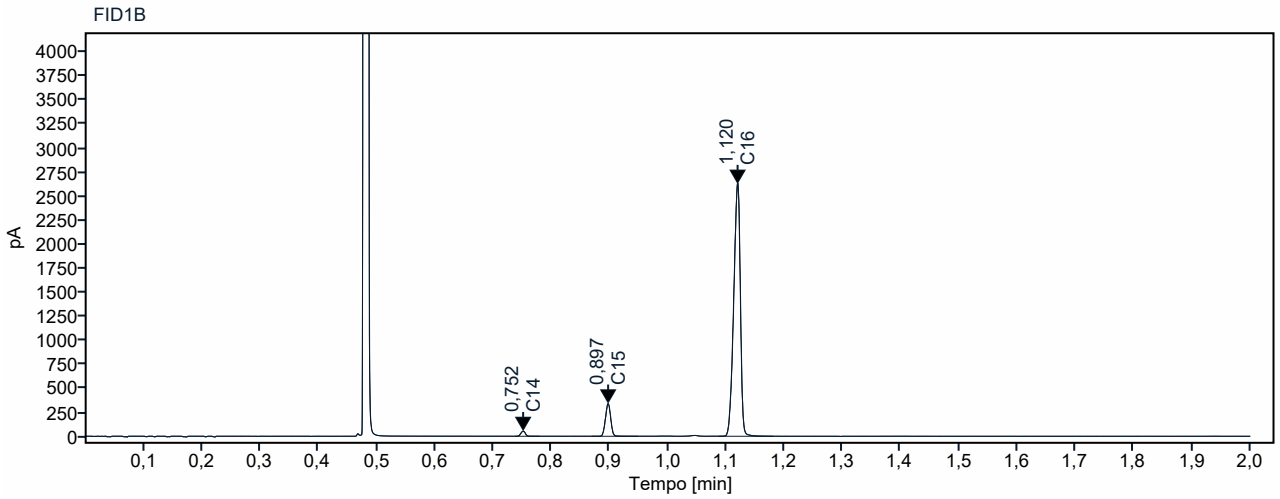


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,752	BB	0,0420	28,6819	52,6374	1,2297	C14
0,897	BB	0,0805	213,5918	338,3176	9,1573	C15
1,120	VV	0,0944	2090,2090	2623,0268	89,6131	C16
		Soma	**2332,4827**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-25-08-03-00-11.dx		
Nome da amostra:	LDFI_2 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:26:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

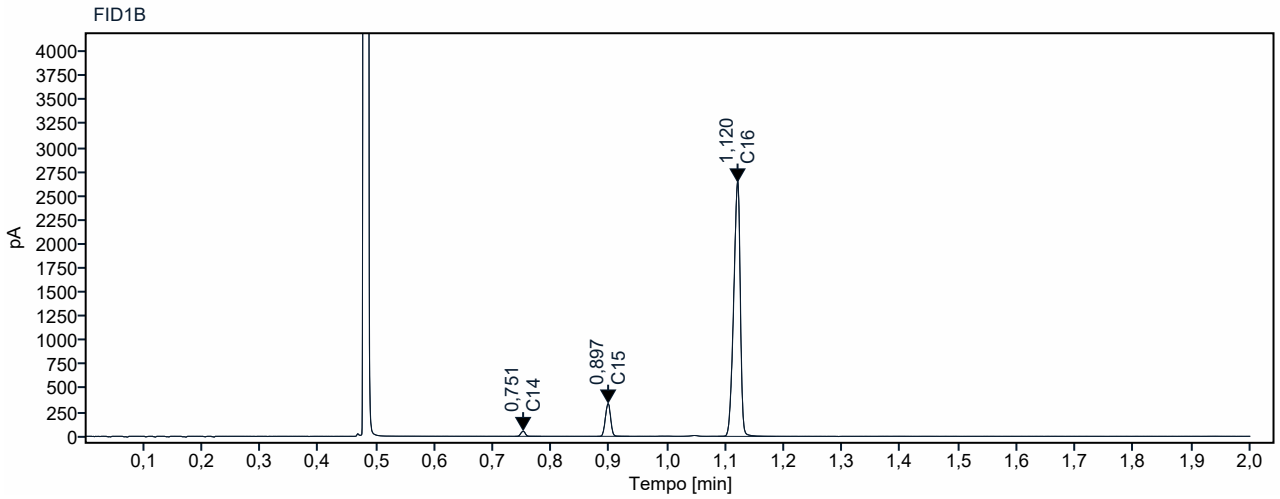


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,751	VB	0,0445	28,1845	51,5054	1,2055	C14
0,897	VB	0,0552	214,9192	337,1061	9,1926	C15
1,120	VV	0,0985	2094,8439	2637,5695	89,6018	C16
		Soma	**2337,9475**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-28-35-03-00-12.dx		
Nome da amostra:	LDFI_3 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:29:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

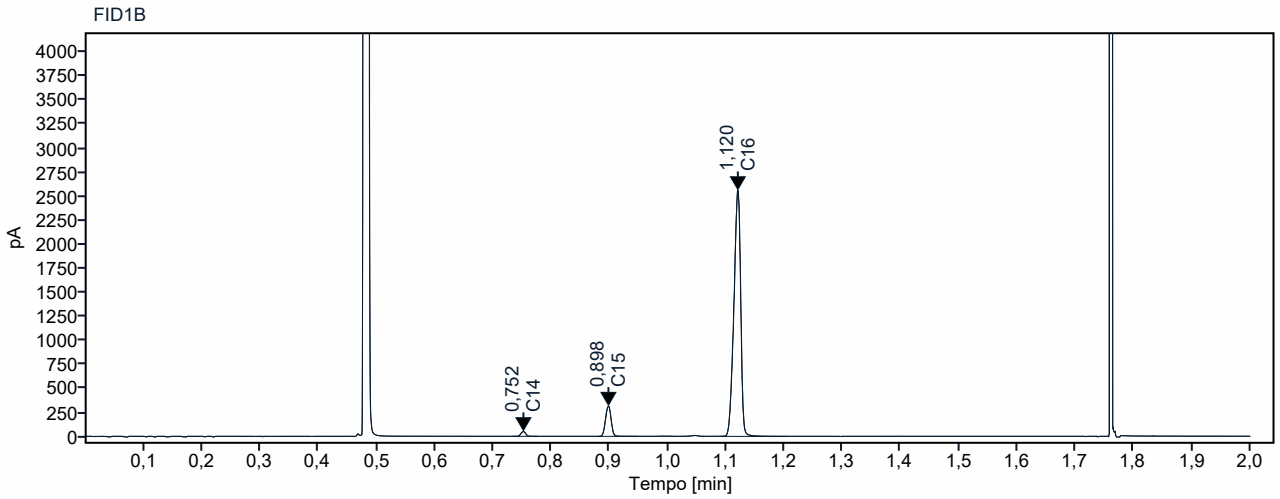


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,752	BB	0,0439	28,2797	49,2133	1,2164	C14
0,898	VV	0,0690	210,3452	312,3367	9,0476	C15
1,120	BV	0,1177	2086,2563	2555,7249	89,7360	C16
		Soma	**2324,8812**			


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 11-50-26-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_01 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-16 11:52:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

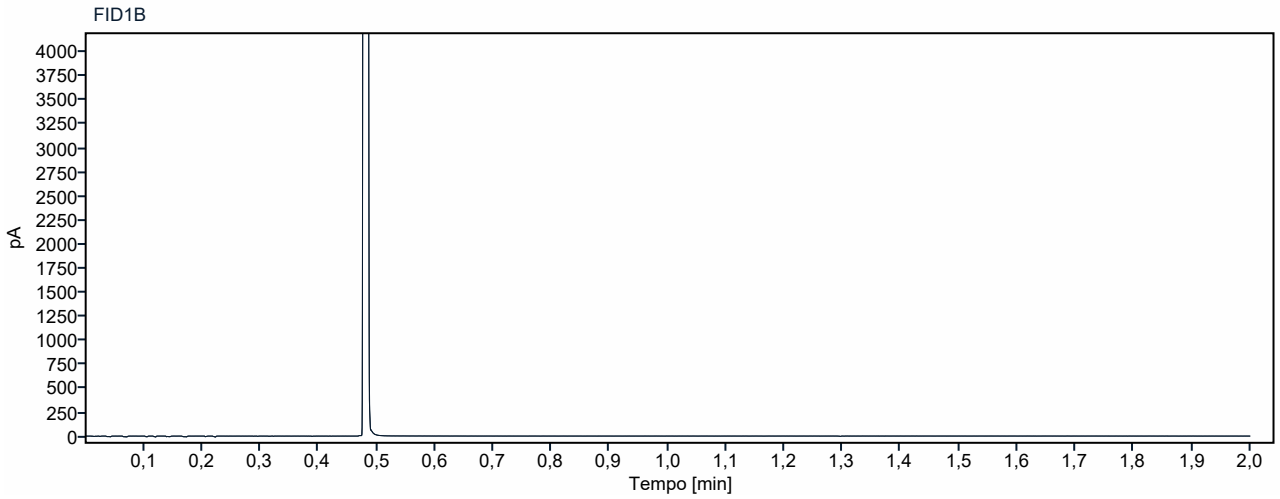


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-04-31-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_02 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-16 12:05:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

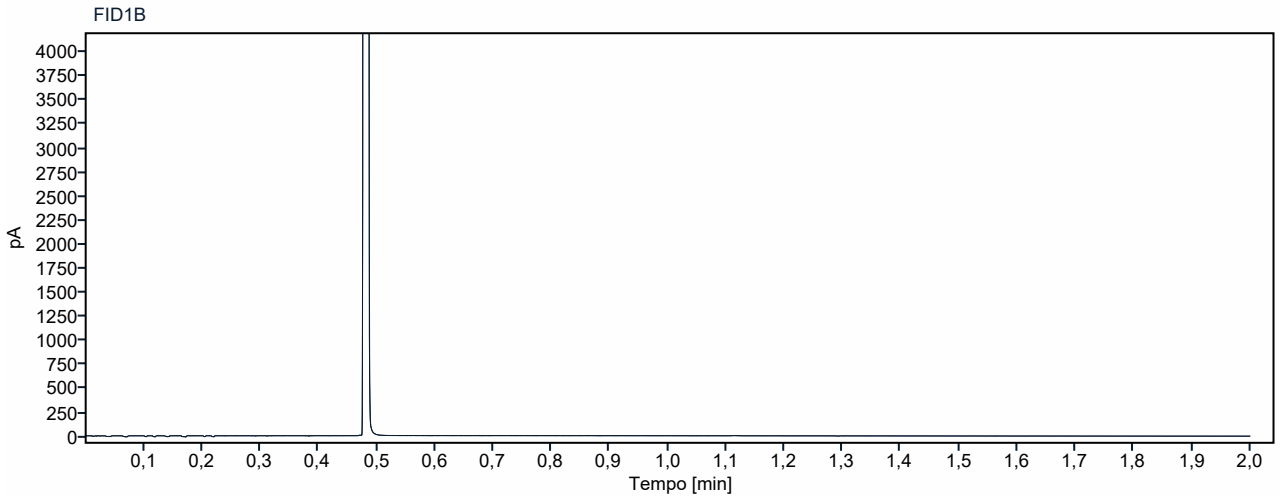

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-18-16-03-00-09.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_03 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-16 12:19:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

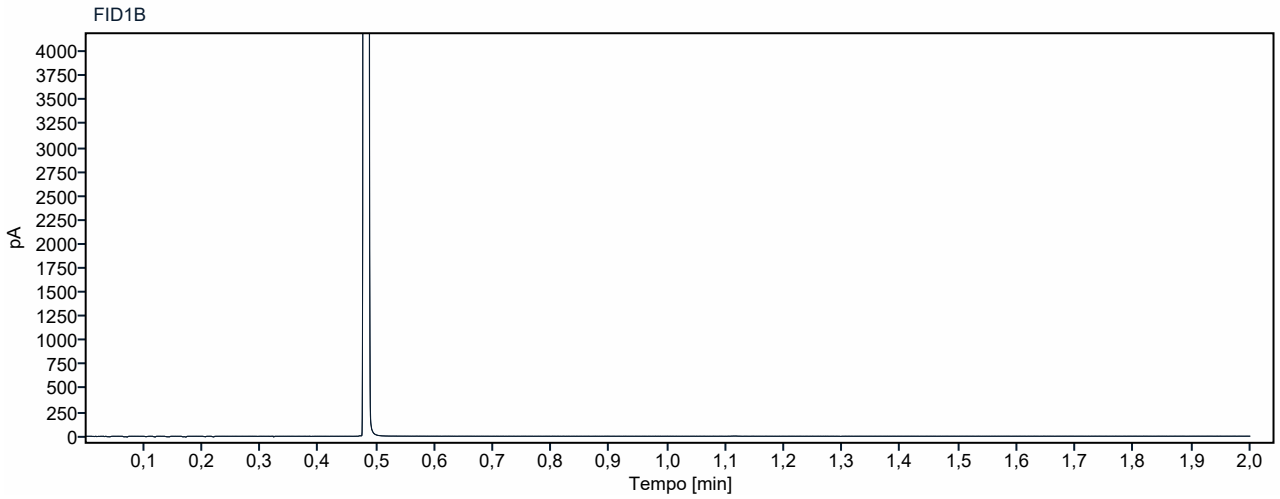

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 11-54-14-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_1 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 11:55:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

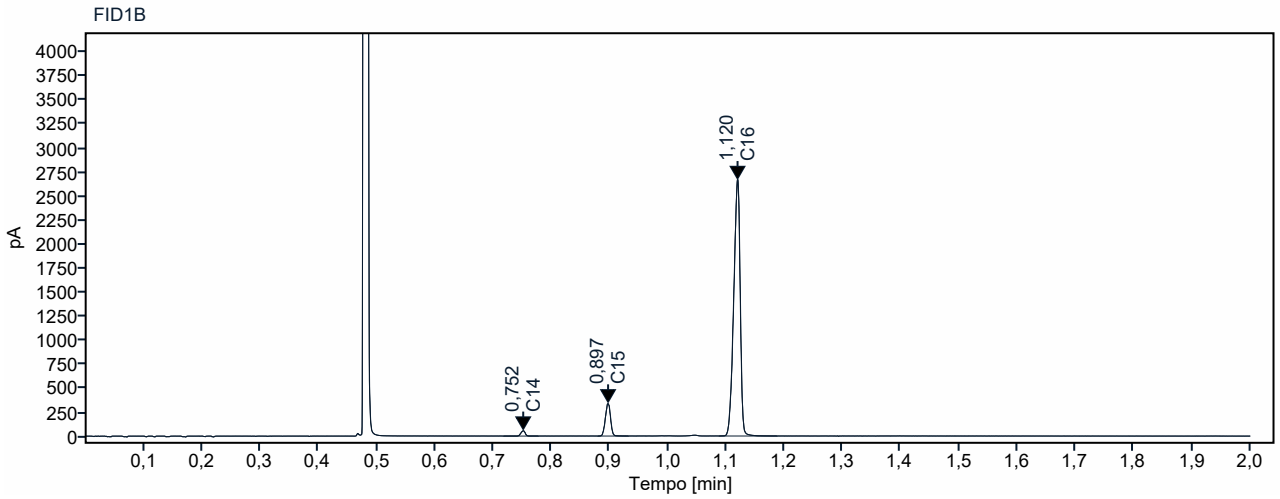


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,752	BV	0,0602	29,2434	54,8377	1,2661	C14
0,897	VV	0,0529	209,6845	337,6655	9,0786	C15
1,120	VV	0,1000	2070,7327	2660,1560	89,6553	C16
		Soma	**2309,6605**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 11-57-39-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_2 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 11:59:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

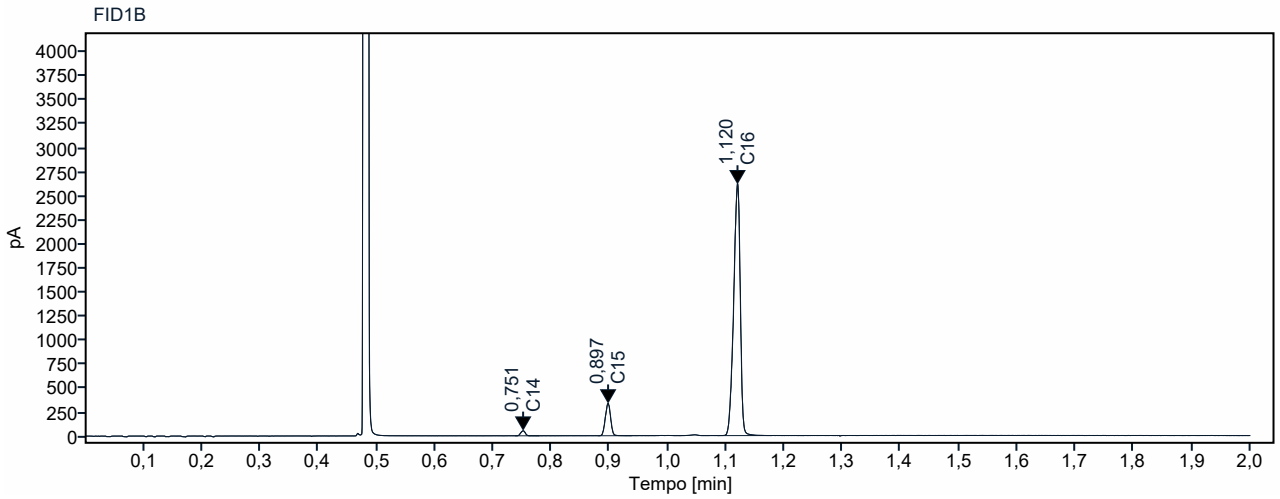


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,751	VB	0,0411	28,6974	51,6635	1,2387	C14
0,897	BV	0,0570	213,7142	333,5286	9,2251	C15
1,120	VB	0,0916	2074,2538	2612,0570	89,5362	C16
		Soma	**2316,6653**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-01-04-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_3 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:02:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

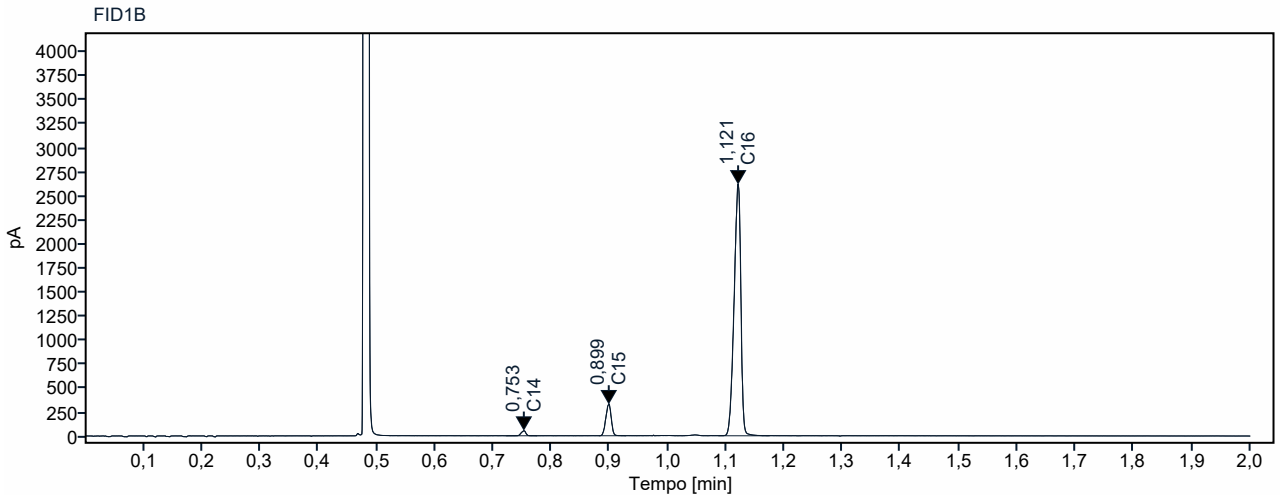


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,753	VB	0,0526	29,7436	52,0446	1,2583	C14
0,899	VV	0,0464	213,6782	325,6748	9,0395	C15
1,121	VV	0,0872	2120,4137	2613,0837	89,7023	C16
		Soma	**2363,8355**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-07-56-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_4 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:09:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

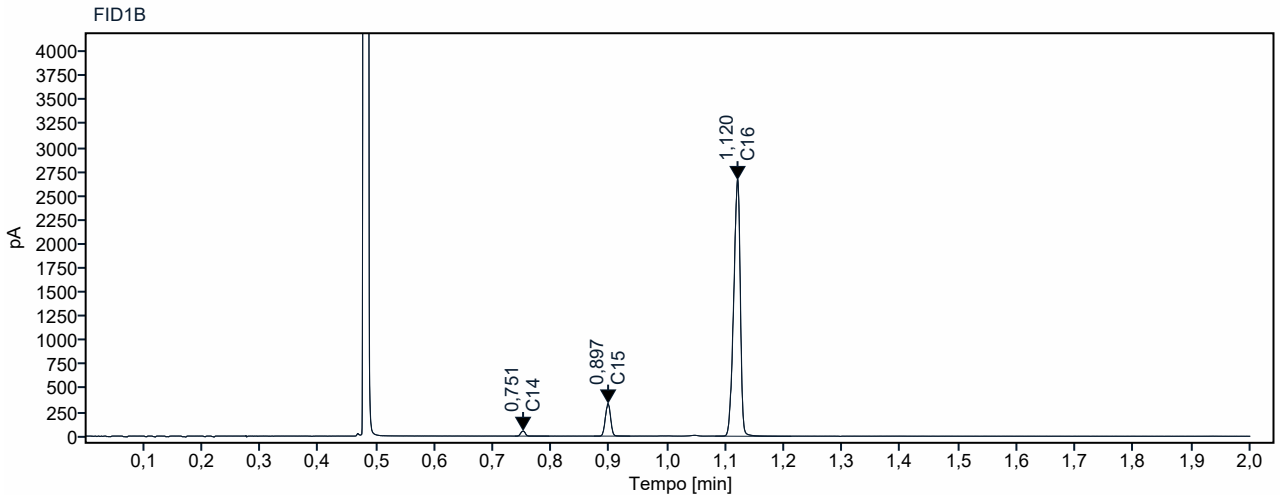


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,751	BB	0,0590	29,3155	50,9380	1,2410	C14
0,897	BB	0,0623	213,5473	335,5536	9,0401	C15
1,120	VV	0,1303	2119,3696	2661,0495	89,7189	C16
		Soma	**2362,2324**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-11-23-03-00-07.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_5 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:12:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

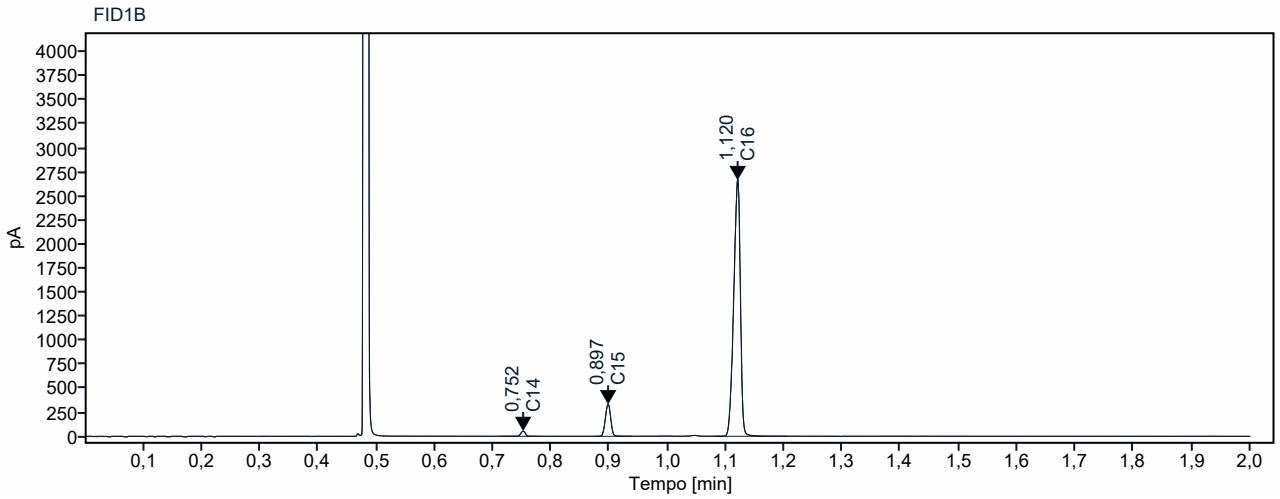


Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,752	BV	0,0645	29,1010	52,8436	1,2257	C14
0,897	BB	0,0623	213,7781	330,6776	9,0040	C15
1,120	VV	0,1238	2131,3704	2662,0245	89,7703	C16
		Soma	**2374,2495**			


Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024-BACK\CG-03 QUAL BACK.rslt\2024-10-16 12-14-51-03-00-08.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_6 BACK		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-16 12:16:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT B.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 13:00:20-03:00		

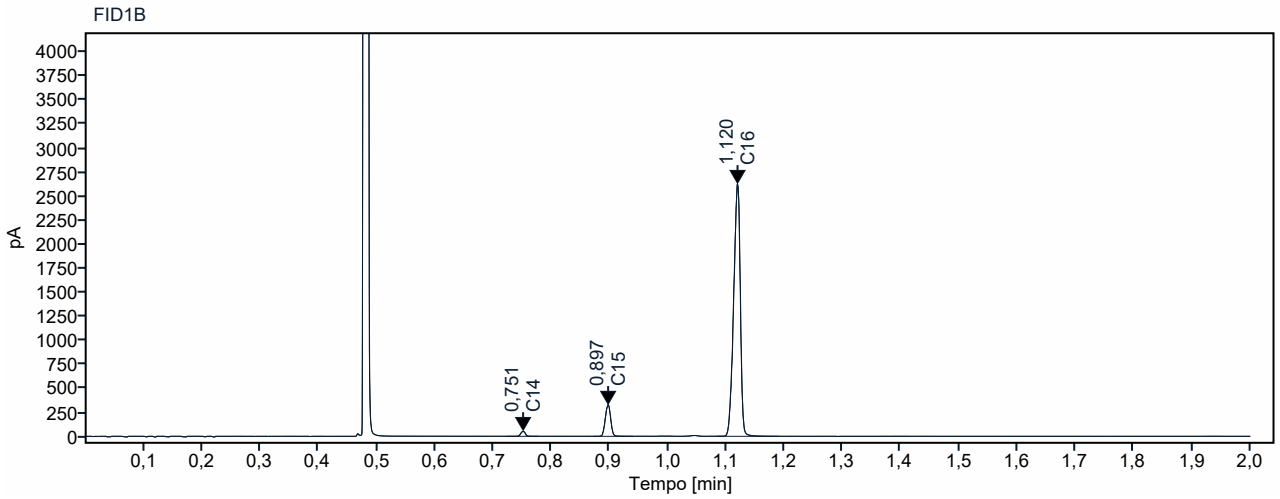

Sinal: FID1B

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,751	BV	0,0557	28,3663	50,8213	1,2159	C14
0,897	VB	0,0692	212,0196	322,6550	9,0878	C15
1,120	VV	0,1066	2092,6361	2620,5438	89,6964	C16
		Soma	**2333,0221**			

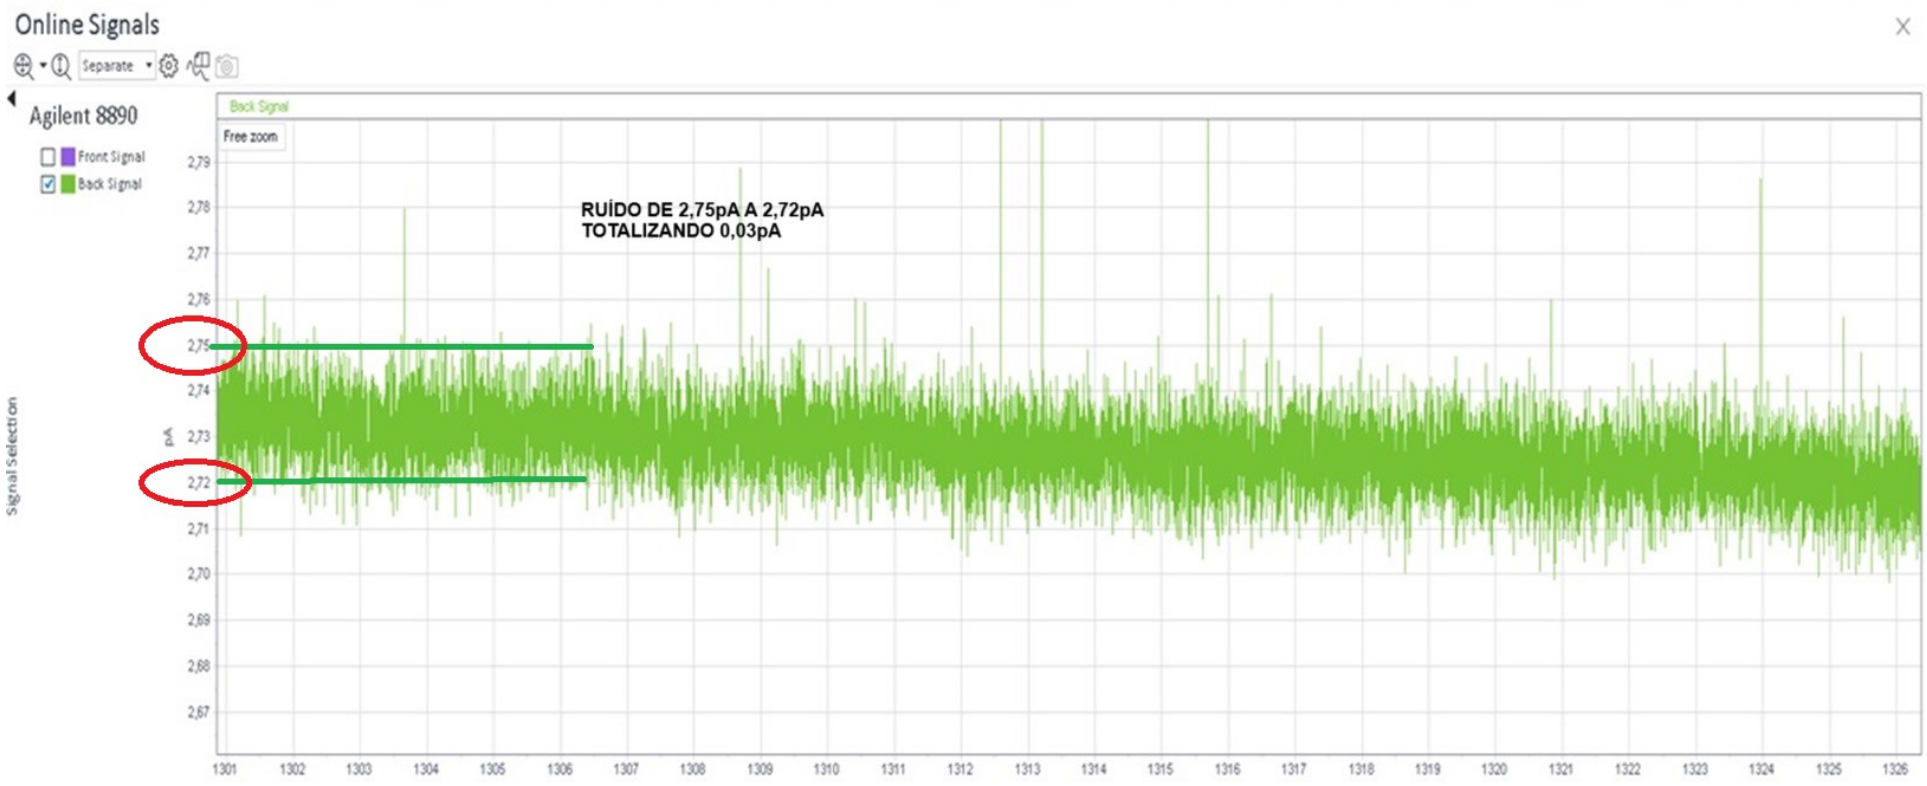
Online Signals
Separate
Agilent 8890
Front Signal
Back Signal
Signal Selection
Back Signal
Free zoom
RUÍDO DE 2,75pA A 2,72pA
TOTALIZANDO 0,03pA
pA
2,79
2,78
2,77
2,76
2,75
2,74
2,73
2,72
2,71
2,70
2,69
2,68
2,67
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326

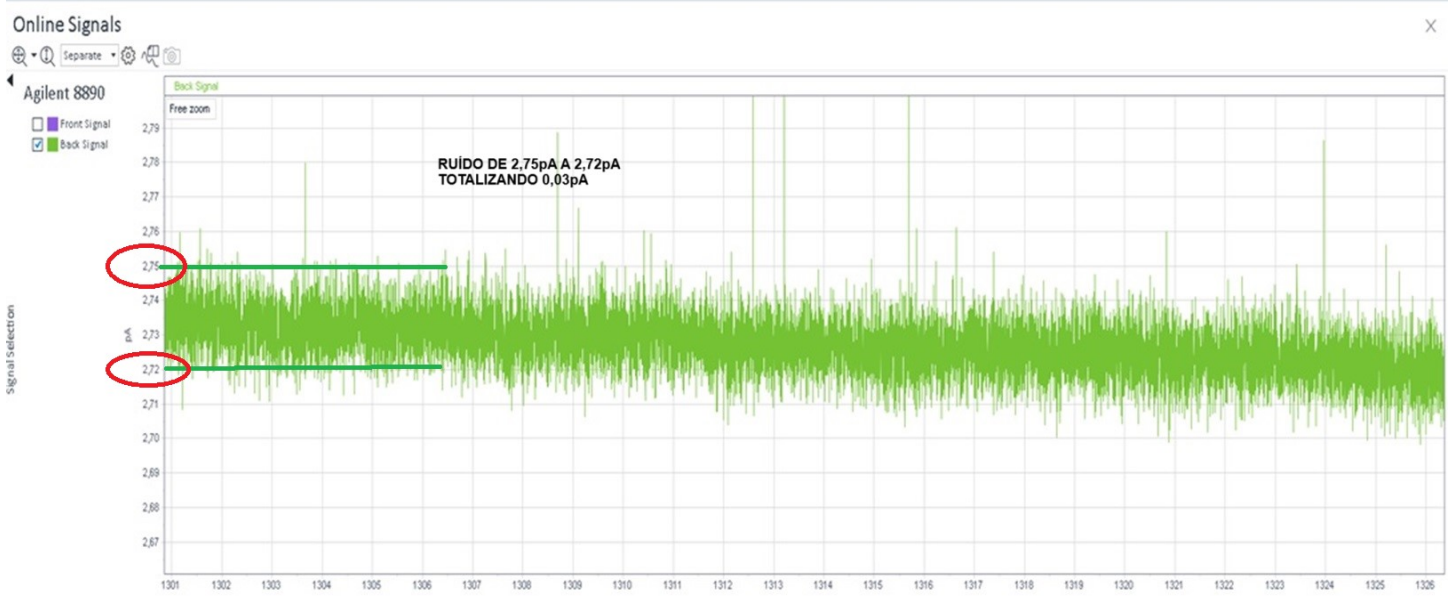
Online Signals
Separate
Agilent 8890
Front Signal
Back Signal
Back Signal
Free zoom
RUÍDO DE 2,75pA A 2,72pA
TOTALIZANDO 0,03pA
pA
Signal Selection
2,79
2,78
2,77
2,76
2,75
2,74
2,73
2,72
2,71
2,70
2,69
2,68
2,67
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326