
Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI.rslt\2026-10-05 19-20-17-03-00-01.dx
Nome da amostra: LDFI 1
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 19:21:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

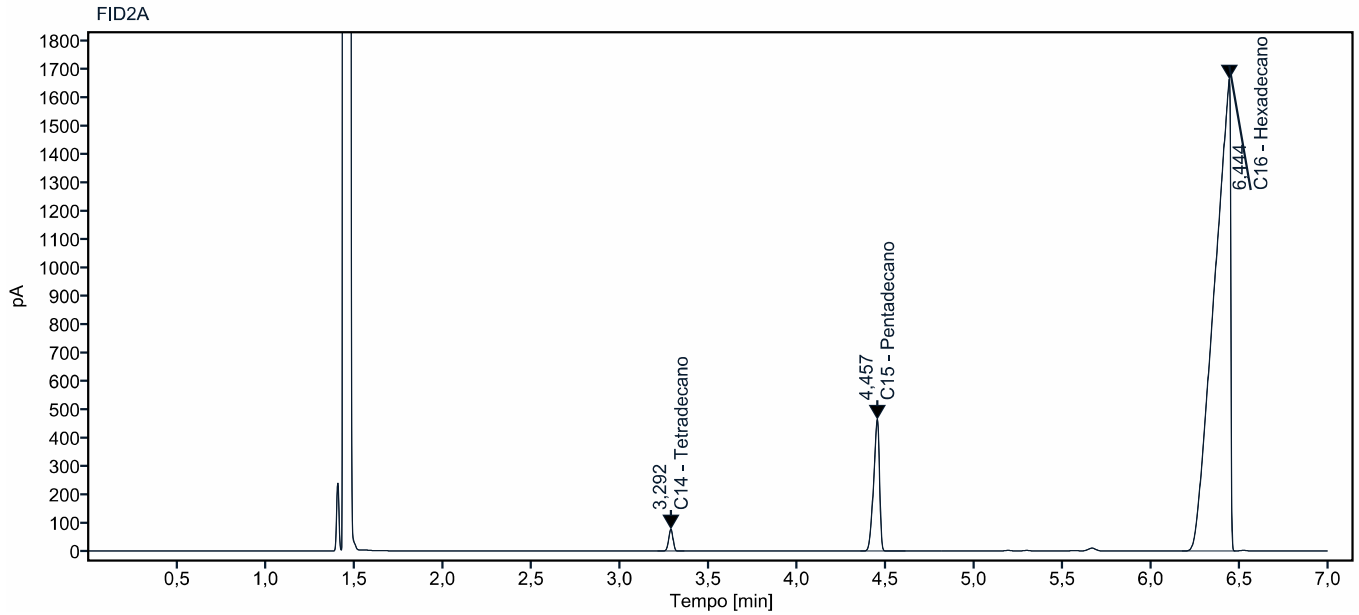

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,292	C14 - Tetradecano	0,1500	132,1552	77,068	1,1107
4,457	C15 - Pentadecano	0,2519	1080,3893	464,183	9,0799
6,444	C16 - Hexadecano	0,3017	10686,0956	1663,862	89,8094
		Soma	**11898,6402**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI__BACK_.rslt\2026-10-06 12-07-00-03-00-01.dx
Nome da amostra: LDFI 1
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 12:08:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 15:06:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

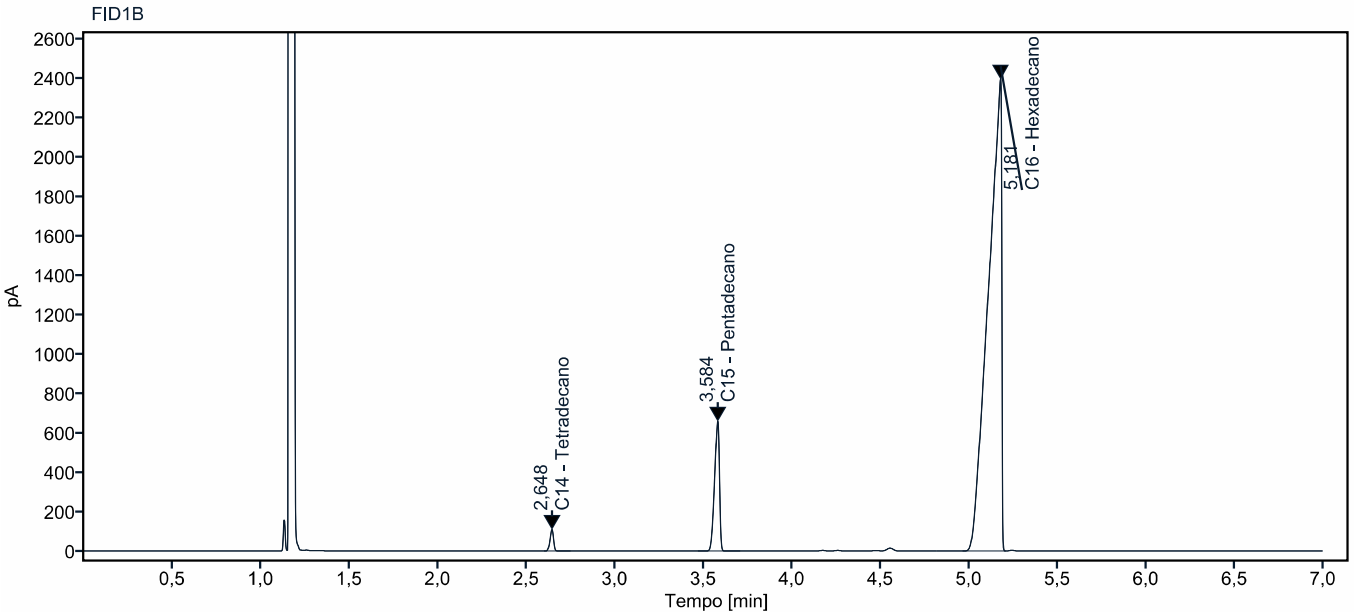

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,648	C14 - Tetradecano	0,1477	153,5675	108,874	1,1022
3,584	C15 - Pentadecano	0,2368	1261,9686	658,305	9,0579
5,181	C16 - Hexadecano	0,2439	12516,6896	2393,641	89,8398
		Soma	**13932,2257**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI.rslt\2026-10-05 19-28-39-03-00-02.dx
Nome da amostra: LDFI 2
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 19:30:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

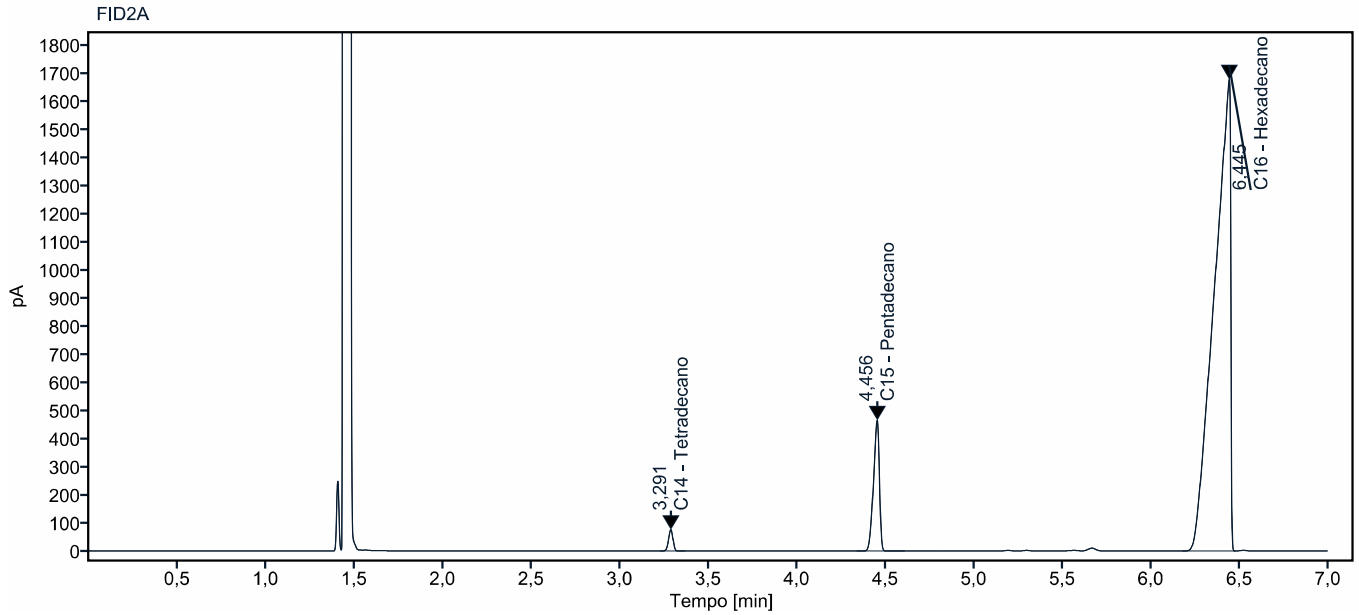

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1403	132,7477	76,010	1,1104
4,456	C15 - Pentadecano	0,2710	1084,8283	465,018	9,0739
6,445	C16 - Hexadecano	0,3011	10737,8805	1678,224	89,8157
		Soma	**11955,4565**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI__BACK_.rslt\2026-10-06 12-15-42-03-00-02.dx
Nome da amostra:	LDFI 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 12:17:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 15:06:16-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

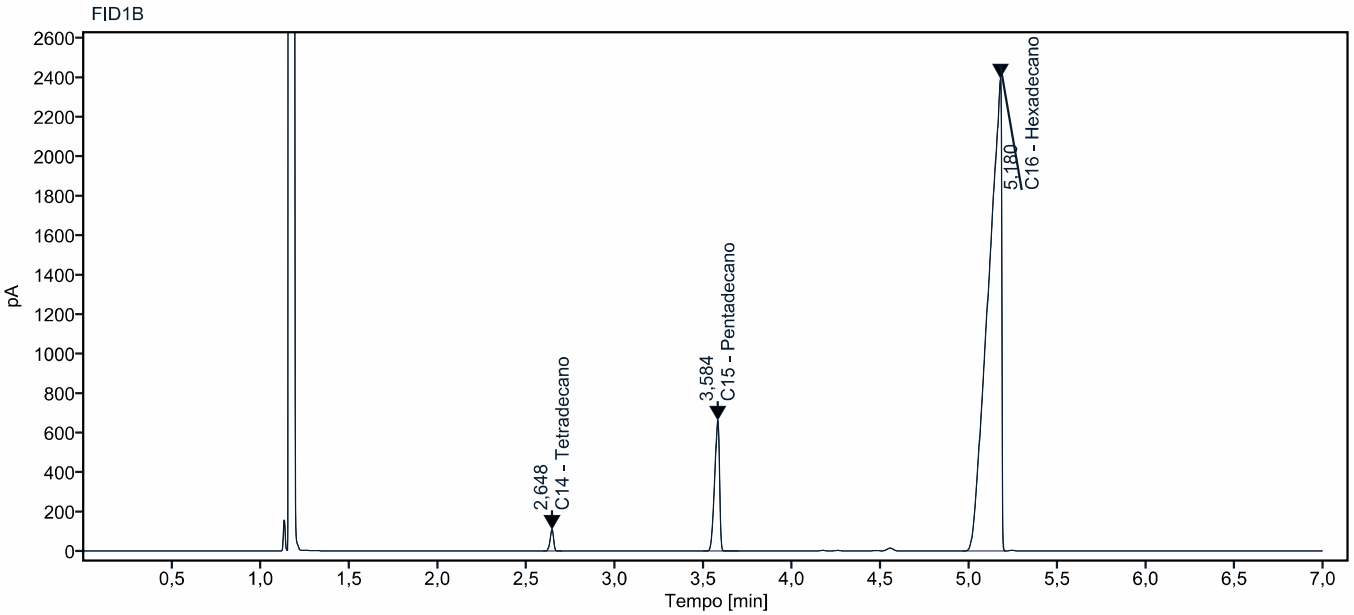

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,648	C14 - Tetradecano	0,1038	154,2069	109,270	1,1020
3,584	C15 - Pentadecano	0,2025	1267,2763	661,598	9,0560
5,180	C16 - Hexadecano	0,2446	12572,3321	2394,337	89,8421
		Soma	**13993,8153**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI.rslt\2026-10-05 19-37-05-03-00-03.dx
Nome da amostra: LDFI 3
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 19:38:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

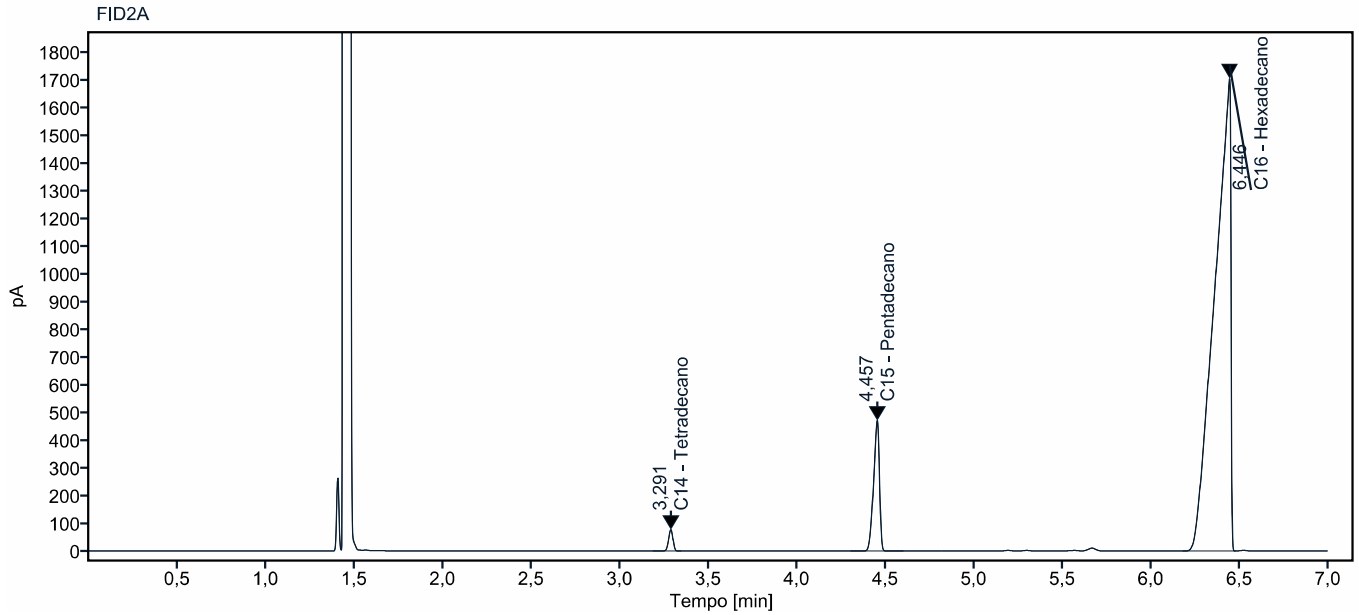

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1582	133,6189	77,175	1,1101
4,457	C15 - Pentadecano	0,2985	1092,8133	470,816	9,0788
6,446	C16 - Hexadecano	0,3011	10810,5593	1705,427	89,8111
		Soma	**12036,9915**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\LDFI__BACK_.rslt\2026-10-06 12-24-26-03-00-03.dx
Nome da amostra: LDFI 3
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 12:26:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 15:06:16-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

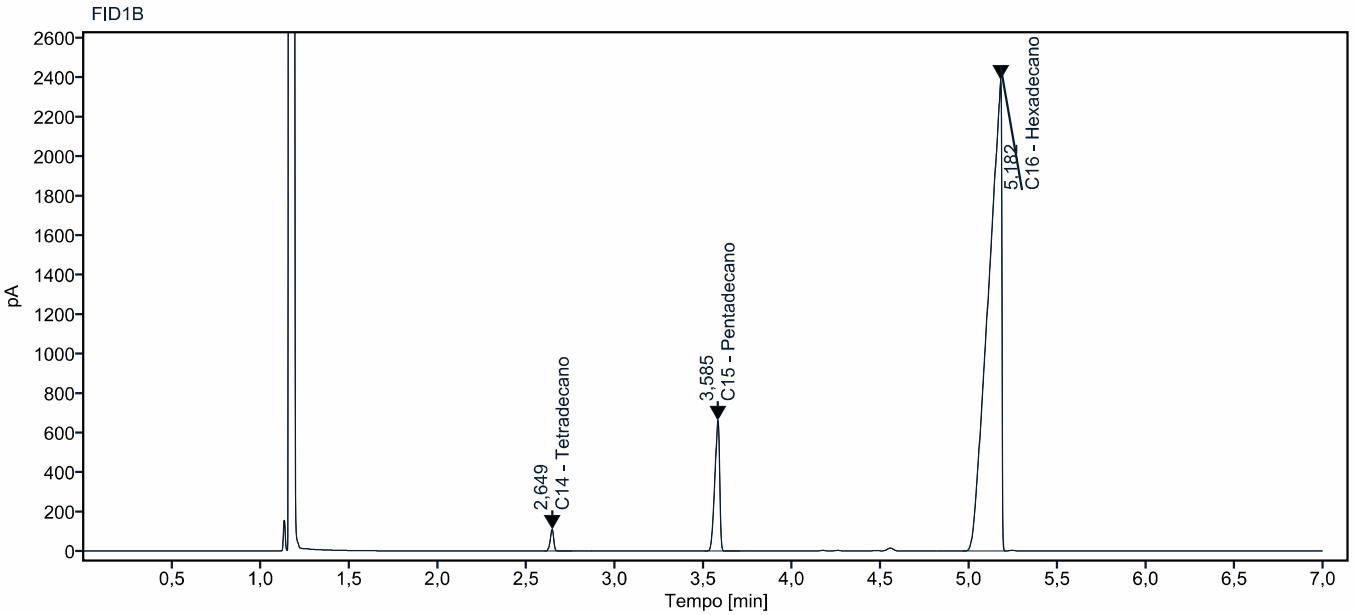

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,649	C14 - Tetradecano	0,1529	153,0451	109,650	1,1019
3,585	C15 - Pentadecano	0,1958	1257,7039	661,872	9,0556
5,182	C16 - Hexadecano	0,2446	12477,9233	2387,653	89,8424
		Soma	**13888,6723**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-12-53-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN 1
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 18:14:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

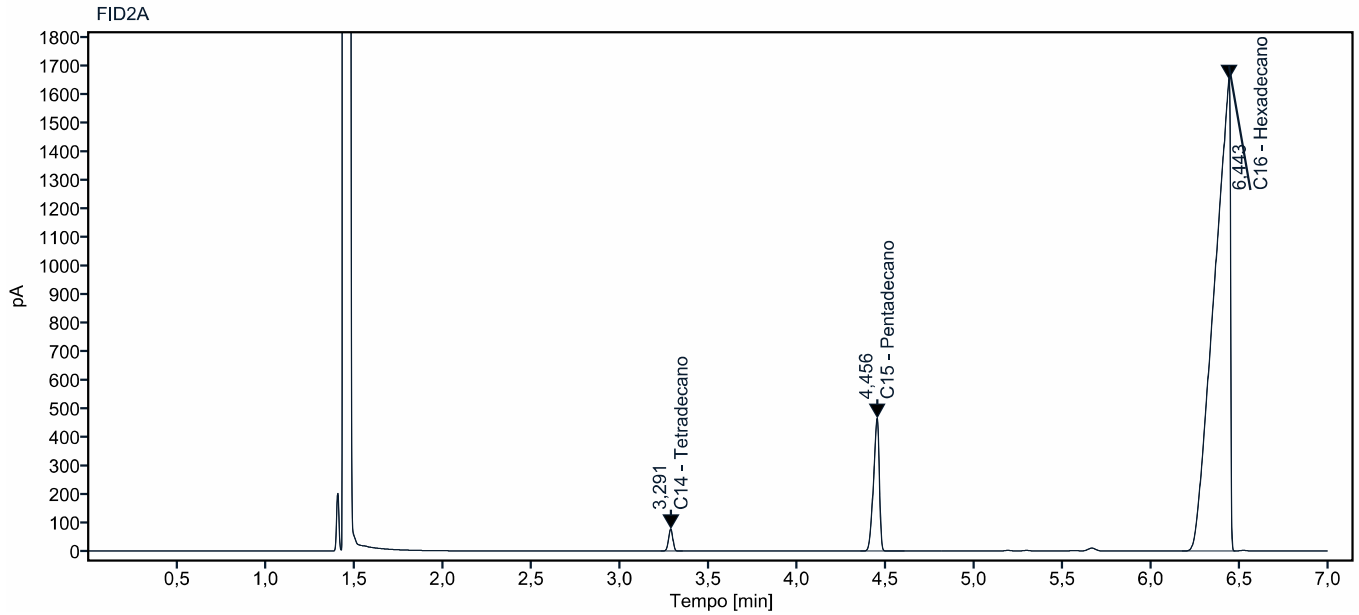

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1233	130,7828	77,234	1,1116
4,456	C15 - Pentadecano	0,2490	1068,8877	464,858	9,0849
6,443	C16 - Hexadecano	0,3022	10565,8742	1651,664	89,8035
		Soma	**11765,5448**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 10-56-51-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN 1
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 10:58:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

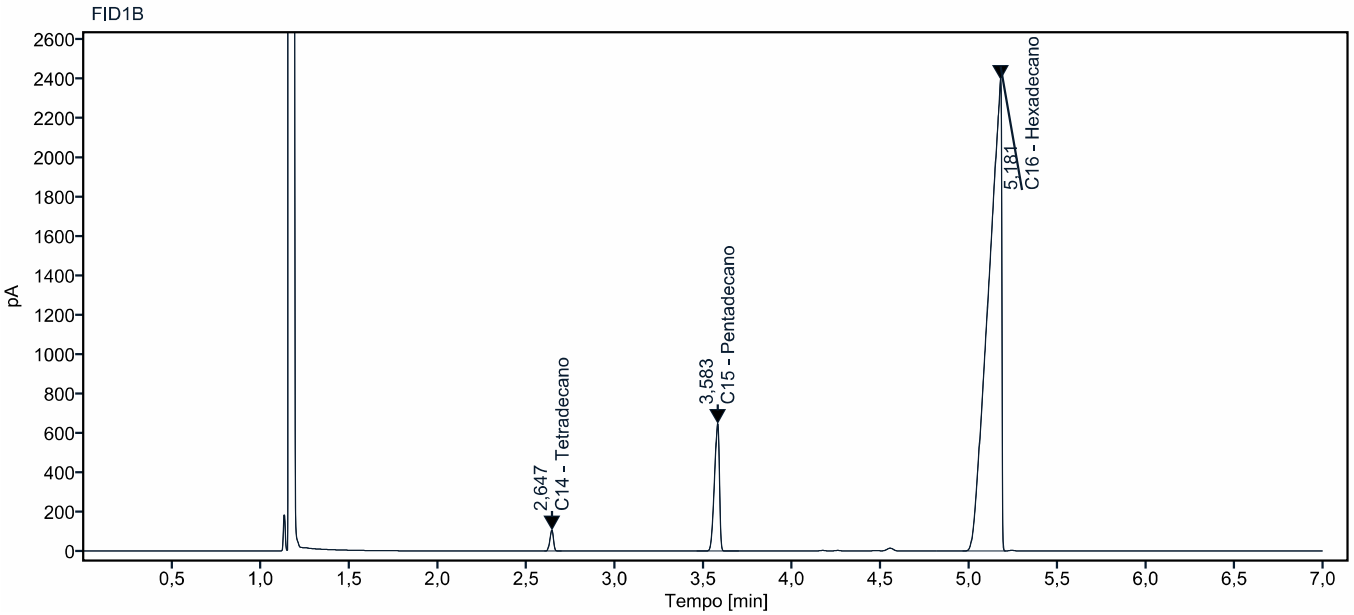

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,647	C14 - Tetradecano	0,0969	153,2989	106,360	1,1028
3,583	C15 - Pentadecano	0,2383	1259,2033	647,445	9,0585
5,181	C16 - Hexadecano	0,2440	12488,3314	2393,535	89,8387
		Soma	**13900,8336**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-21-18-03-00-03.dx
Nome da amostra: PCIN 2
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 18:22:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

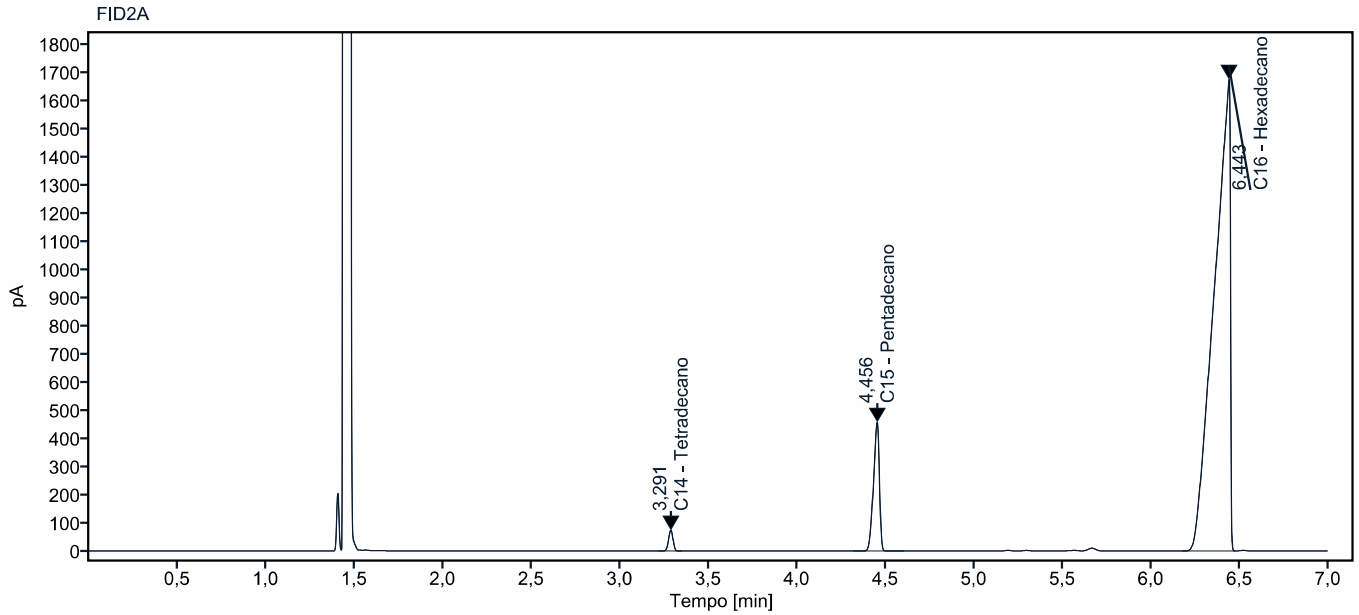

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1300	130,7454	74,260	1,1117
4,456	C15 - Pentadecano	0,2851	1068,6282	457,513	9,0866
6,443	C16 - Hexadecano	0,2990	10561,1326	1675,397	89,8017
		Soma	**11760,5062**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-05-39-03-00-03.dx
Nome da amostra: PCIN 2
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 11:07:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

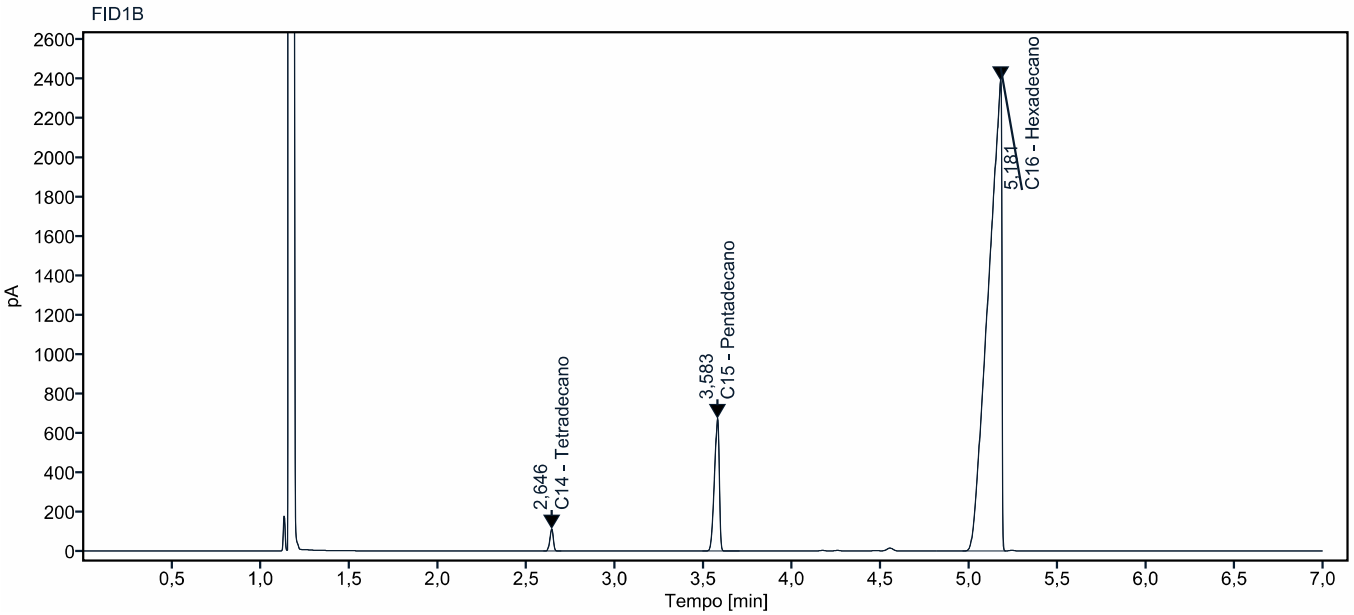

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,646	C14 - Tetradecano	0,0988	155,6694	111,847	1,1035
3,583	C15 - Pentadecano	0,2079	1278,2063	672,893	9,0612
5,181	C16 - Hexadecano	0,2447	12672,4295	2388,465	89,8352
		Soma	**14106,3052**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-29-43-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN 3
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 18:31:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

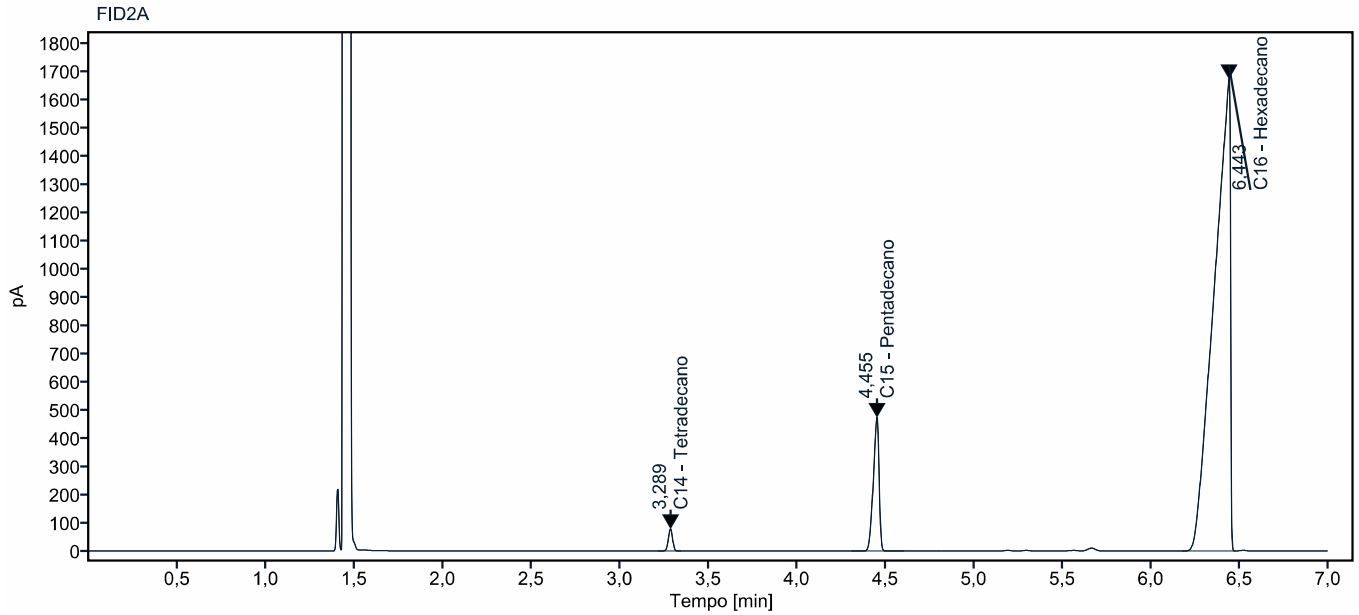

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,289	C14 - Tetradecano	0,1257	132,1642	78,808	1,1111
4,455	C15 - Pentadecano	0,2975	1080,6571	473,225	9,0848
6,443	C16 - Hexadecano	0,3017	10682,3424	1672,984	89,8041
		Soma	**11895,1637**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-14-22-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN 3
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 11:16:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

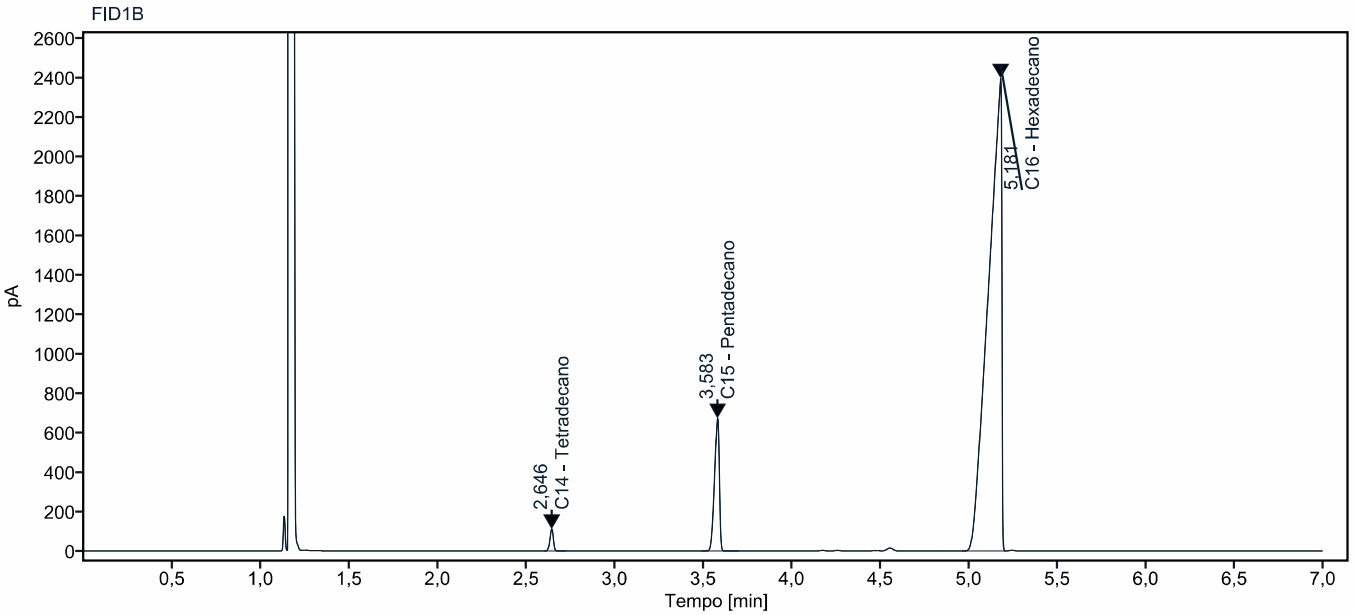

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,646	C14 - Tetradecano	0,1213	154,7663	112,386	1,1034
3,583	C15 - Pentadecano	0,2114	1271,0107	672,882	9,0617
5,181	C16 - Hexadecano	0,2468	12600,3909	2396,789	89,8349
		Soma	**14026,1678**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-46-30-03-00-06.dx
Nome da amostra: PCIN 4
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 18:47:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

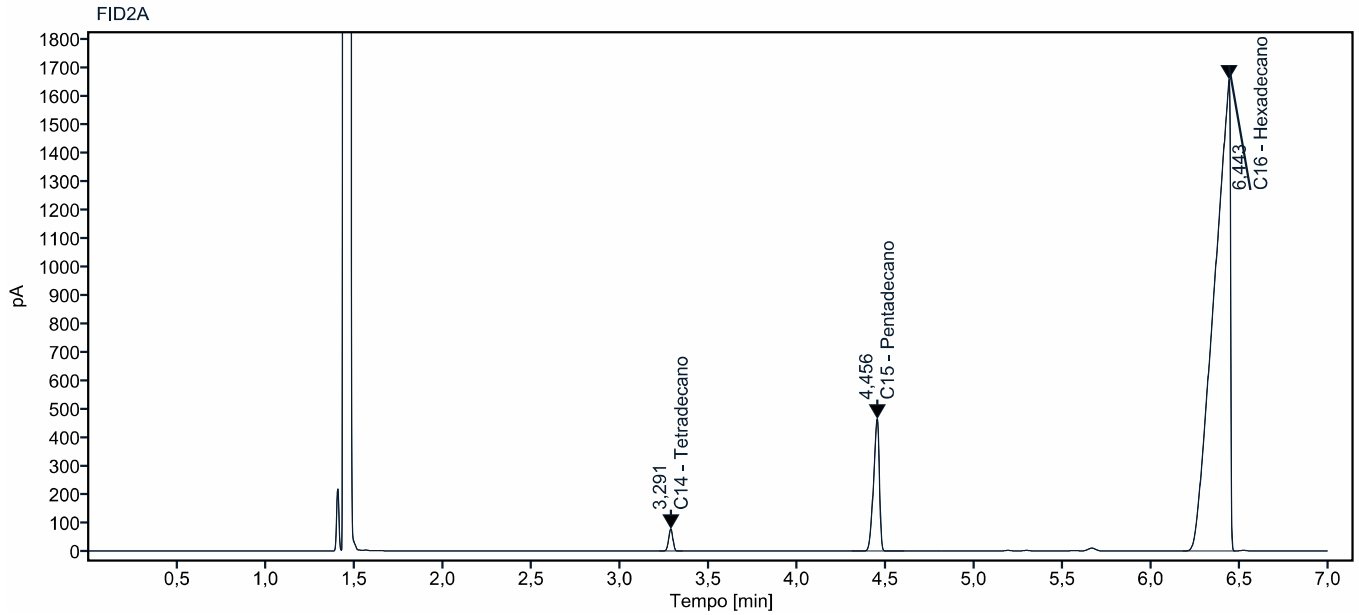

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1299	130,4176	77,671	1,1098
4,456	C15 - Pentadecano	0,2964	1066,7697	465,059	9,0779
6,443	C16 - Hexadecano	0,2987	10554,1007	1657,494	89,8123
		Soma	**11751,2879**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-31-50-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN 4
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 11:33:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

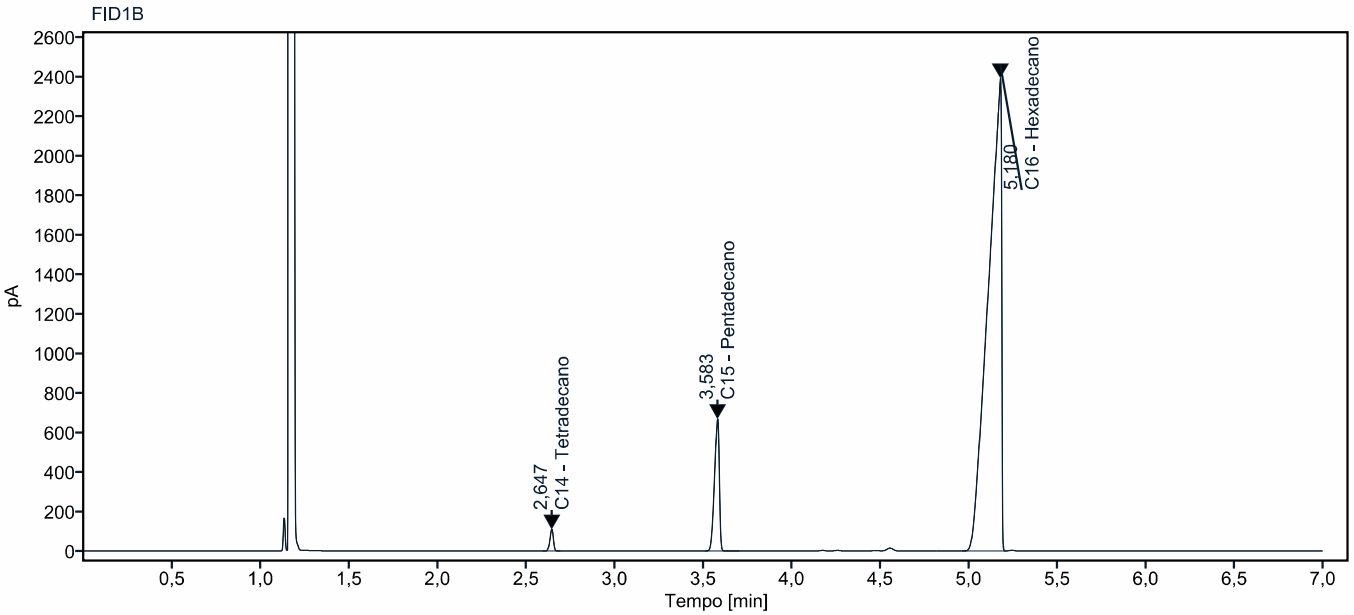

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,647	C14 - Tetradecano	0,0976	153,7680	110,868	1,1040
3,583	C15 - Pentadecano	0,1927	1261,9664	668,905	9,0604
5,180	C16 - Hexadecano	0,2448	12512,6203	2393,488	89,8356
		Soma	**13928,3546**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-54-54-03-00-07.dx
Nome da amostra: PCIN 5
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 18:56:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

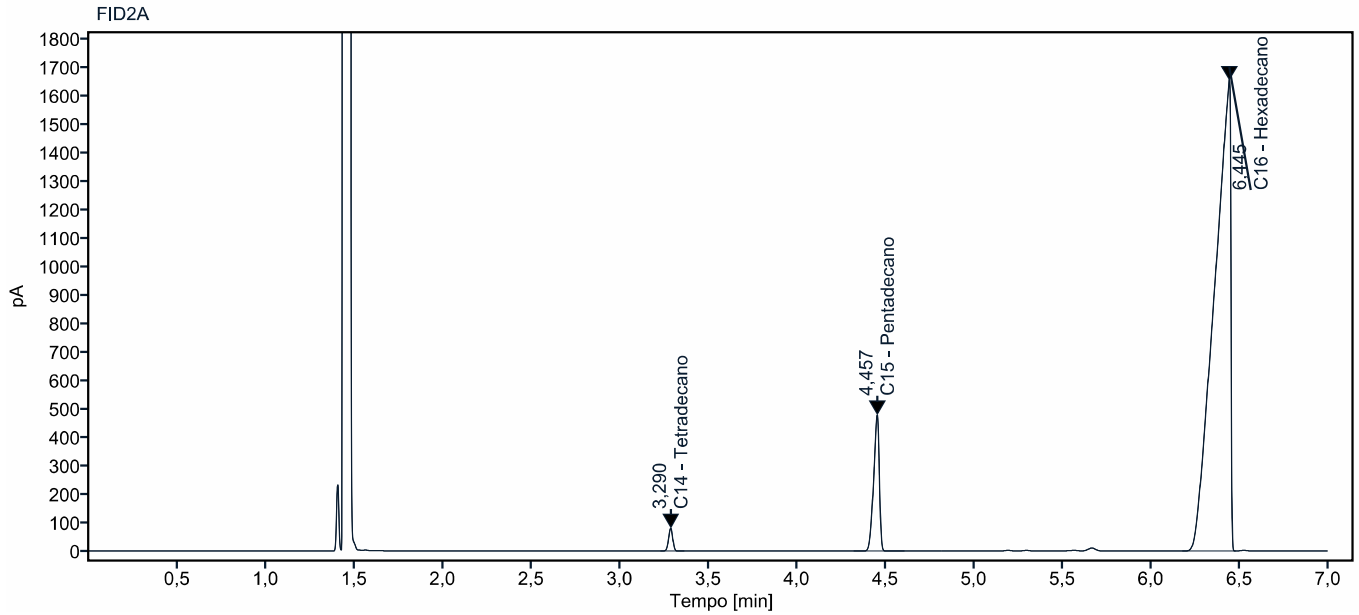

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,290	C14 - Tetradecano	0,1341	131,9901	80,451	1,1127
4,457	C15 - Pentadecano	0,2871	1078,4390	478,389	9,0914
6,445	C16 - Hexadecano	0,3030	10651,8049	1653,715	89,7959
		Soma	**11862,2340**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-40-38-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN 5
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 11:42:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

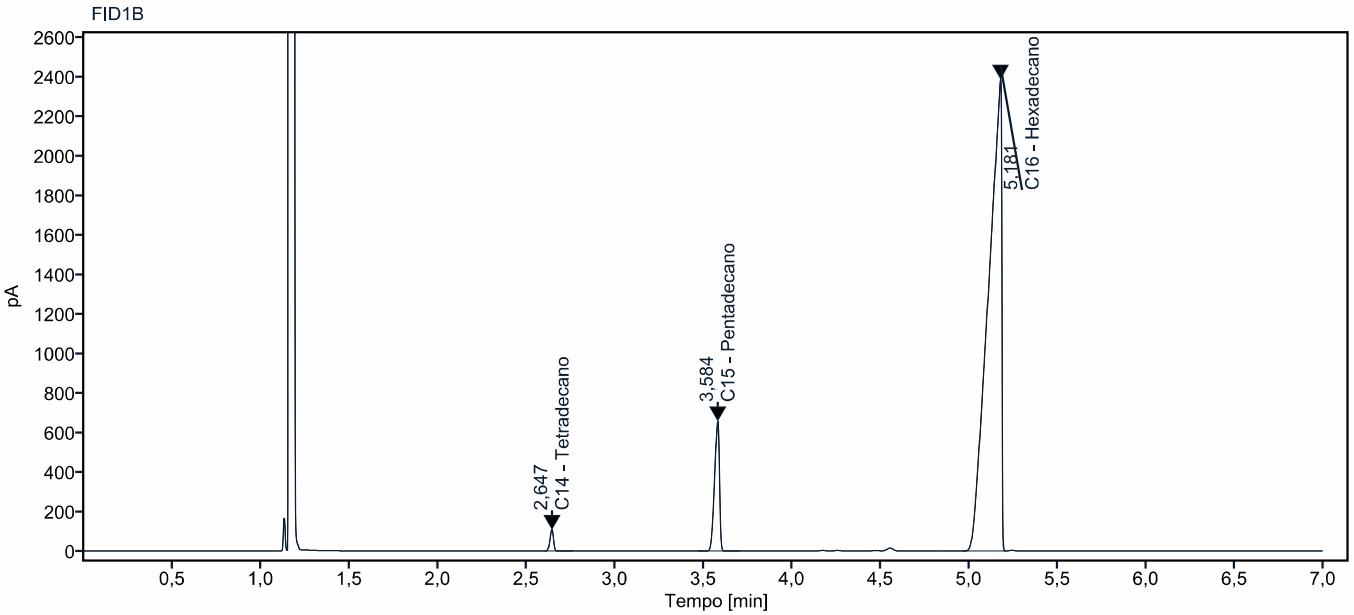

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,647	C14 - Tetradecano	0,1587	154,1310	109,412	1,1026
3,584	C15 - Pentadecano	0,2337	1266,2909	657,453	9,0583
5,181	C16 - Hexadecano	0,2445	12558,9498	2386,469	89,8392
		Soma	**13979,3717**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 19-03-18-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN 6
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-05 19:04:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

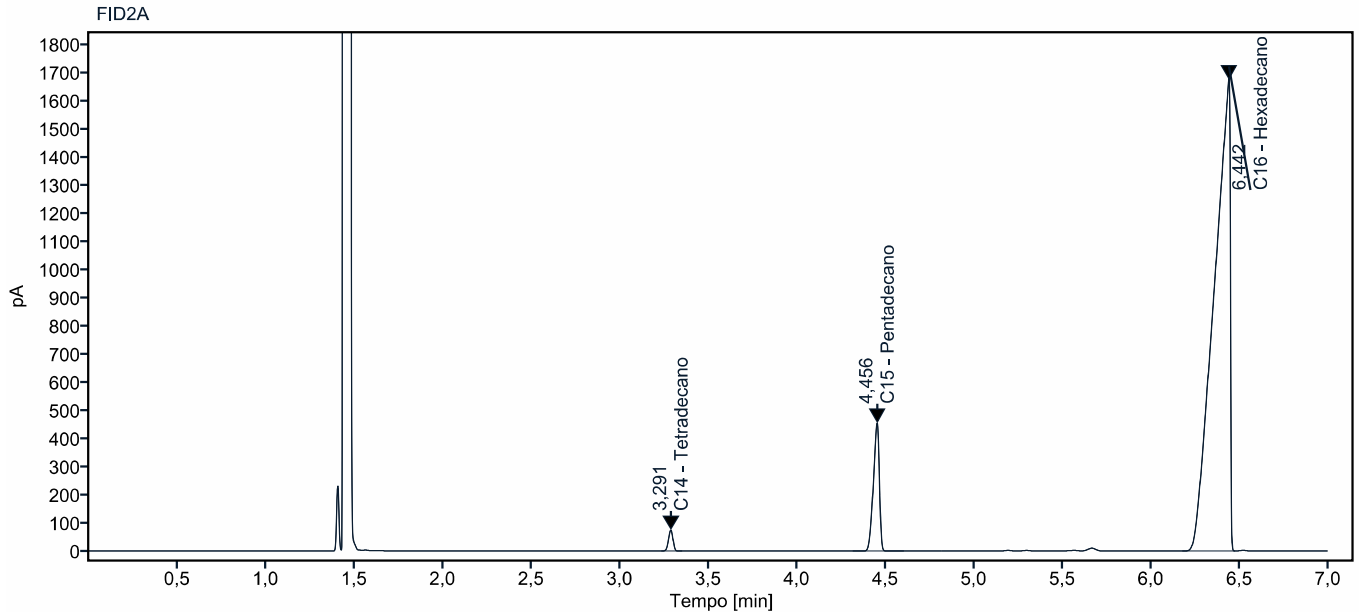

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,291	C14 - Tetradecano	0,1153	131,6805	74,553	1,1098
4,456	C15 - Pentadecano	0,2885	1077,1230	454,998	9,0777
6,442	C16 - Hexadecano	0,2995	10656,8422	1674,654	89,8126
		Soma	**11865,6457**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-49-19-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN 6
Descrição:

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-06 11:51:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

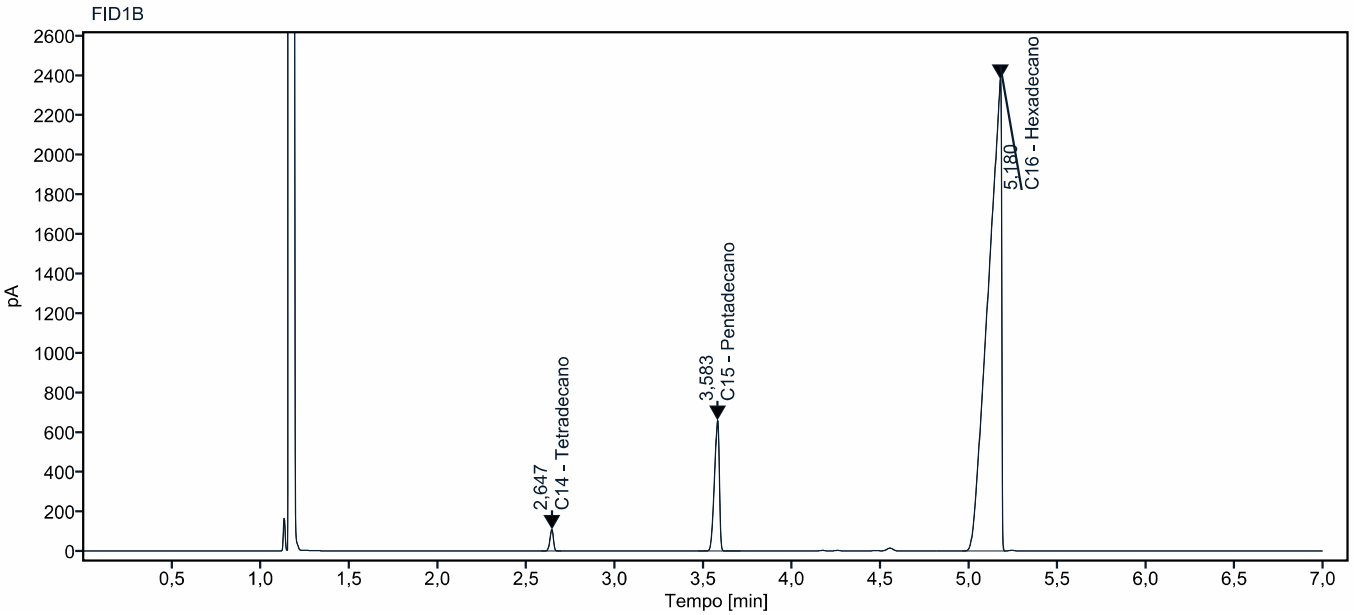

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,647	C14 - Tetradecano	0,1118	153,4900	109,177	1,1023
3,583	C15 - Pentadecano	0,2355	1261,2419	660,278	9,0580
5,180	C16 - Hexadecano	0,2450	12509,3929	2381,701	89,8397
		Soma	**13924,1248**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-04-23-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-05 18:05:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

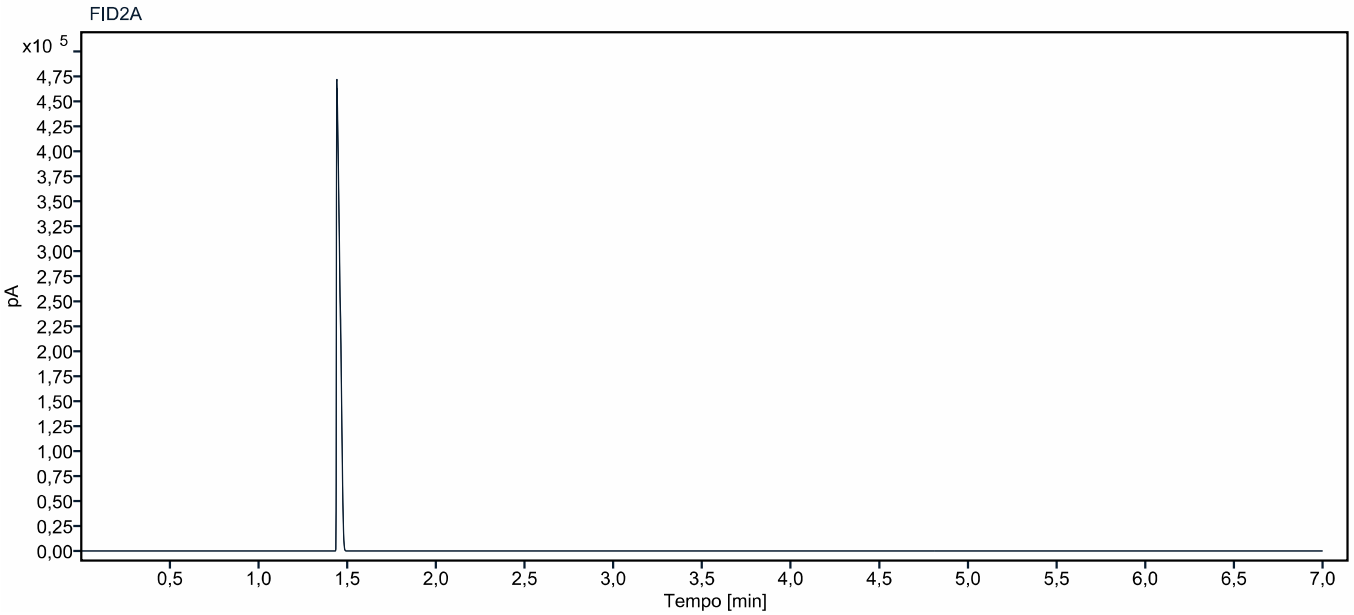


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 10-47-37-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-06 10:49:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

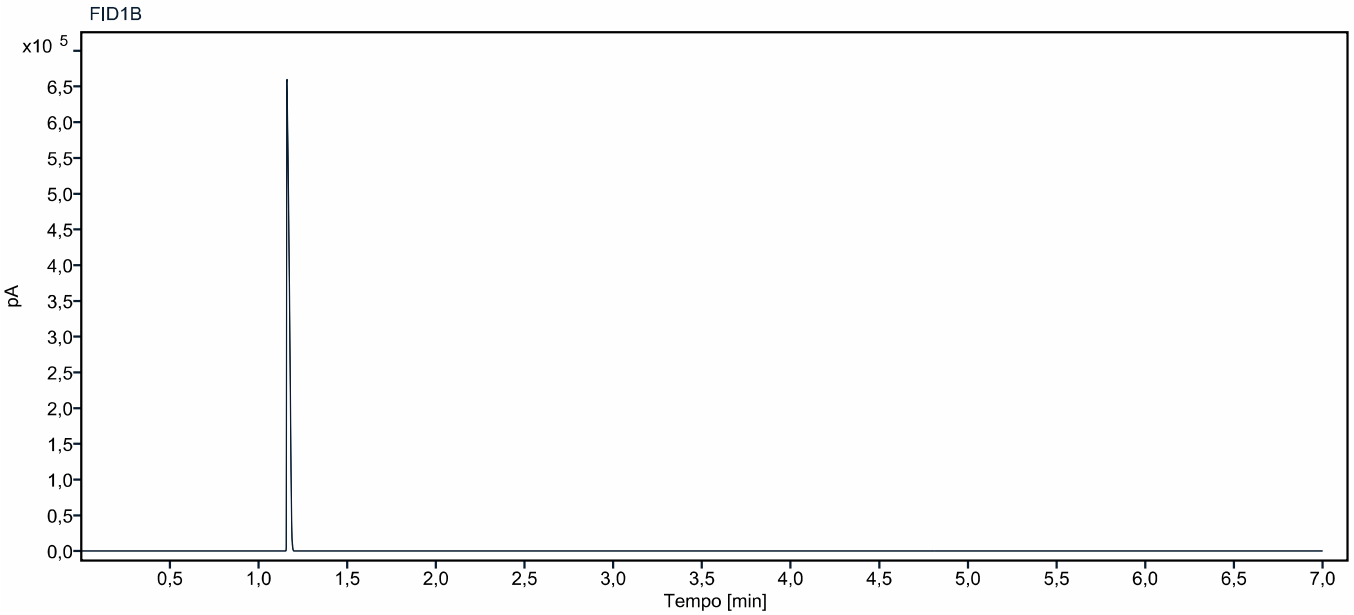


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 18-38-05-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-05 18:39:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

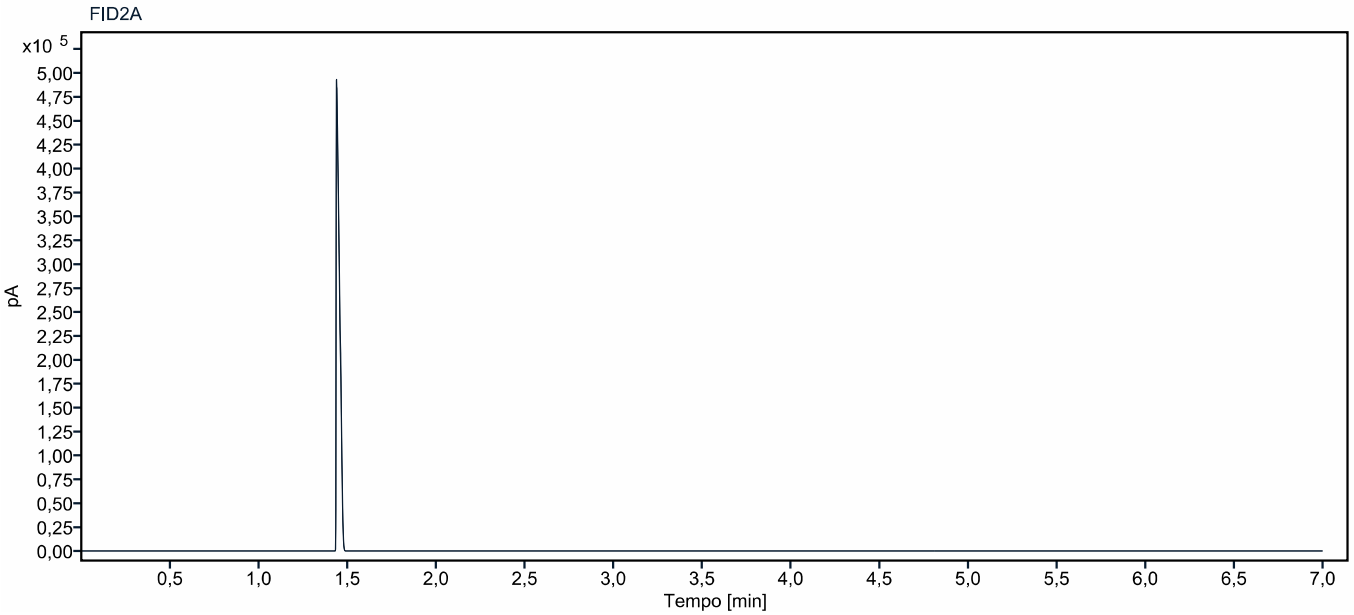


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-23-05-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-06 11:24:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

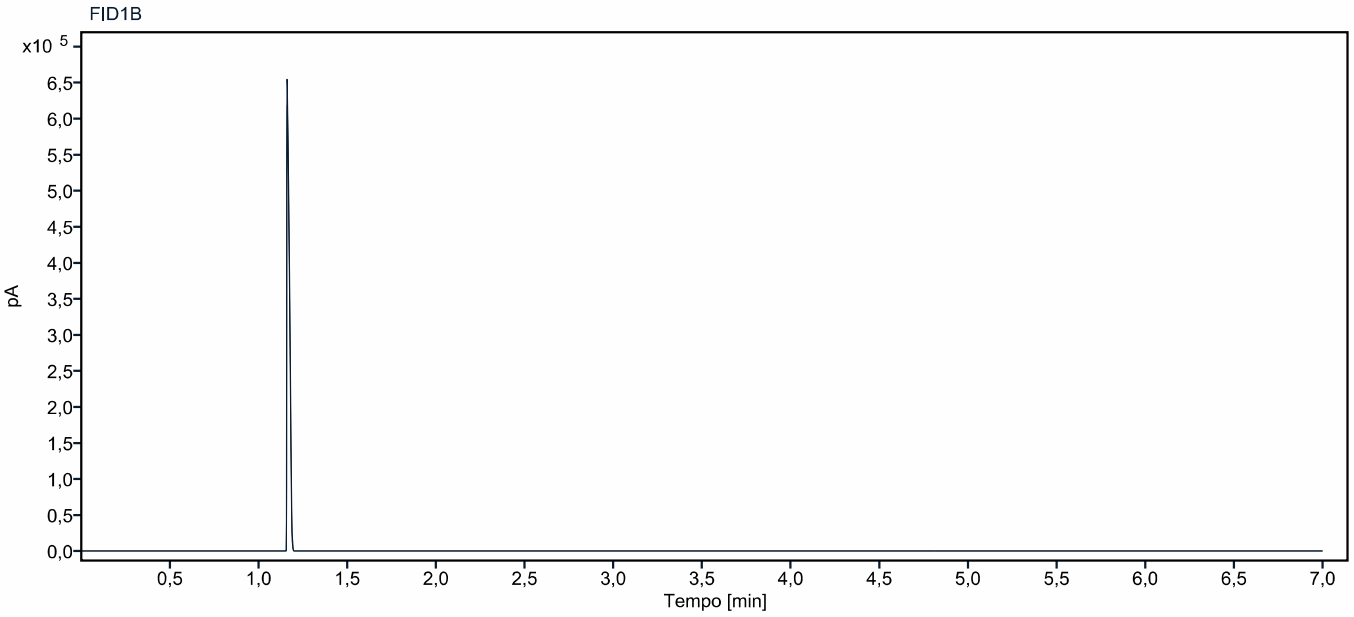


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__.rslt\2026-10-05 19-11-43-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-05 19:13:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 09:30:13-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

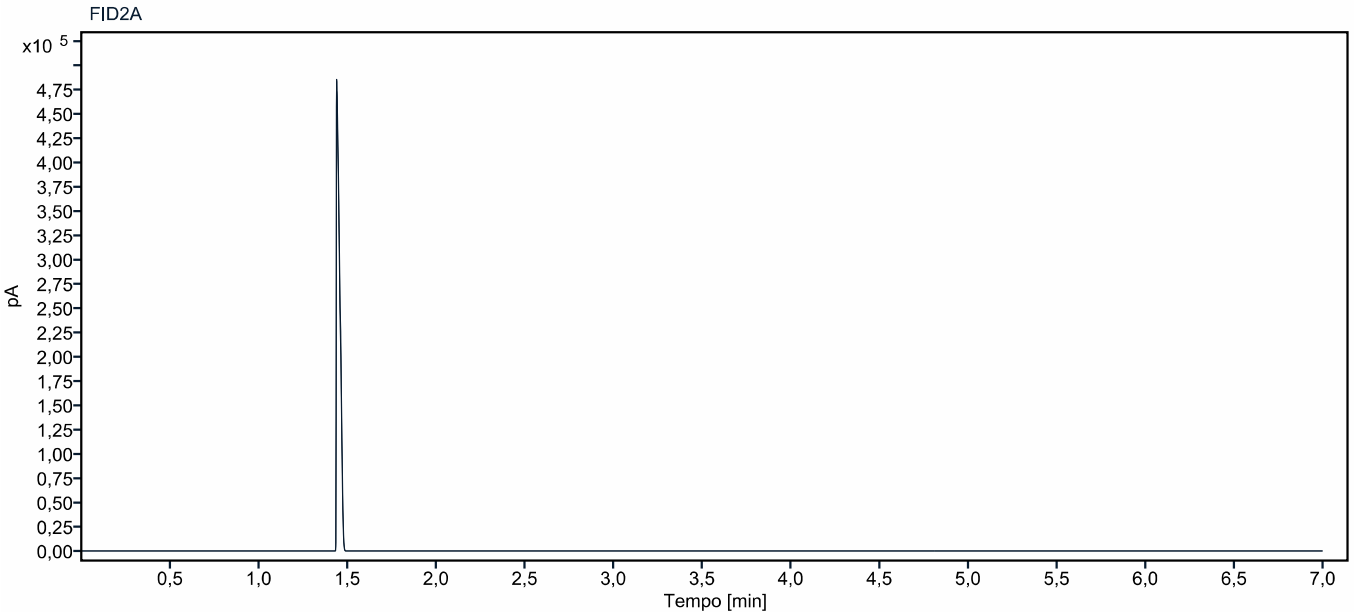


Qualificação QPack


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\PCIN__BACK_.rslt\2026-10-06 11-58-08-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-06 11:59:52-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-06 14:35:57-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

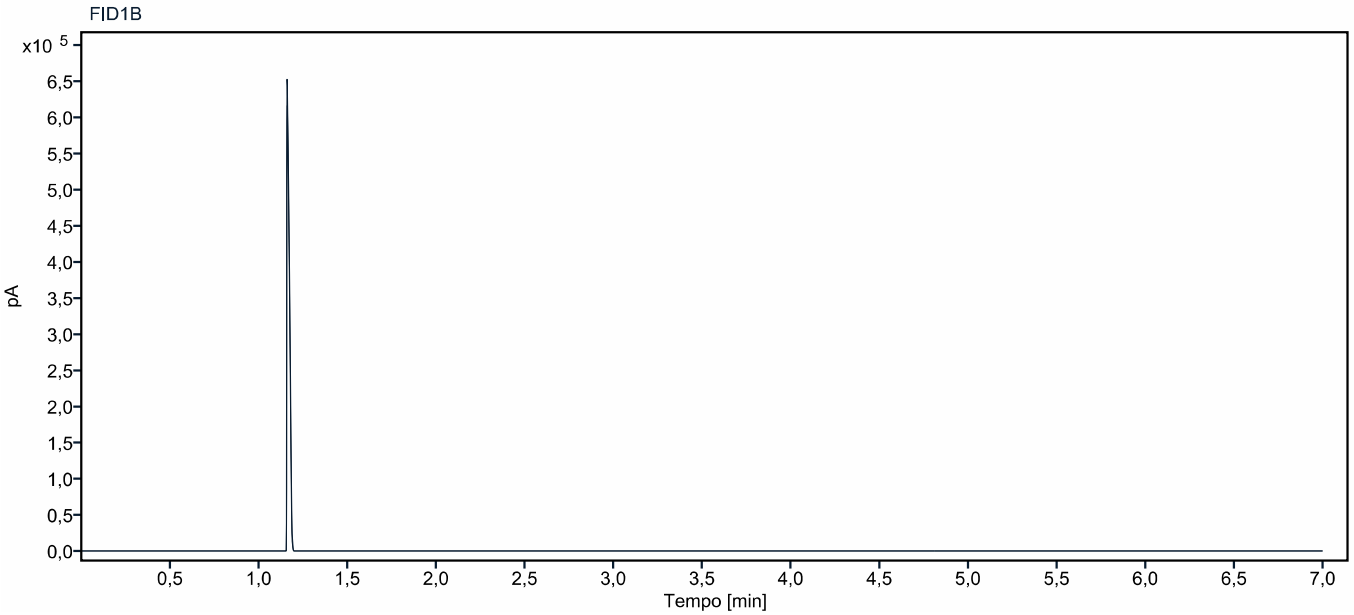

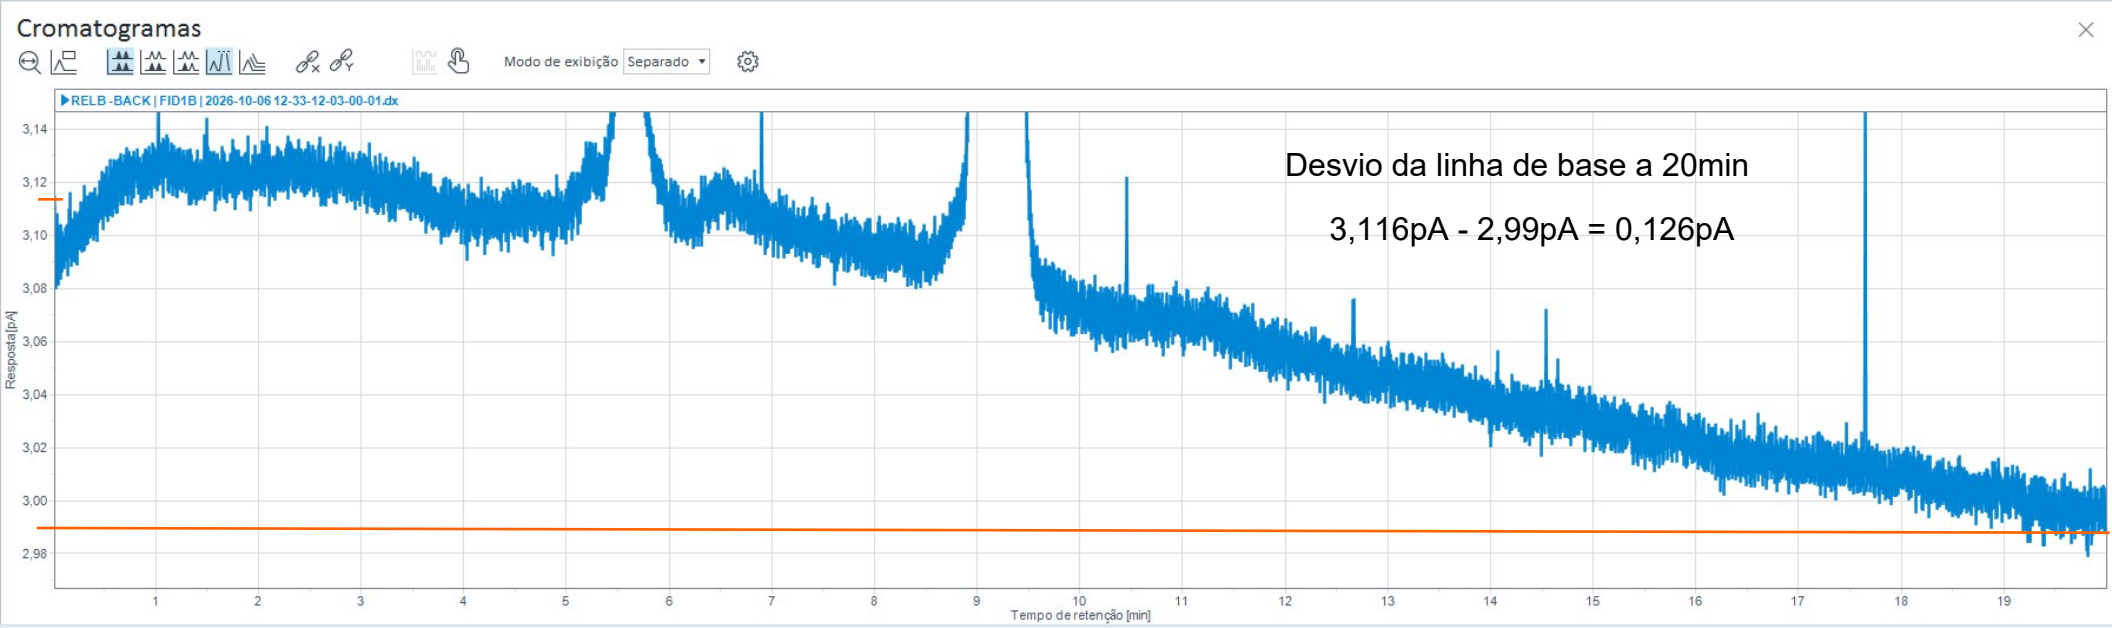
Cromatogramas
Modo de exibição Separado
RELB-BACK | FID1B | 2026-10-06 12-33-12-03-00-01.dx
Desvio da linha de base a 20min
3,116pA - 2,99pA = 0,126pA
Resposta [pA]
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tempo de retenção [min]


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\RELB__BACK_.rslt\2026-10-06 12-33-12-03-00-01.dx
Nome da amostra:	RELB -BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC-01	**Localização:**	3
Data da injeção:	2026-10-06 12:36:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação_RELB_BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			


Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	


Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

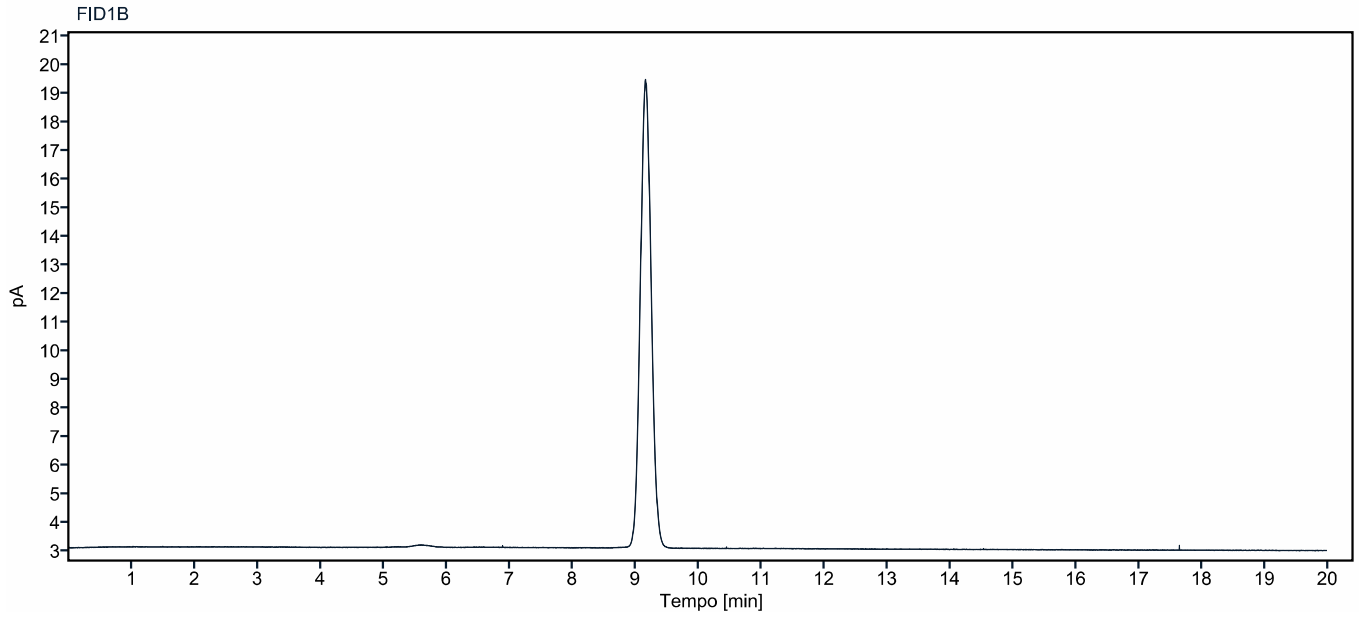

Cromatogramas


Modo de exibição Separado

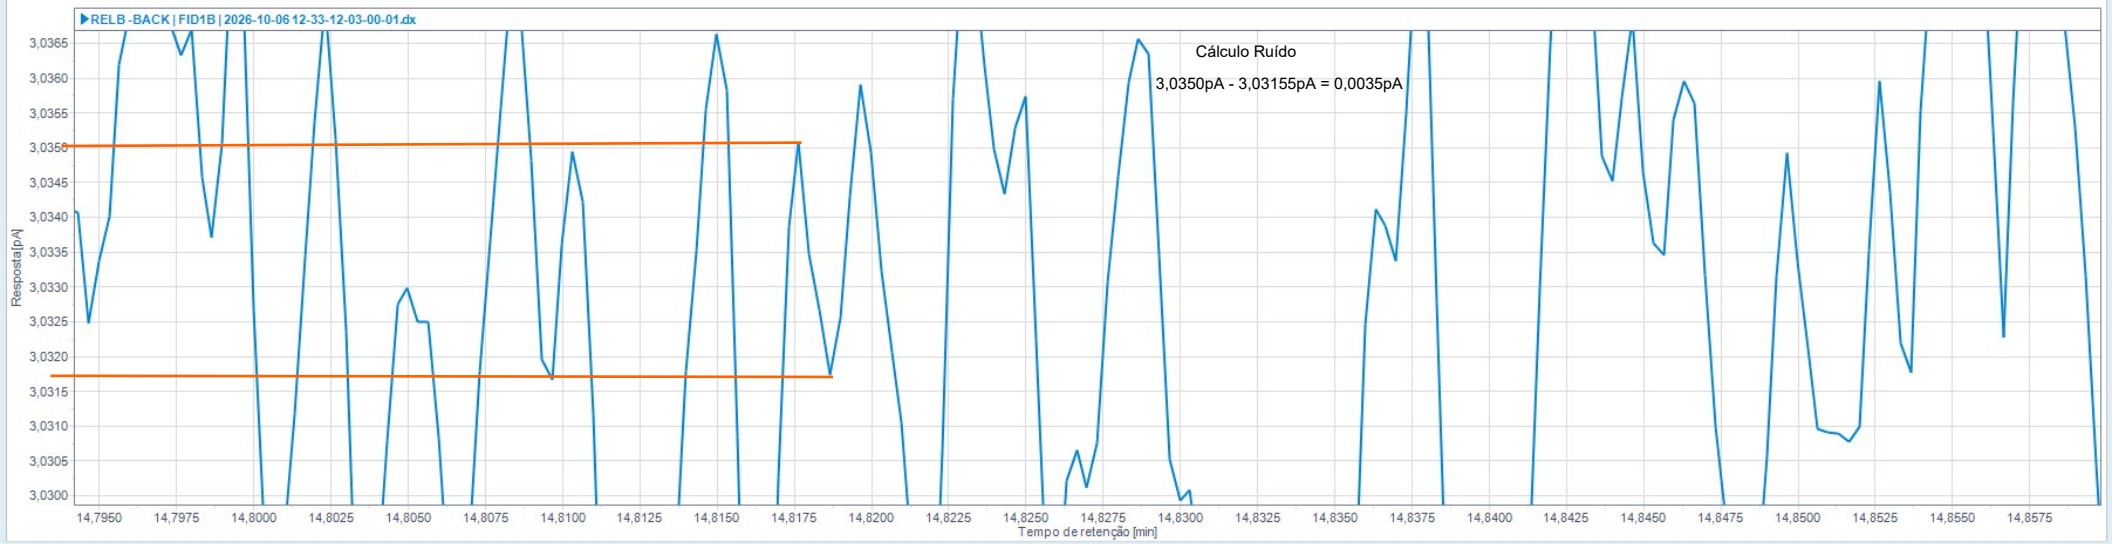


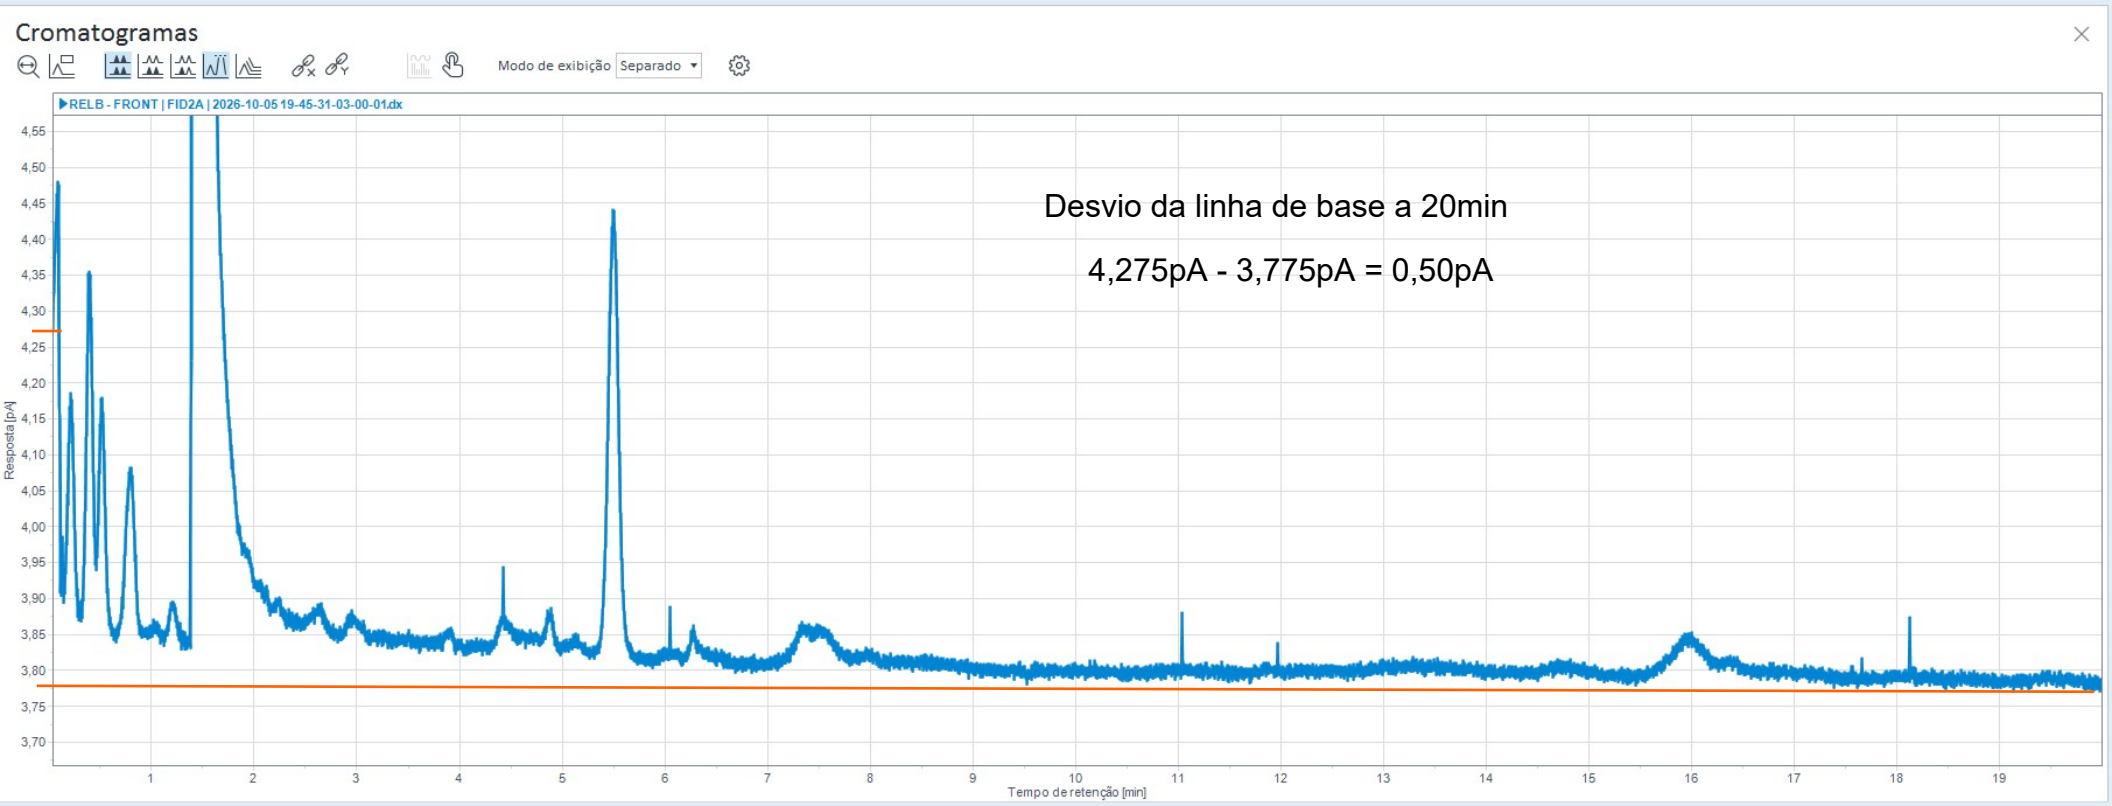
Cromatogramas
Modo de exibição Separado
RELB - FRONT | FID2A | 2026-10-05 19-45-31-03-00-01.dx
Desvio da linha de base a 20min
4,275pA - 3,775pA = 0,50pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]

Single Injection Report

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\QPack_2026\RELB.rslt\2026-10-05 19-45-31-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	RELB - FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0.000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	GC-01	**Localização:**	3
Data da injeção:	2026-10-05 19:46:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1

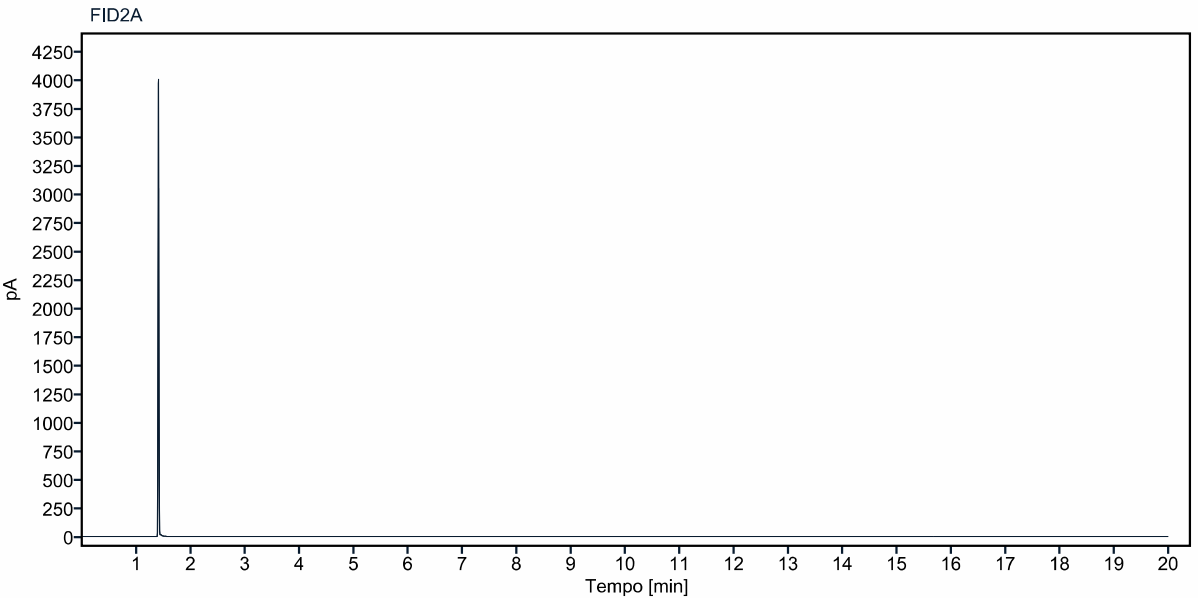

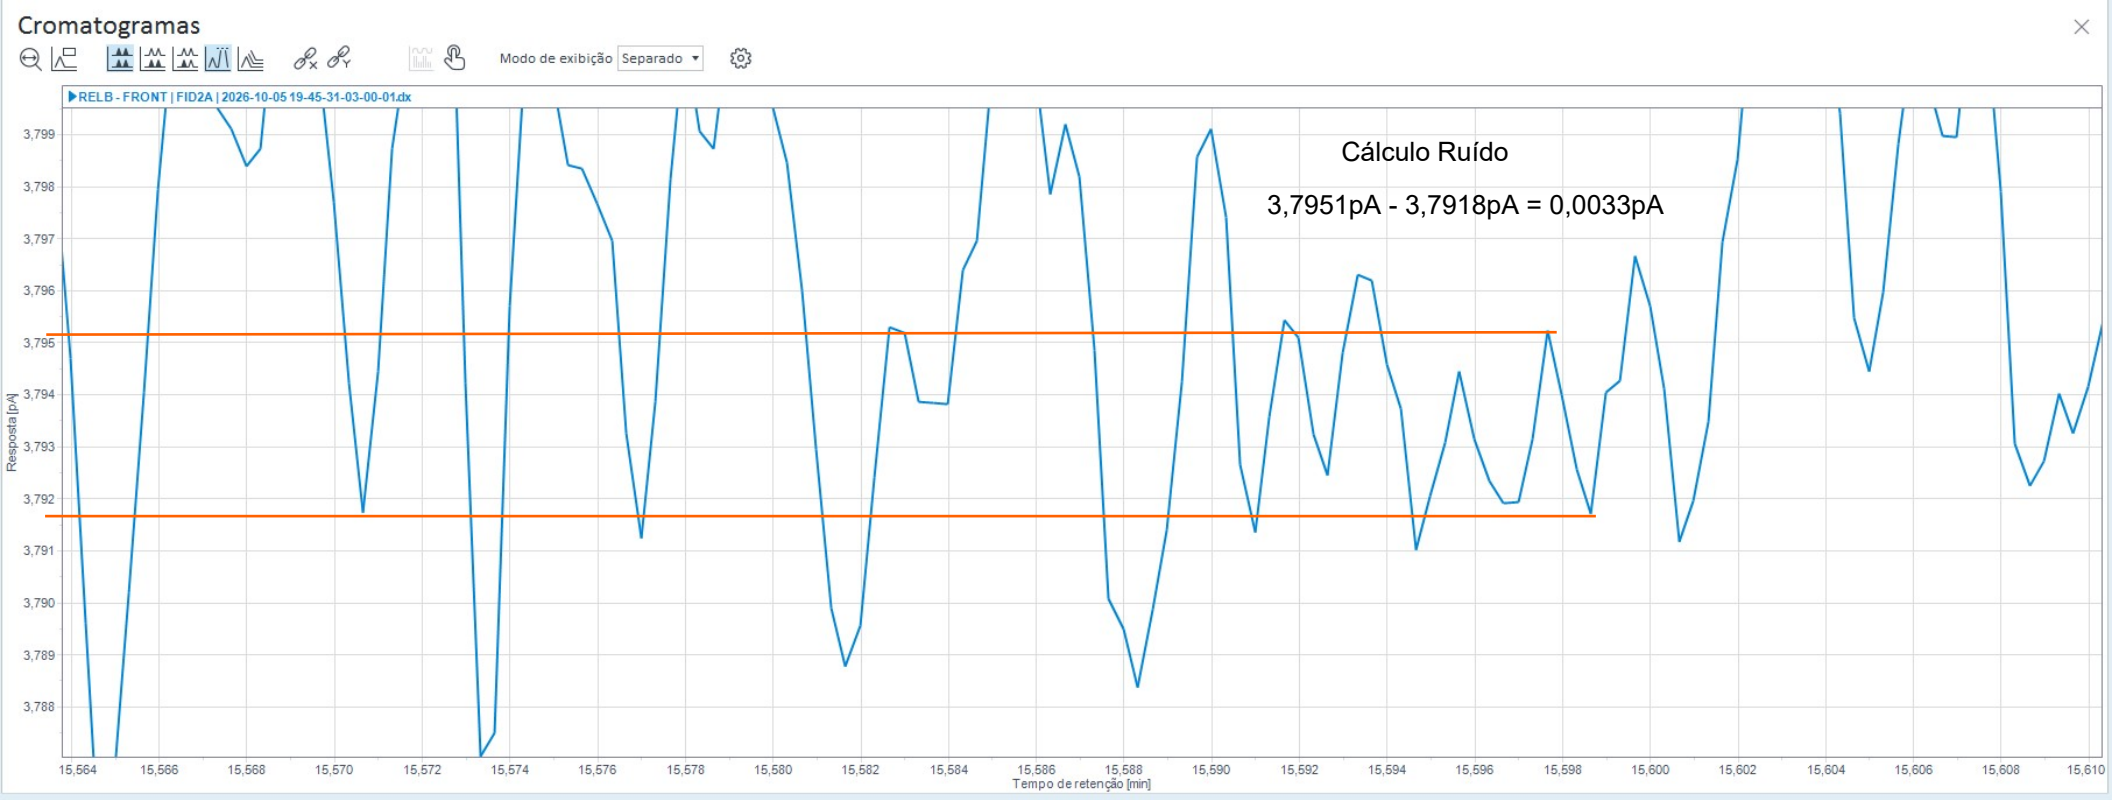
Cromatogramas
Modo de exibição
Separado
RELB - FRONT | FID2A | 2026-10-05 19-45-31-03-00-01.dx
Cálculo Ruído
3,7951pA - 3,7918pA = 0,0033pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]