| Certificado Nº: 581/24-RELB | Início da Qualificação: 18/11/2024 | Página 1 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido na altura do pico**

| | ALTURA DO PICO (mAU) |
|---|---|
| **Resultado:** | **250,707** |

**<Peak Table>**

PDA Ch1 250nm

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Name | S/N | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,221 | 866793 | 250707 | Cafeína | 36443,33 | 6,88 |
| Total | | 866793 | 250707 | | | |



| Certificado Nº: 000/00-RELB | Início da Qualificação: 00/00/0000 | Página 2 de 3 |
|---|---|---|


**Resultado obtido no teste de sinal/ruído**

| Resultado: | Ruído (mAU) |
|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | **0,0069** |
| VALOR MÍNIMO: | **0,0000** |
| | **Ruído** |
| RESULTADO: | **0,0069** |

**<Peak Table>**

PDA Ch1 250nm

| Peak# | Ret. Time | Area | Height | Name | S/N | Noise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,221 | 866793 | 250707 | Cafeína | 36443,33 | 6,88 |
| Total | | 866793 | 250707 | | | |

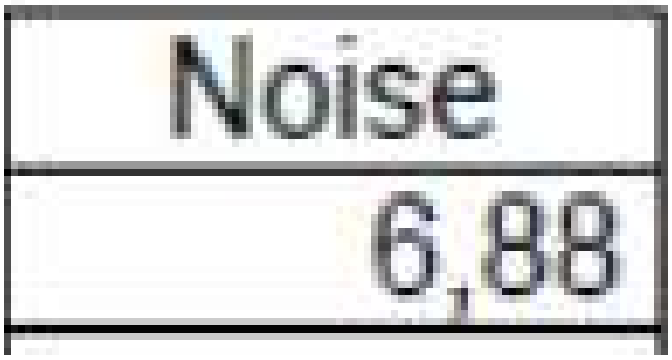

| Certificado Nº: 000/00 - RELB | Início da Qualificação: 00/00/0000 | Página 3 de 3 |
|---|---|---|

**Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base**

| Estabilidade da Linha de Base | Diferença 20 min | Diferença 60 min |
|---|---|---|
| VALOR MÁXIMO: | **0,0000** | **0,2550** |
| VALOR MÍNIMO: | **-0,0850** | |
| **Resultado:** | **0,0850** | |

