
nas

Modo de exibição Sobreposto

atura 001 | GCO1A,Forno Temperatura Real

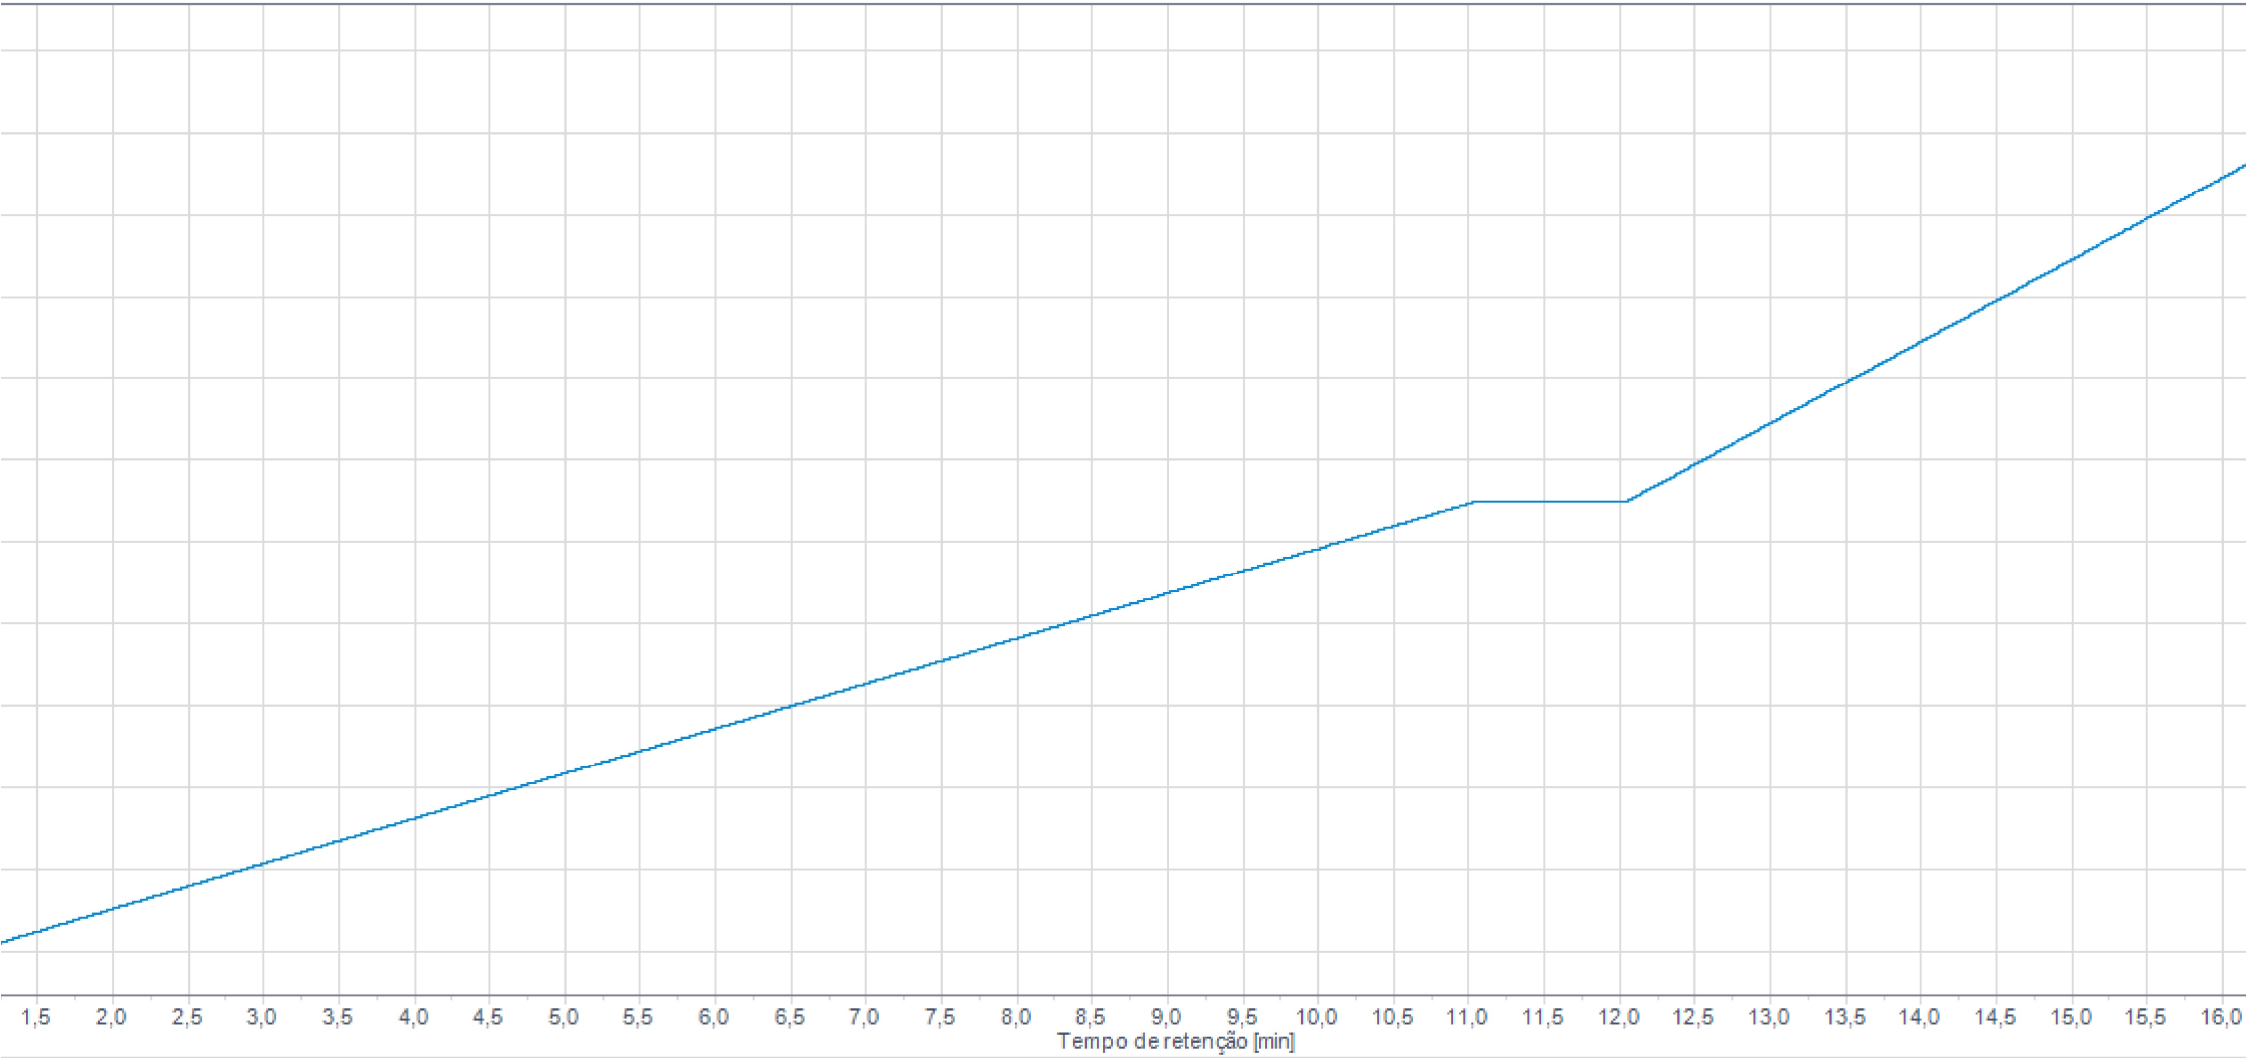


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-06-24-03-00-01.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 09:08:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

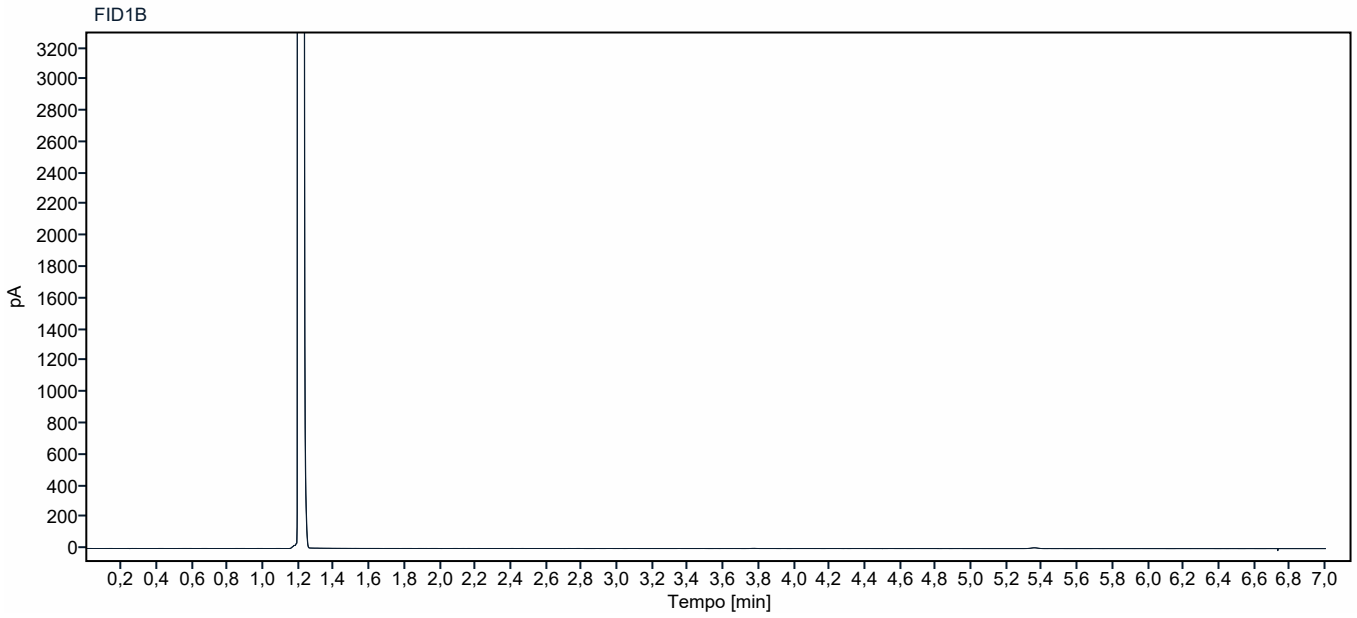


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-15-05-03-00-02.dx
Nome da amostra:	BACK - PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 09:16:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

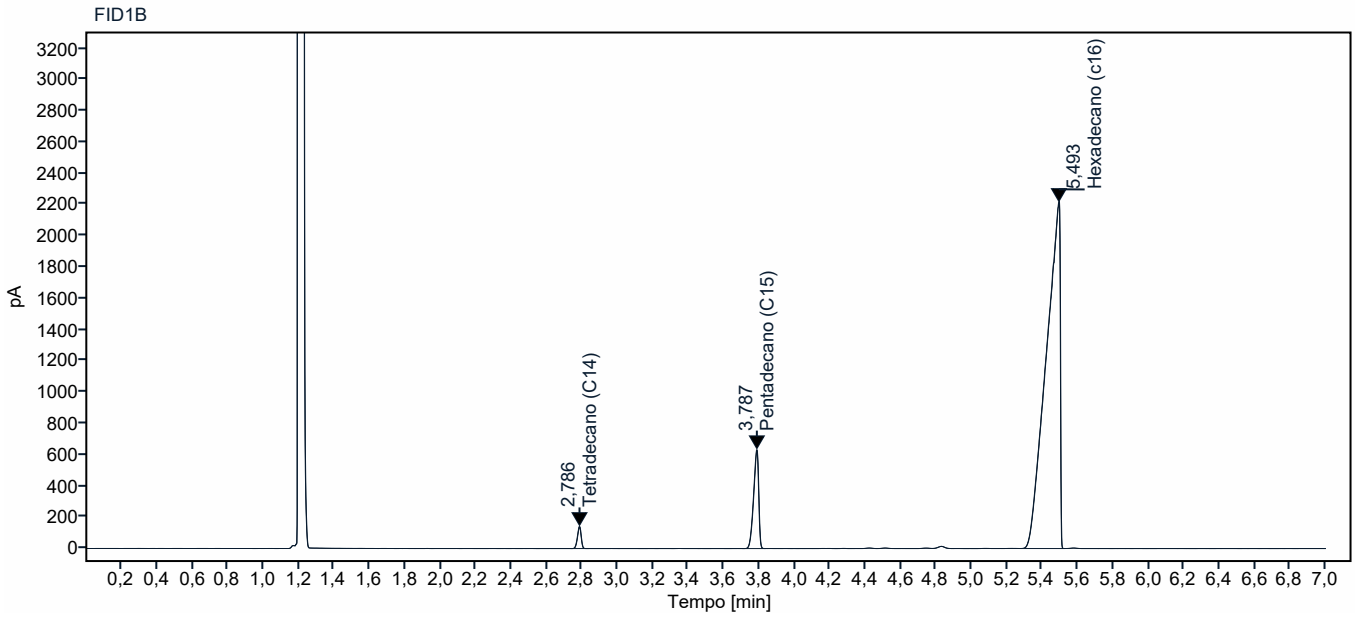

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786	Tetradecano (C14)	0,1021	203,6597	140,788	1,4897
3,787	Pentadecano (C15)	0,1296	1256,7815	632,258	9,1930
5,493	Hexadecano (c16)	0,2555	12210,5615	2214,362	89,3172
		Soma	**13671,0027**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-23-49-03-00-03.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 09:25:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

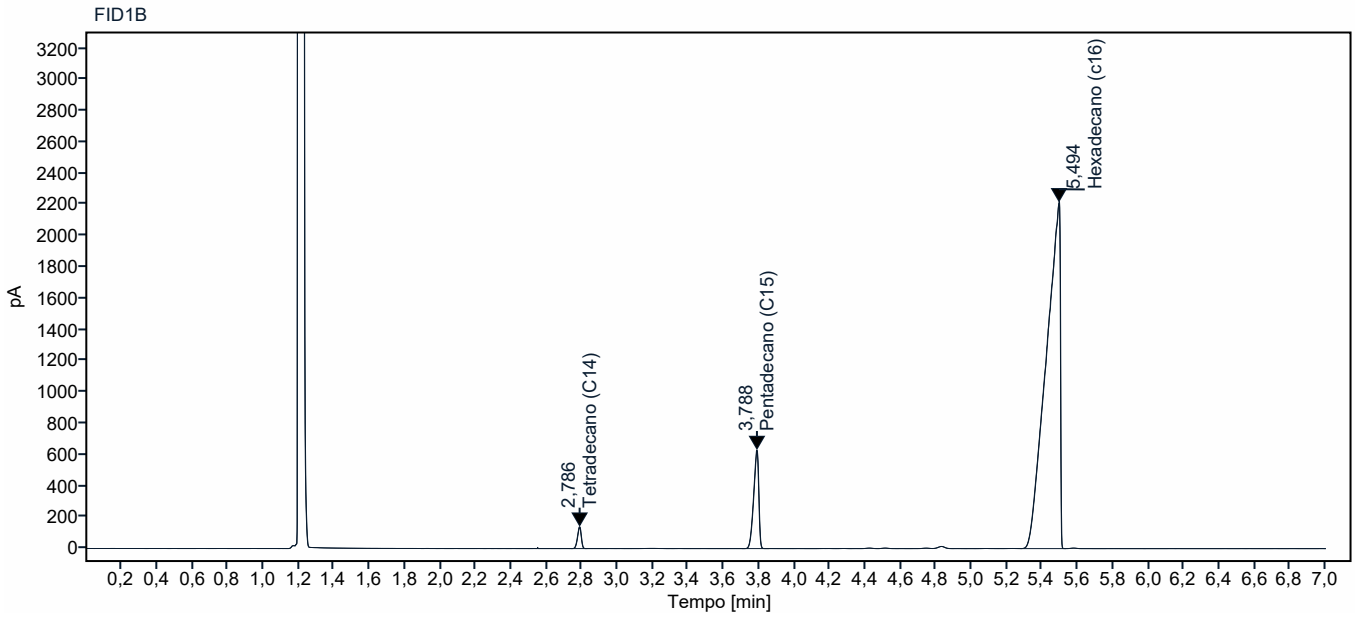

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786	Tetradecano (C14)	0,0873	203,6564	139,167	1,4877
3,788	Pentadecano (C15)	0,1525	1257,5563	629,885	9,1863
5,494	Hexadecano (c16)	0,2569	12228,2784	2215,293	89,3260
		Soma	**13689,4911**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-32-36-03-00-04.dx
Nome da amostra:	BACK - PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 09:34:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

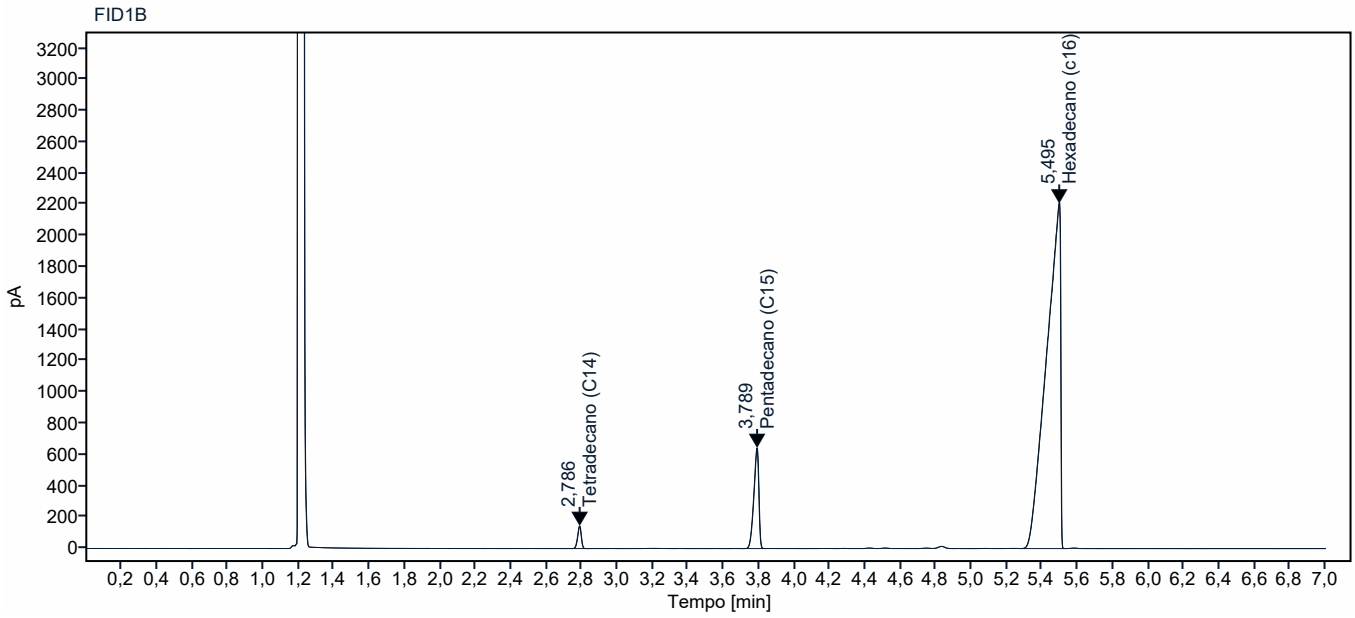


Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786	Tetradecano (C14)	0,0999	204,5814	144,017	1,4904
3,789	Pentadecano (C15)	0,1437	1261,6225	643,051	9,1911
5,495	Hexadecano (c16)	0,2562	12260,3395	2207,784	89,3185
		Soma	**13726,5433**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-41-17-03-00-05.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 09:42:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

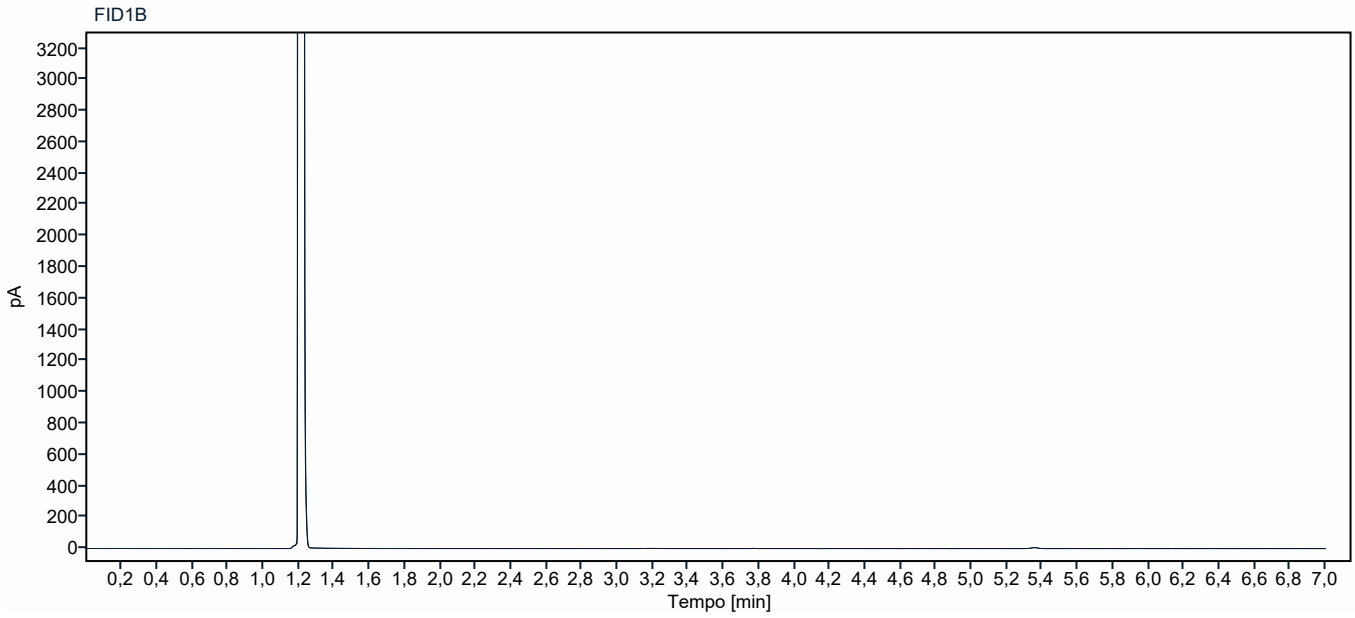


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-50-04-03-00-06.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 09:51:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

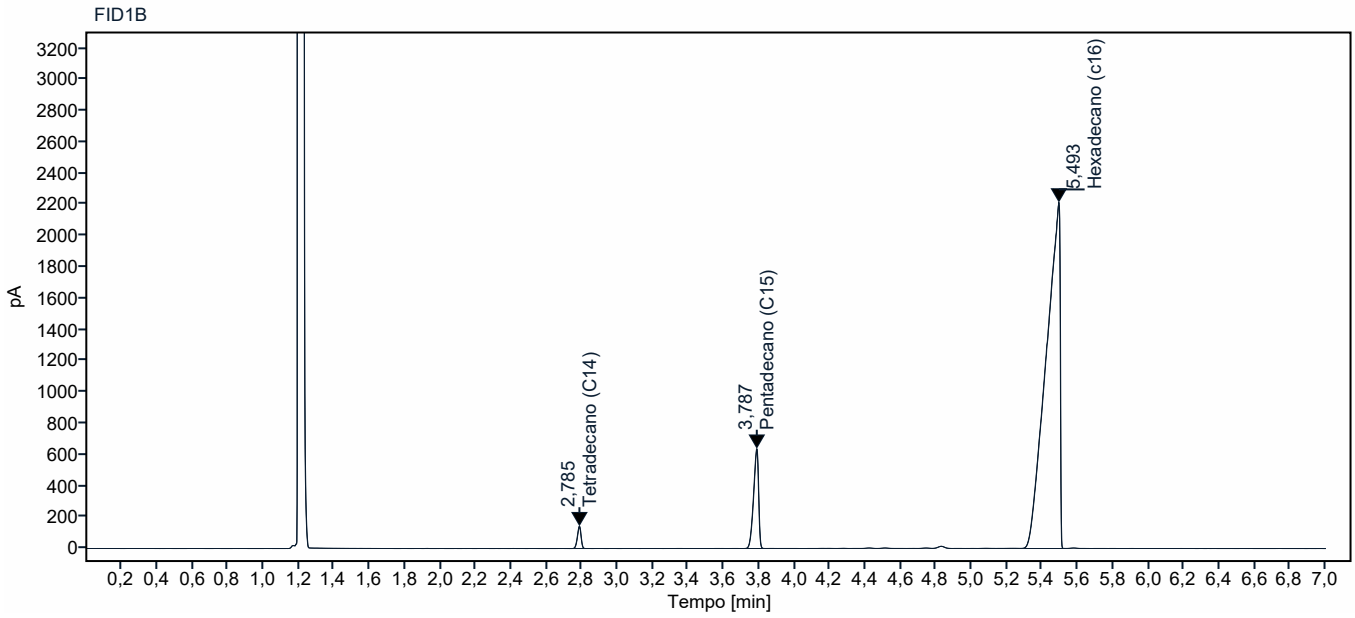

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,785	Tetradecano (C14)	0,1368	203,3890	141,951	1,4938
3,787	Pentadecano (C15)	0,1409	1252,1033	637,619	9,1963
5,493	Hexadecano (c16)	0,2579	12159,7308	2213,563	89,3098
	Soma		**13615,2231**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 09-58-58-03-00-07.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 10:00:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

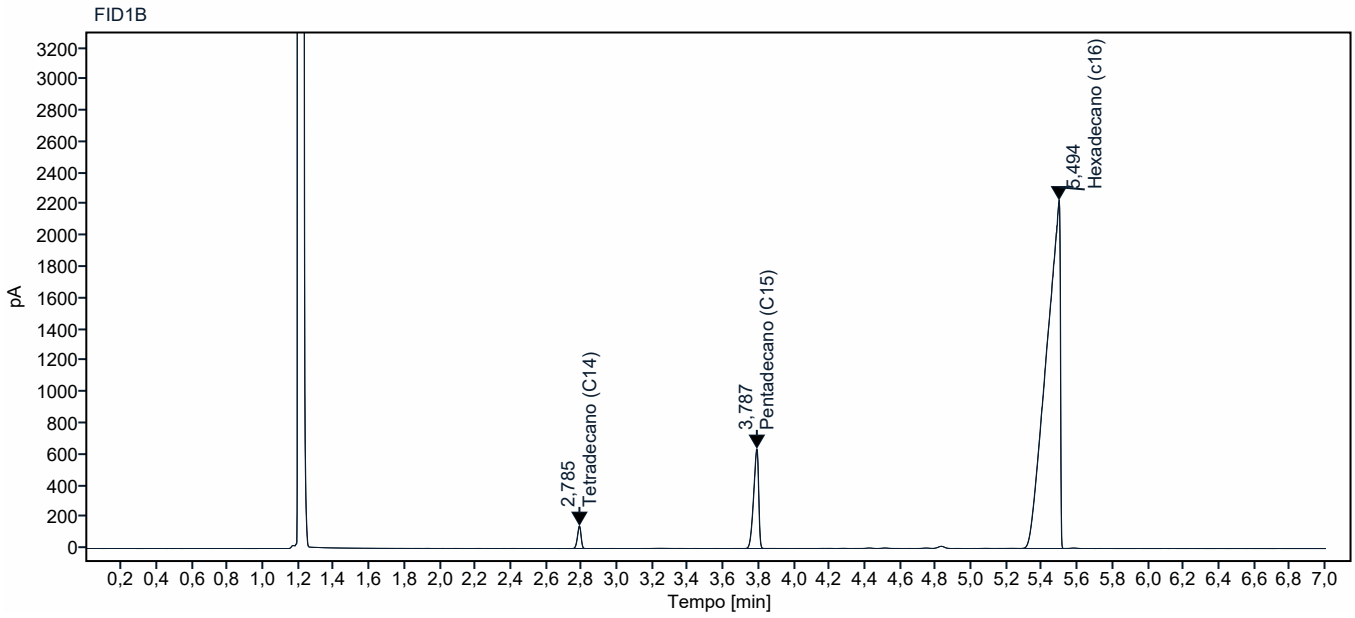

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,785	Tetradecano (C14)	0,1261	202,8782	143,750	1,4928
3,787	Pentadecano (C15)	0,1356	1249,8436	636,778	9,1966
5,494	Hexadecano (c16)	0,2538	12137,4841	2227,250	89,3105
		Soma	**13590,2059**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 10-07-38-03-00-08.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 10:09:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

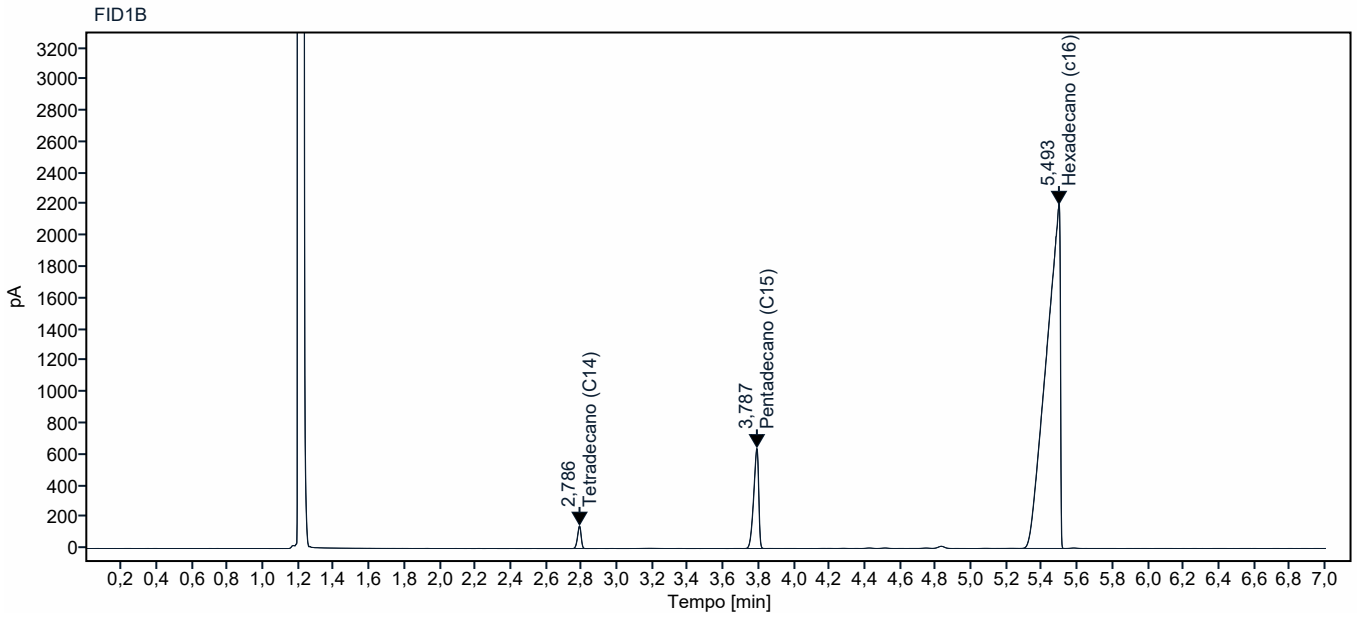

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786	Tetradecano (C14)	0,1081	202,3751	143,688	1,4914
3,787	Pentadecano (C15)	0,1288	1248,0743	640,087	9,1975
5,493	Hexadecano (c16)	0,2526	12119,2107	2196,741	89,3111
		Soma	**13569,6602**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN 001.rslt\2025-10-28 10-16-23-03-00-09.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 10:18:04-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 10:39:06-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

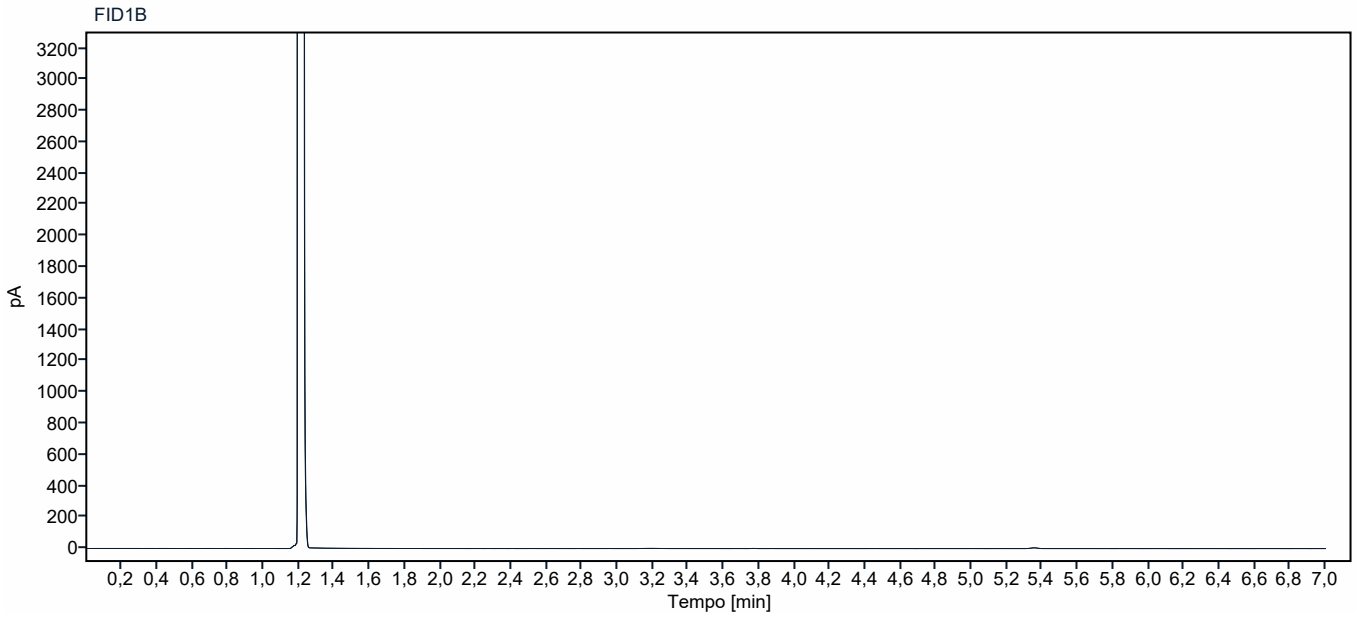


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI 001.rslt\2025-10-28 10-25-16-03-00-01.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 10:26:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 09:04:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

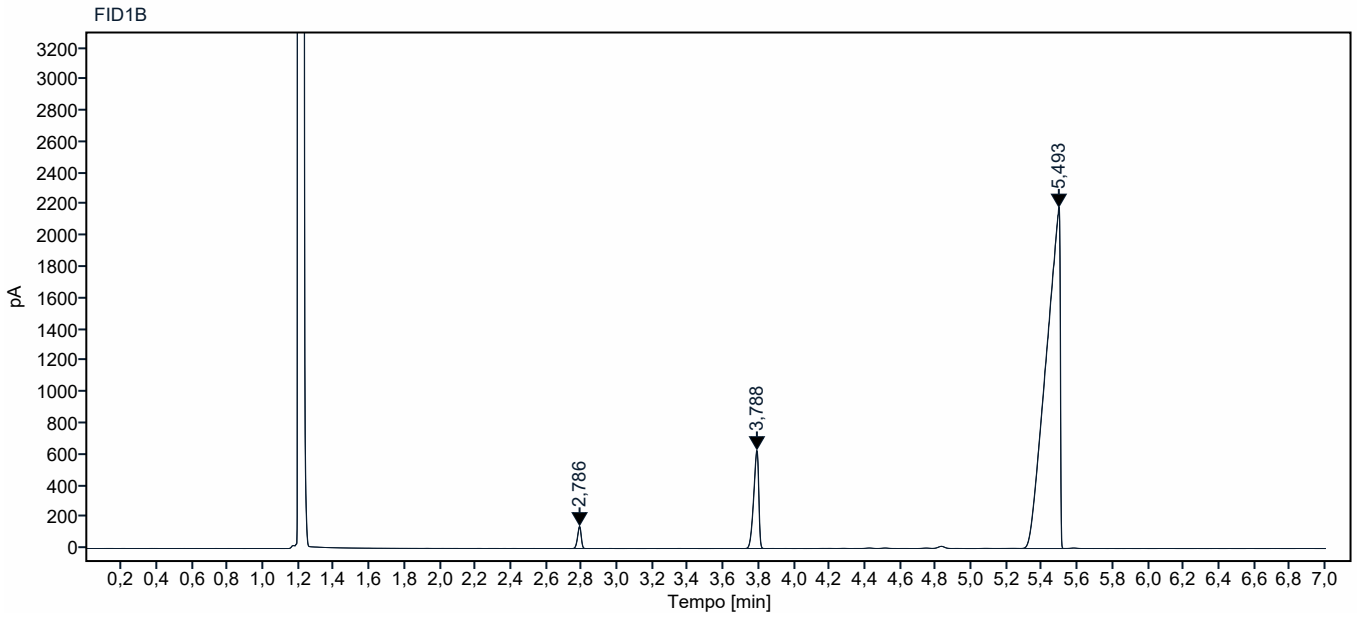

Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786		0,1177	200,8397	140,820	1,4922
3,788		0,1355	1237,1604	626,815	9,1919
5,493		0,2508	12021,2019	2178,795	89,3159
		Soma	**13459,2019**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI 001.rslt\2025-10-28 10-33-55-03-00-02.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 02
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 10:35:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 09:04:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

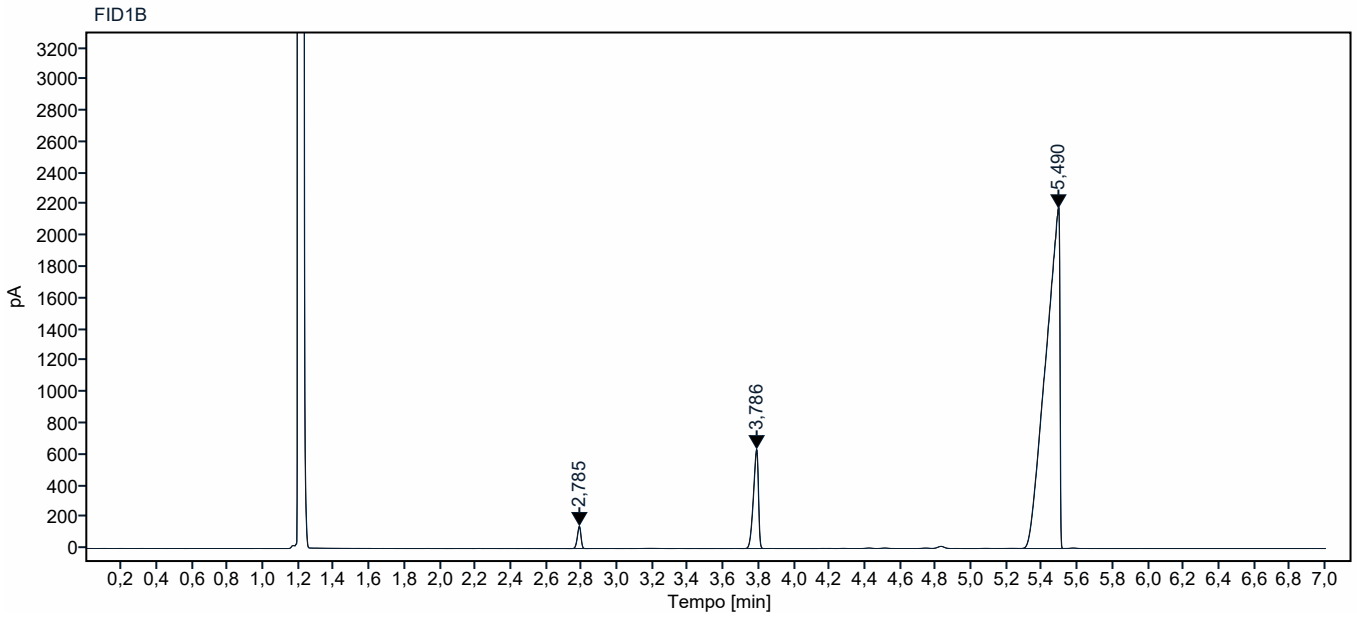

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,785		0,1223	201,2269	141,865	1,4914
3,786		0,1433	1240,7690	633,655	9,1962
5,490		0,2500	12050,2348	2174,876	89,3124
		Soma	**13492,2308**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI 001.rslt\2025-10-28 10-42-40-03-00-03.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 10:44:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 09:04:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

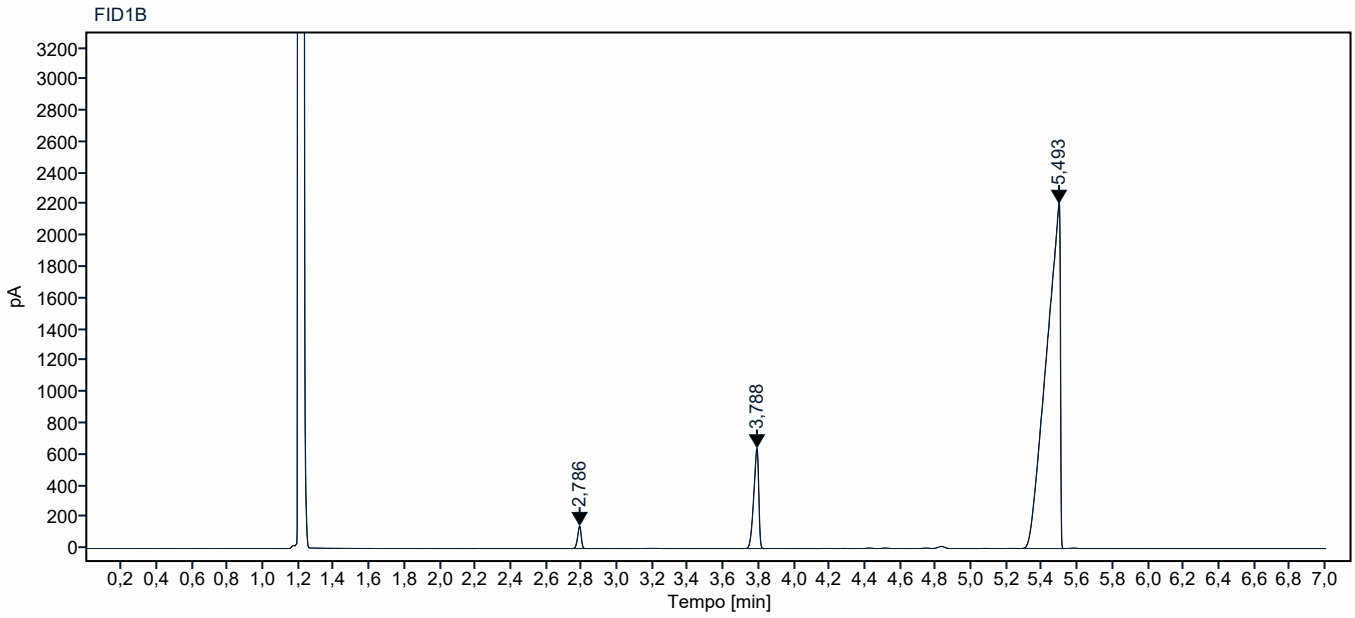

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,786		0,0915	201,2846	142,471	1,4886
3,788		0,1519	1243,1820	639,617	9,1938
5,493		0,2520	12077,4456	2203,986	89,3176
		Soma	**13521,9123**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: RELB BACK003.dx\RELB BACK003.dx
Nome da amostra: RELB BACK003
Descrição:


Instrumento:	CG01	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-28 12:26:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

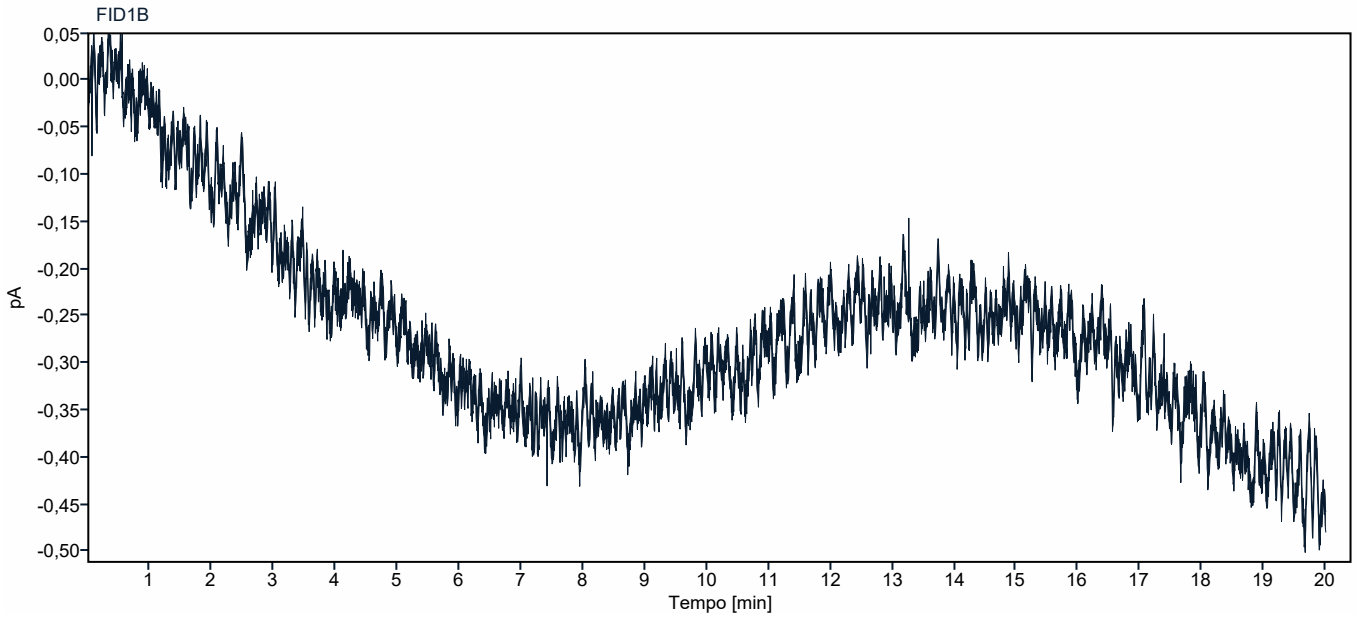

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	RELB BACK003.dx\RELB BACK003.dx		
Nome da amostra:	RELB BACK003		
Descrição:			
Instrumento:	CG01	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-28 12:26:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-1		
Série #:			

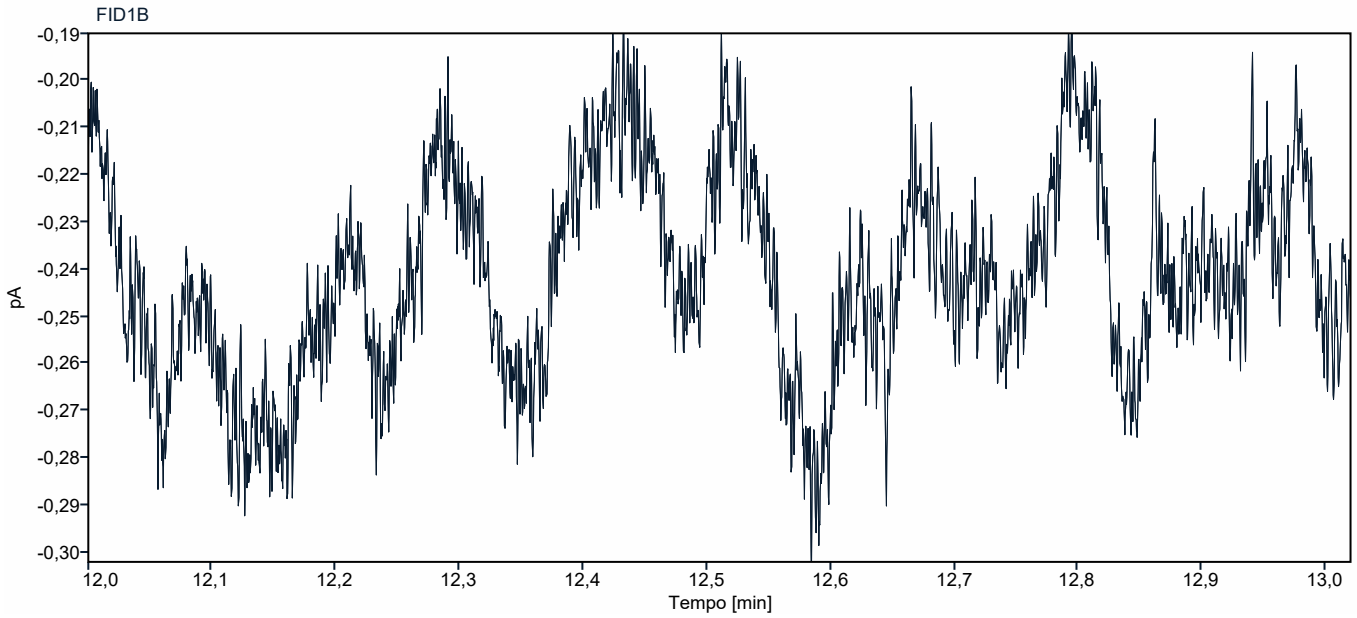


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 01.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 13:22:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

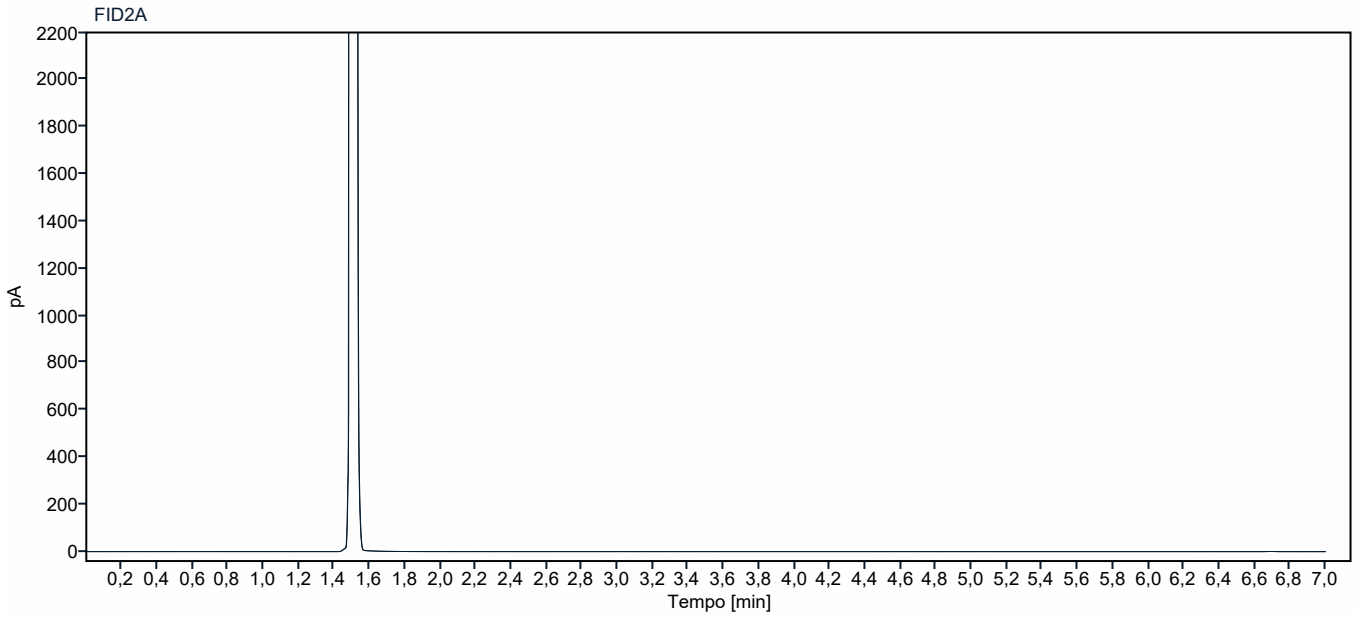


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 01.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 13:31:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

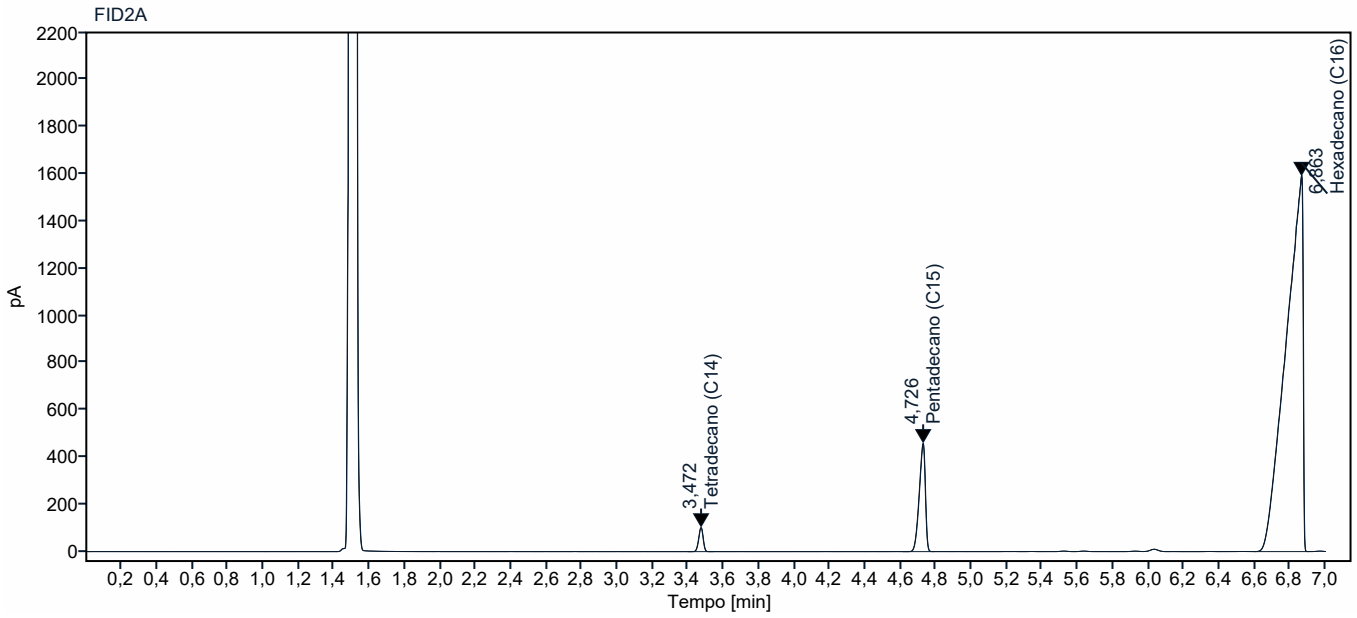

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,472	Tetradecano (C14)	0,1460	178,1992	101,691	1,4952
4,726	Pentadecano (C15)	0,1746	1097,2678	458,377	9,2065
6,863	Hexadecano (C16)	0,3065	10642,9429	1590,739	89,2983
		Soma	**11918,4100**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 02.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 13:39:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

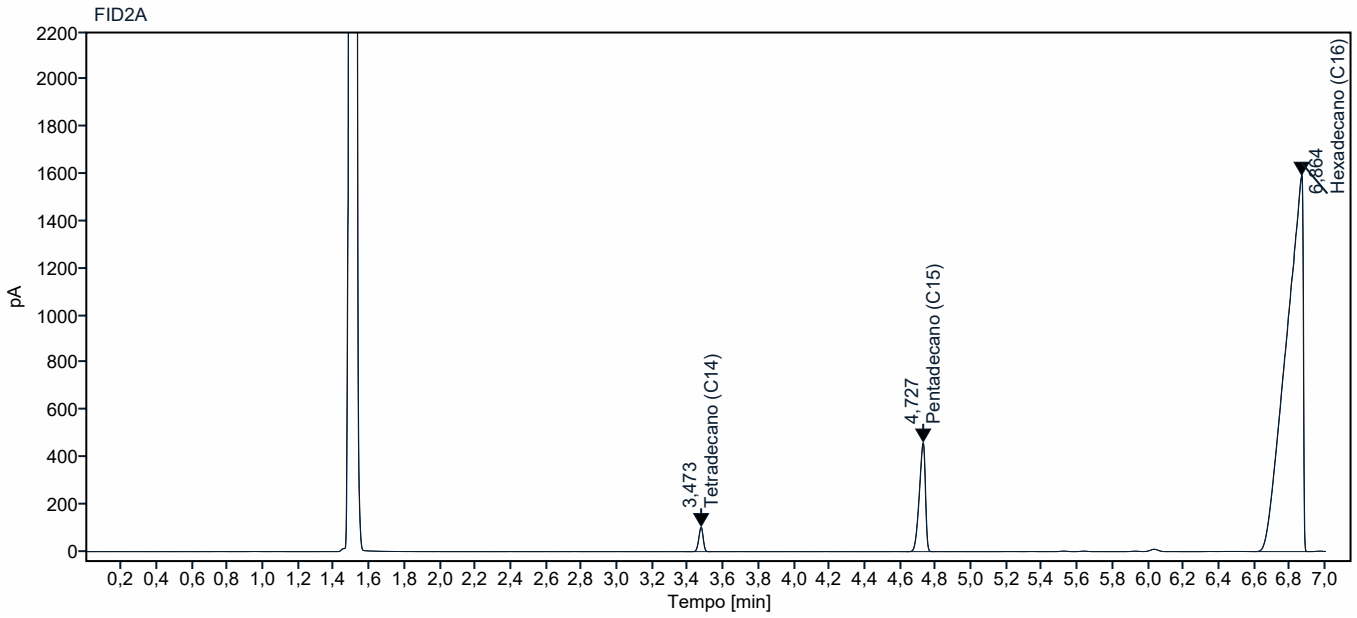

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,473	Tetradecano (C14)	0,1497	178,2498	102,566	1,4939
4,727	Pentadecano (C15)	0,1580	1097,7324	460,724	9,2001
6,864	Hexadecano (C16)	0,3027	10655,6984	1591,271	89,3059
		Soma	**11931,6807**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 03.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 13:47:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

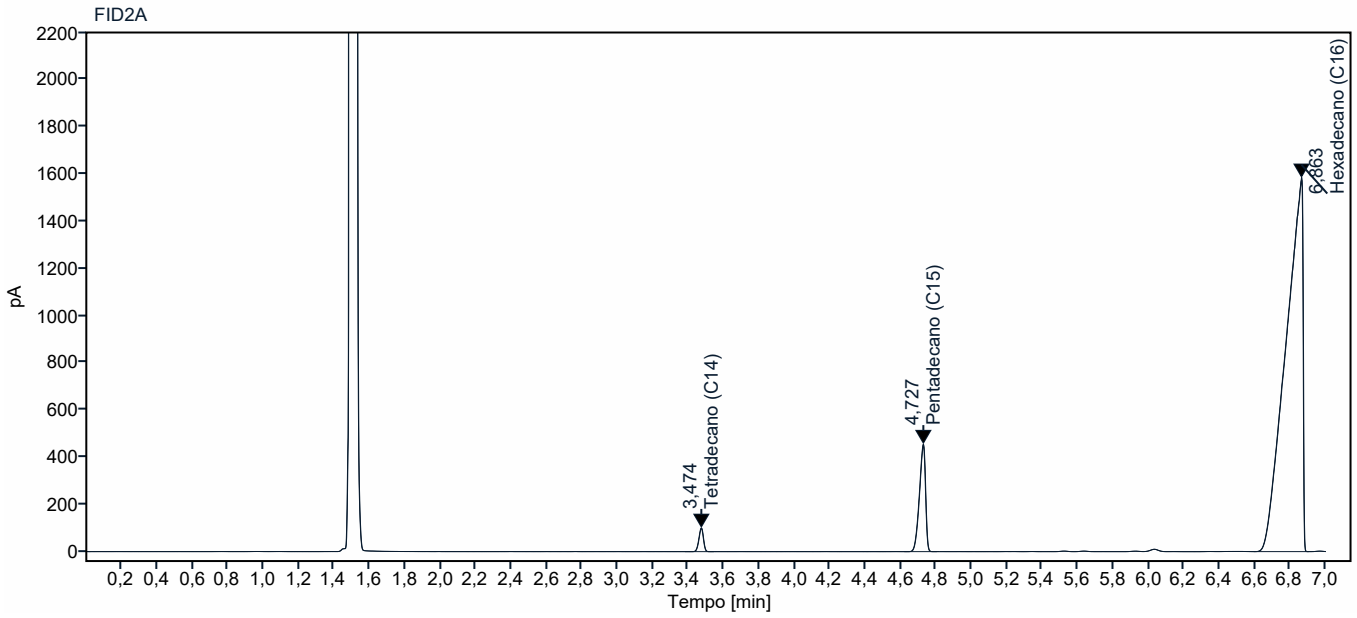

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,474	Tetradecano (C14)	0,1615	177,5426	99,877	1,4924
4,727	Pentadecano (C15)	0,1833	1093,9659	455,063	9,1959
6,863	Hexadecano (C16)	0,3097	10624,6958	1583,578	89,3116
		Soma	**11896,2043**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 02.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 13:56:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

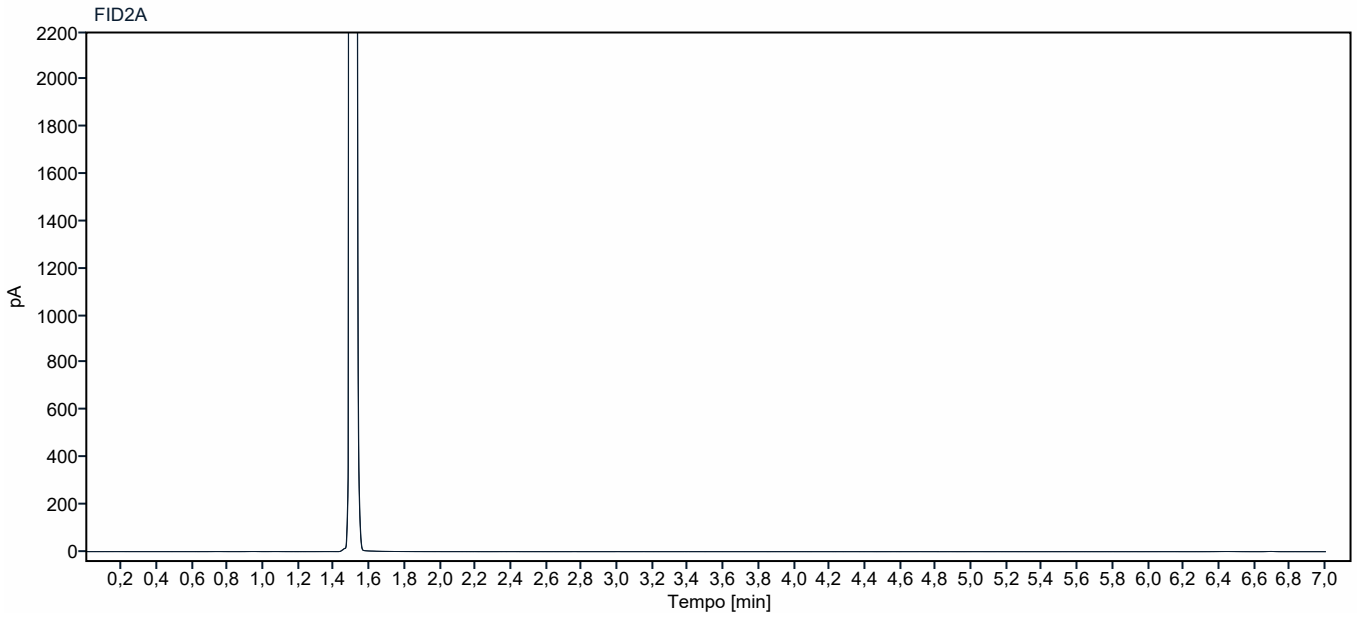


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 04.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:04:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

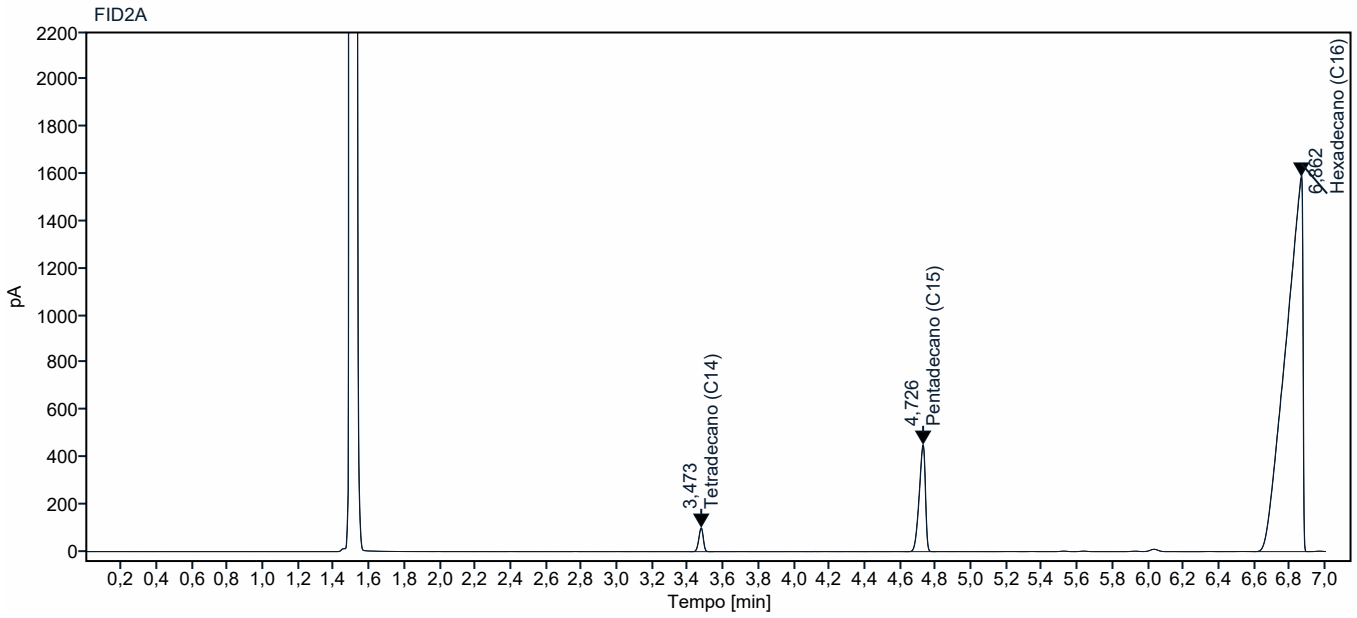


Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,473	Tetradecano (C14)	0,1351	177,3324	100,422	1,4911
4,726	Pentadecano (C15)	0,1770	1093,5815	452,095	9,1956
6,862	Hexadecano (C16)	0,3095	10621,5346	1588,572	89,3133
		Soma	**11892,4485**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 05.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:13:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	HP-1		
Série #:			

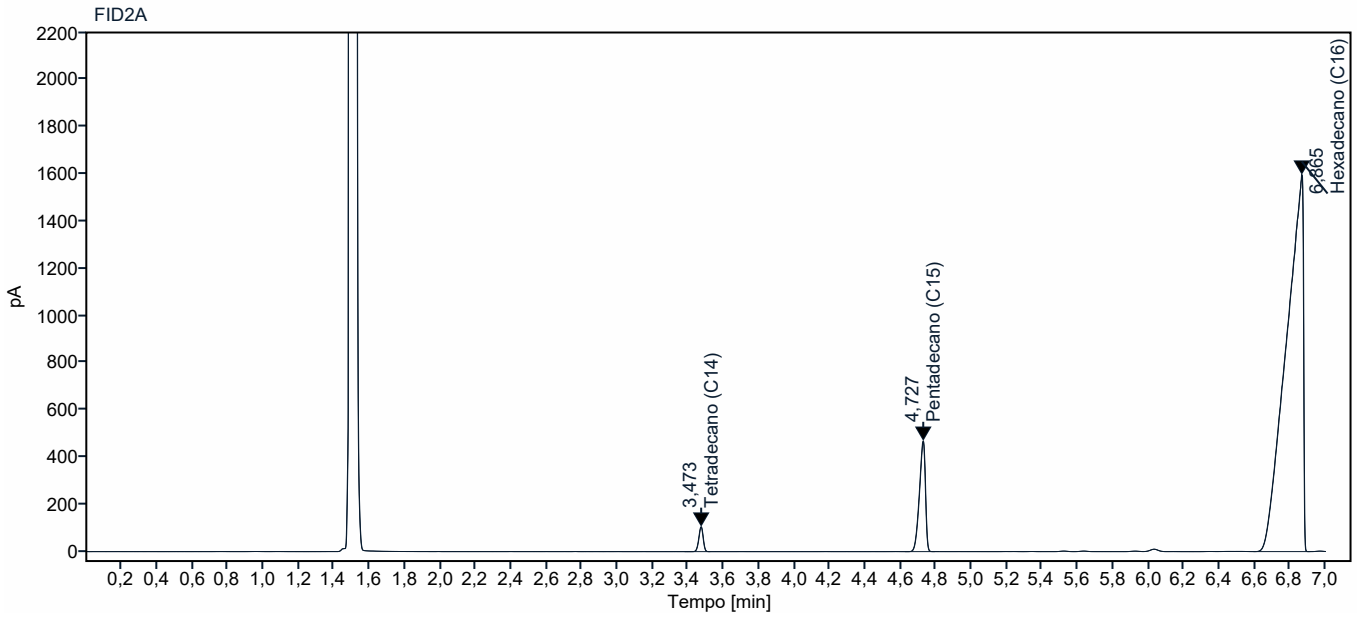

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,473	Tetradecano (C14)	0,1446	179,4993	105,257	1,4922
4,727	Pentadecano (C15)	0,1667	1106,3505	469,046	9,1970
6,865	Hexadecano (C16)	0,3171	10743,5810	1596,880	89,3108
		Soma	**12029,4309**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 06.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:21:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

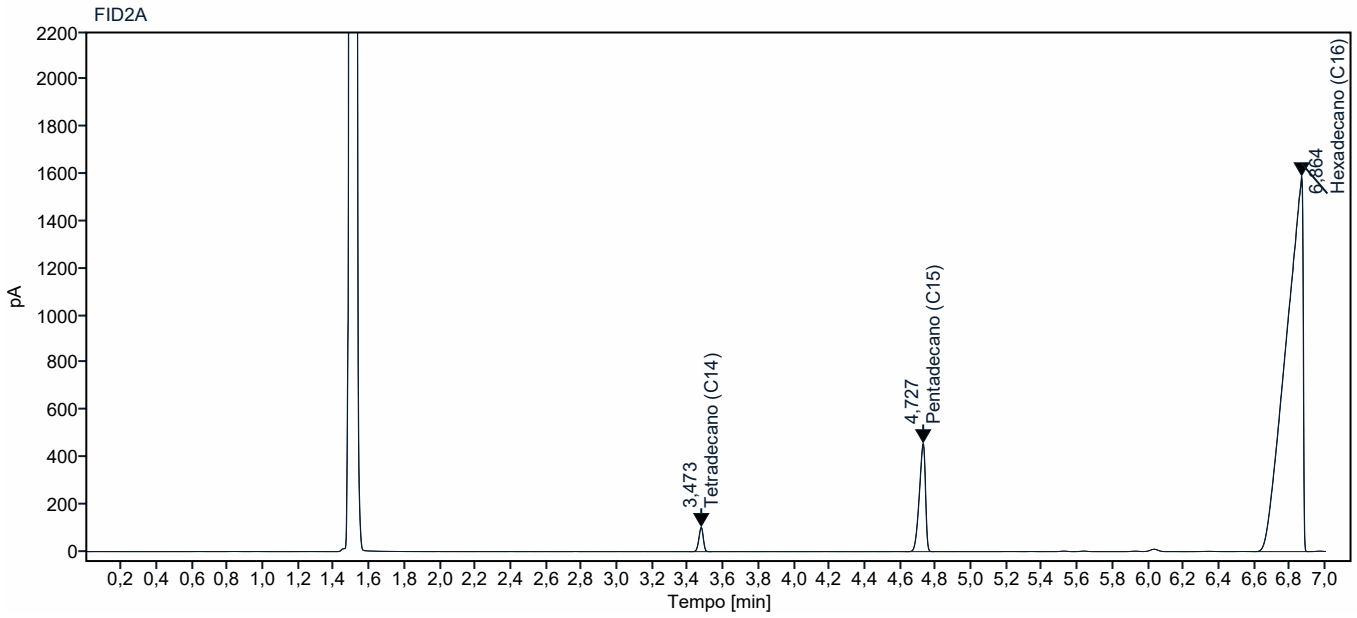

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,473	Tetradecano (C14)	0,1254	177,7340	102,691	1,4918
4,727	Pentadecano (C15)	0,1616	1095,2914	457,935	9,1930
6,864	Hexadecano (C16)	0,3126	10641,4224	1589,006	89,3153
	Soma		**11914,4478**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 03.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	141
Data da injeção:	2025-10-28 14:30:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 14:39:51-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

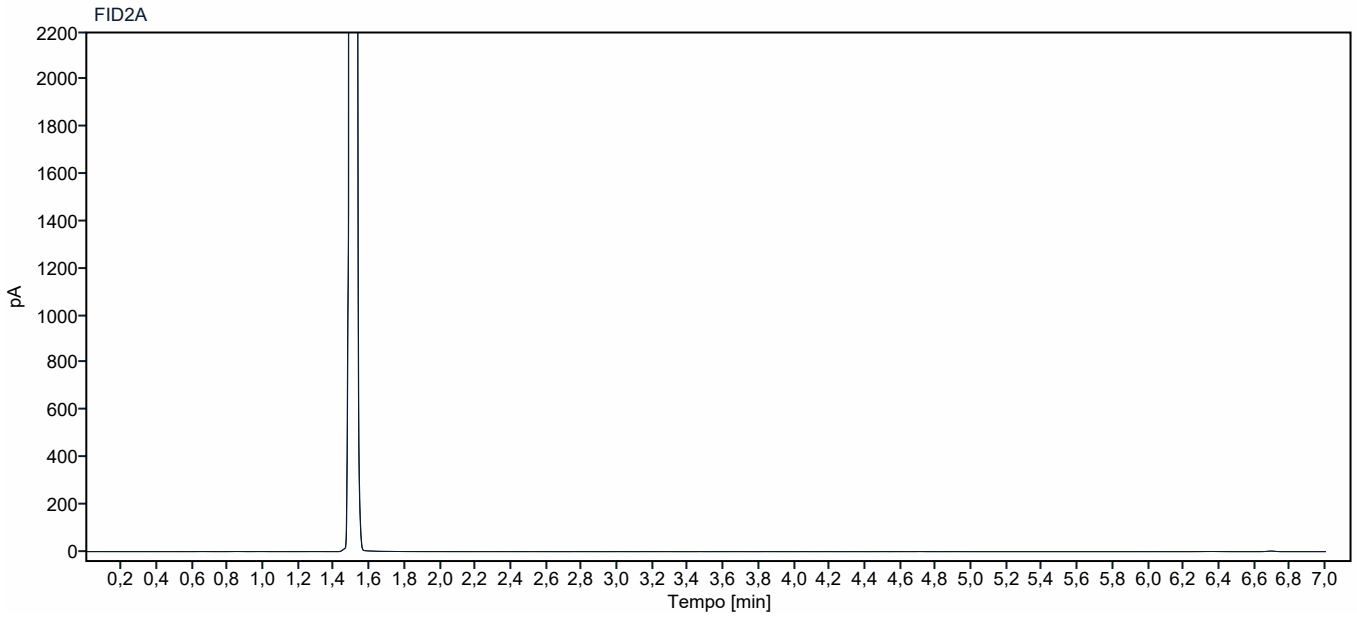


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 01.dx
Nome da amostra: FRONT - LDFI 01
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:39:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 15:05:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

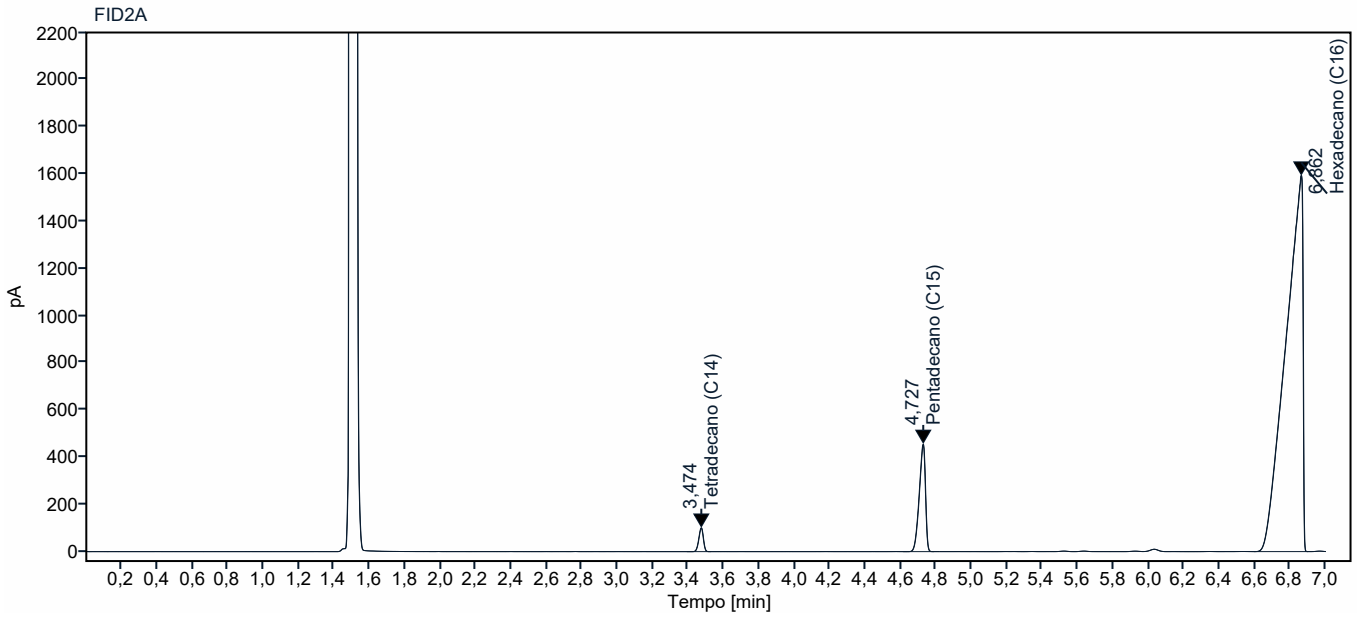

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,474	Tetradecano (C14)	0,1353	179,3229	100,755	1,4892
4,727	Pentadecano (C15)	0,1732	1106,3870	455,829	9,1881
6,862	Hexadecano (C16)	0,3050	10755,8233	1592,844	89,3227
		Soma	**12041,5331**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 02.dx
Nome da amostra:	FRONT - LDFI 02
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:47:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 15:05:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	

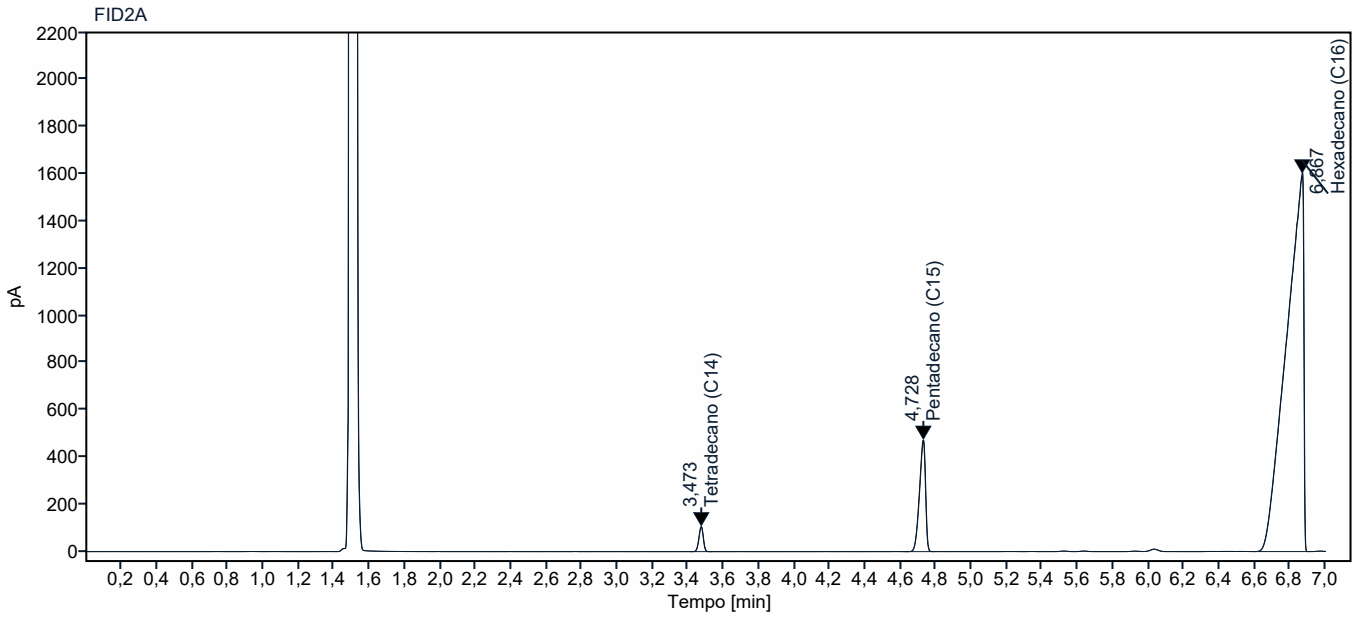

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,473	Tetradecano (C14)	0,1217	182,3492	106,178	1,4908
4,728	Pentadecano (C15)	0,1739	1125,3928	472,706	9,2009
6,867	Hexadecano (C16)	0,3110	10923,5742	1601,335	89,3082
		Soma	**12231,3161**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2025\Results\QPack\CG01\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 03.dx
Nome da amostra: FRONT - LDFI 03
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	142
Data da injeção:	2025-10-28 14:56:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-28 15:05:29-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-1
Série #:

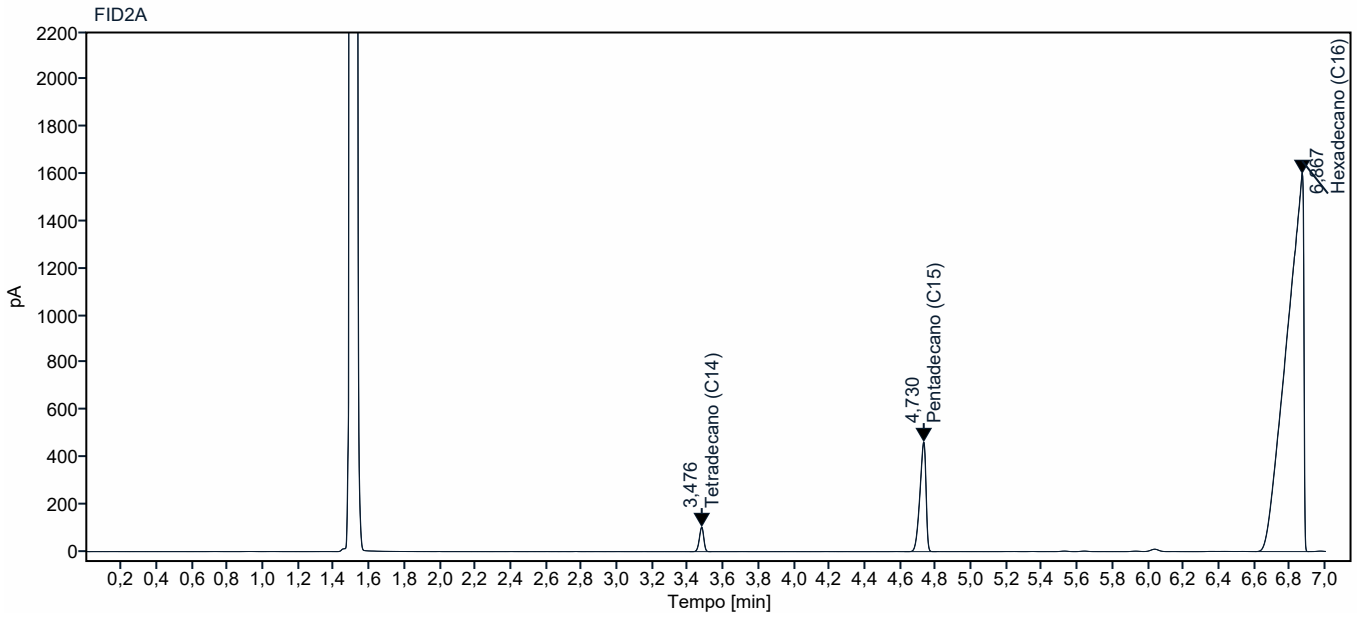

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,476	Tetradecano (C14)	0,1210	179,5144	103,497	1,4909
4,730	Pentadecano (C15)	0,1810	1107,5200	463,645	9,1981
6,867	Hexadecano (C16)	0,3060	10753,6767	1599,706	89,3110
		Soma	**12040,7110**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: RELB FRONT001.dx\RELB FRONT001.dx
Nome da amostra: RELB FRONT001
Descrição:

Instrumento:	CG01	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-28 15:03:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

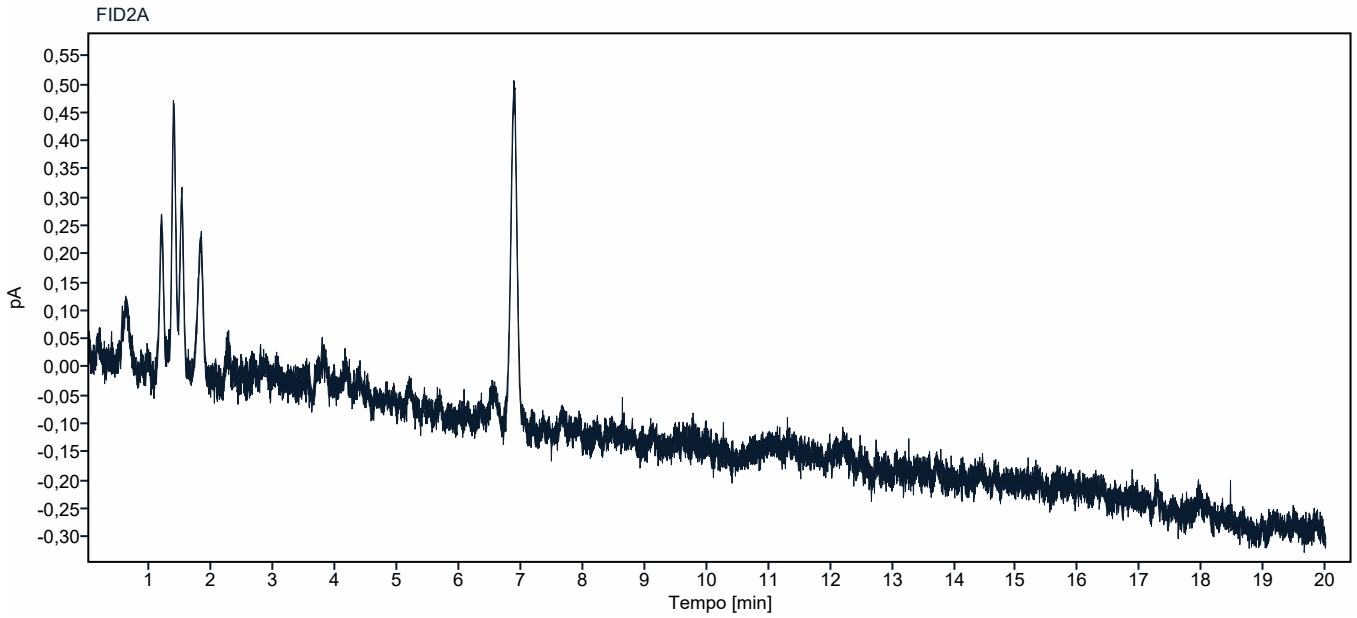

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	RELB FRONT001.dx\RELB FRONT001.dx
Nome da amostra:	RELB FRONT001
Descrição:	

Instrumento:	CG01	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-28 15:03:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

