


ura 001 | GCO3A,Forno Temperatura Real
,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 01.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 10:30:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

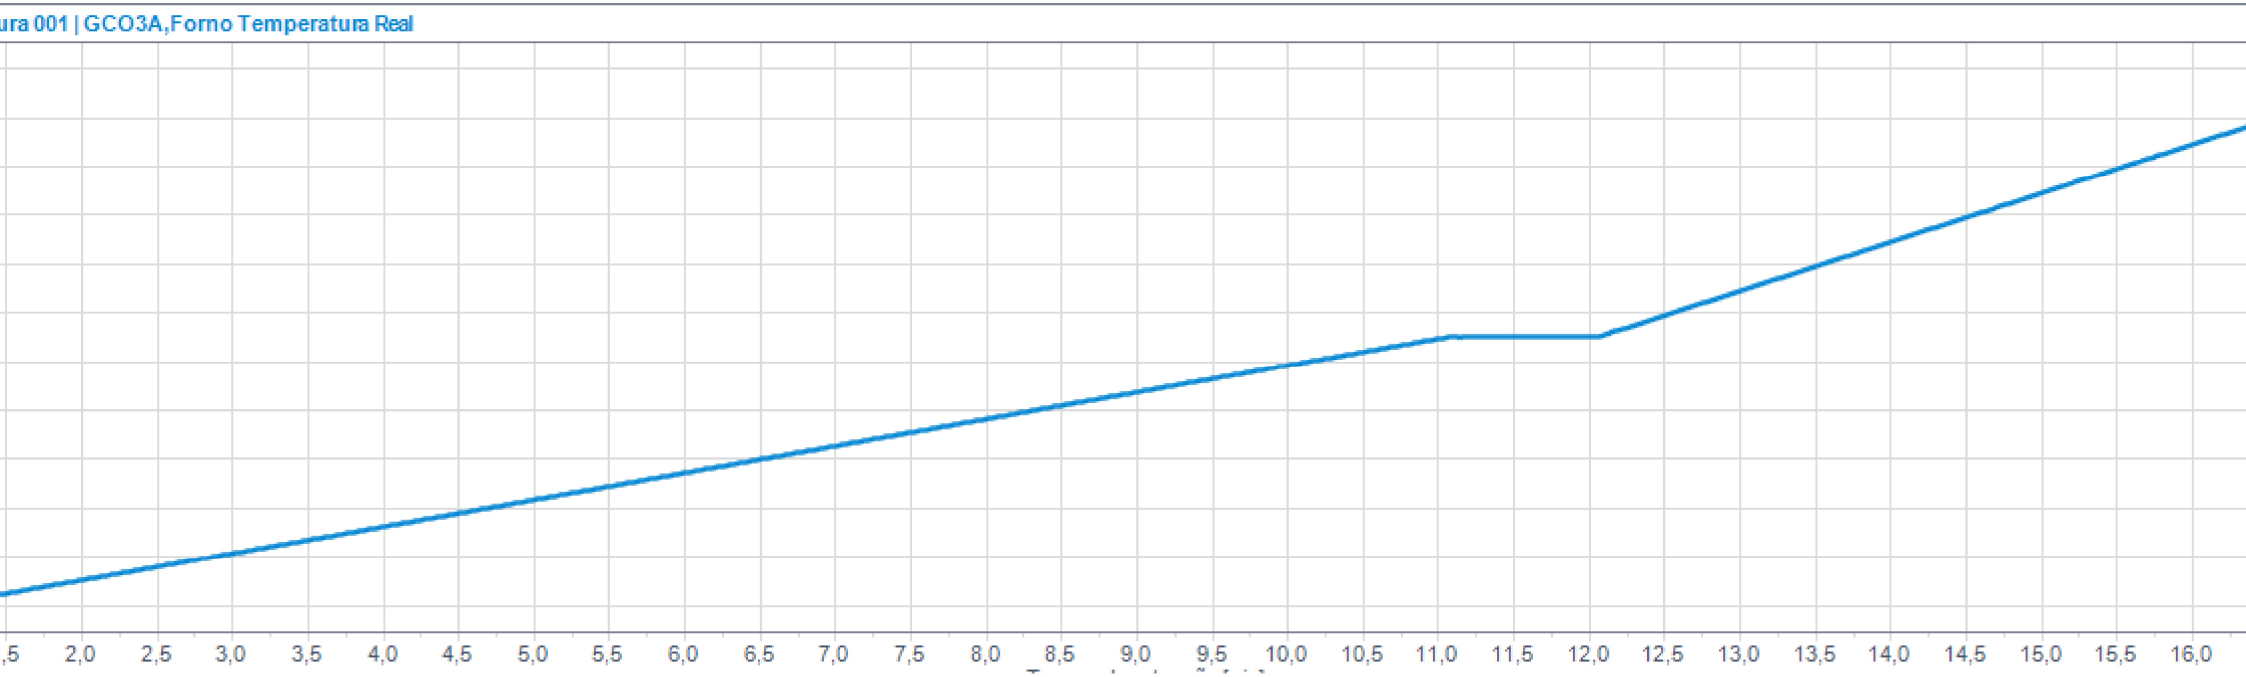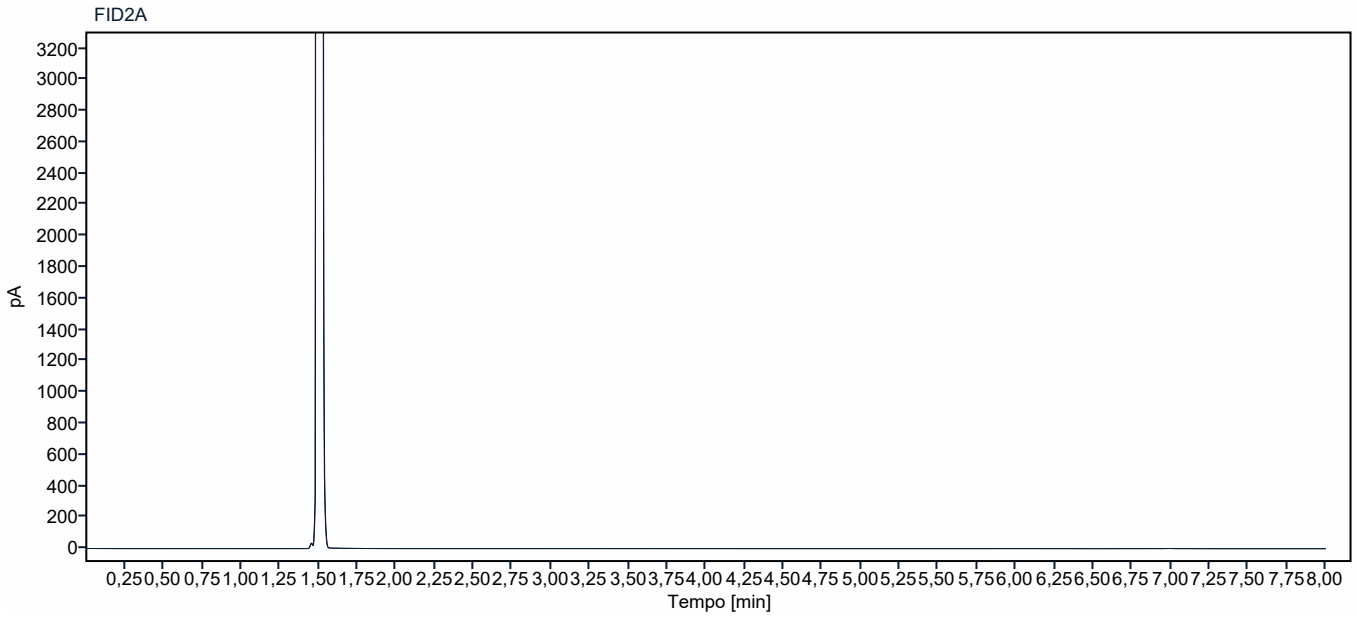


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 01.dx
Nome da amostra:	FRONT - PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 10:39:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

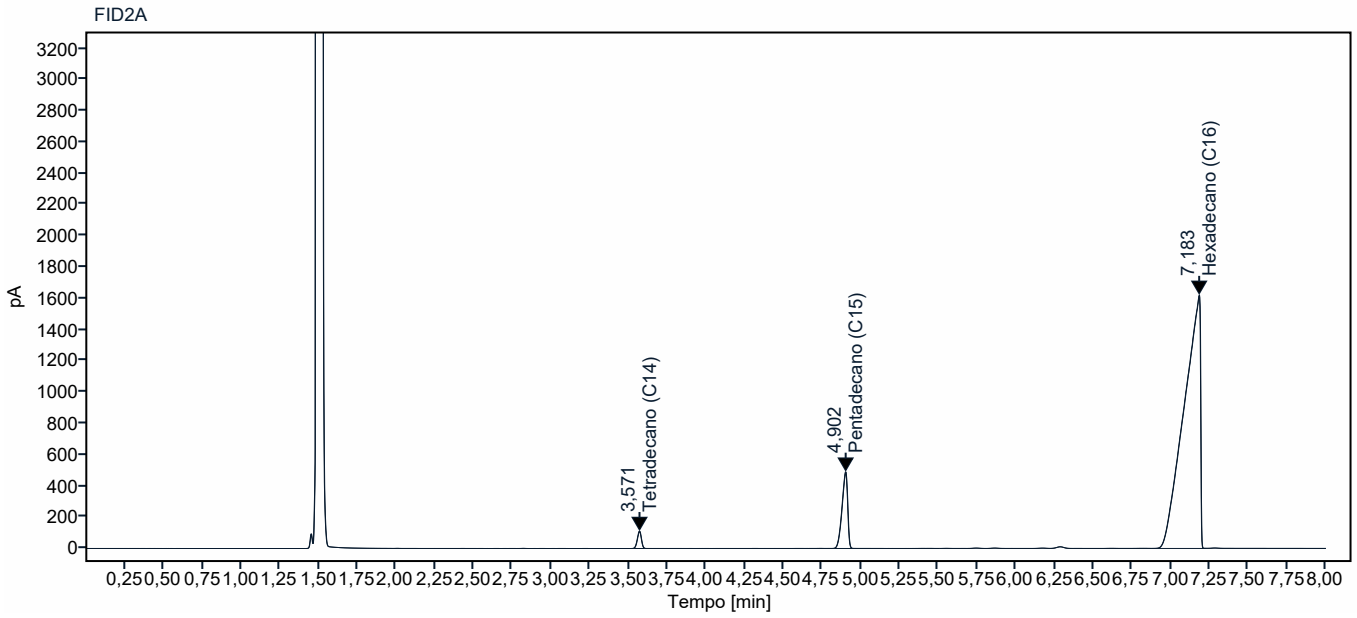

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1507	200,8388	110,970	1,4955
4,902	Pentadecano (C15)	0,2780	1238,6403	490,566	9,2230
7,183	Hexadecano (C16)	0,3462	11990,3698	1621,930	89,2815
		Soma	**13429,8489**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 02.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 10:48:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

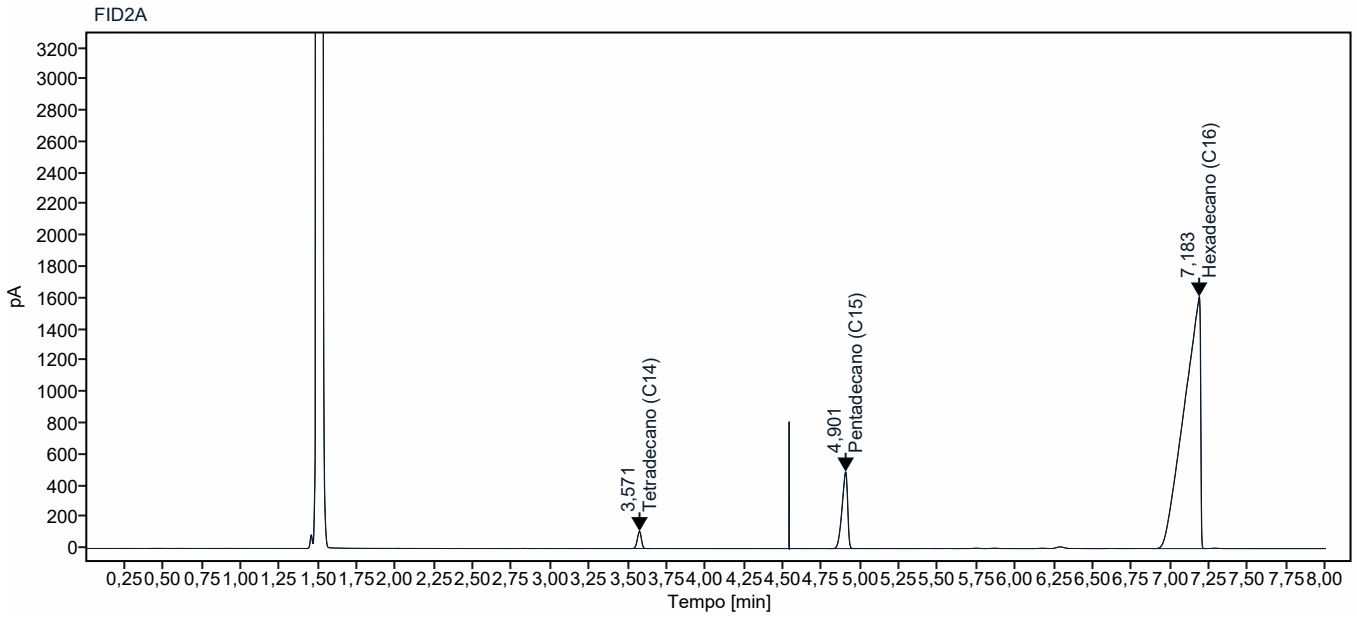

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1603	199,1261	109,551	1,4966
4,901	Pentadecano (C15)	0,1951	1226,9984	490,872	9,2222
7,183	Hexadecano (C16)	0,3460	11878,6846	1611,292	89,2811
		Soma	**13304,8091**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 03.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 10:58:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

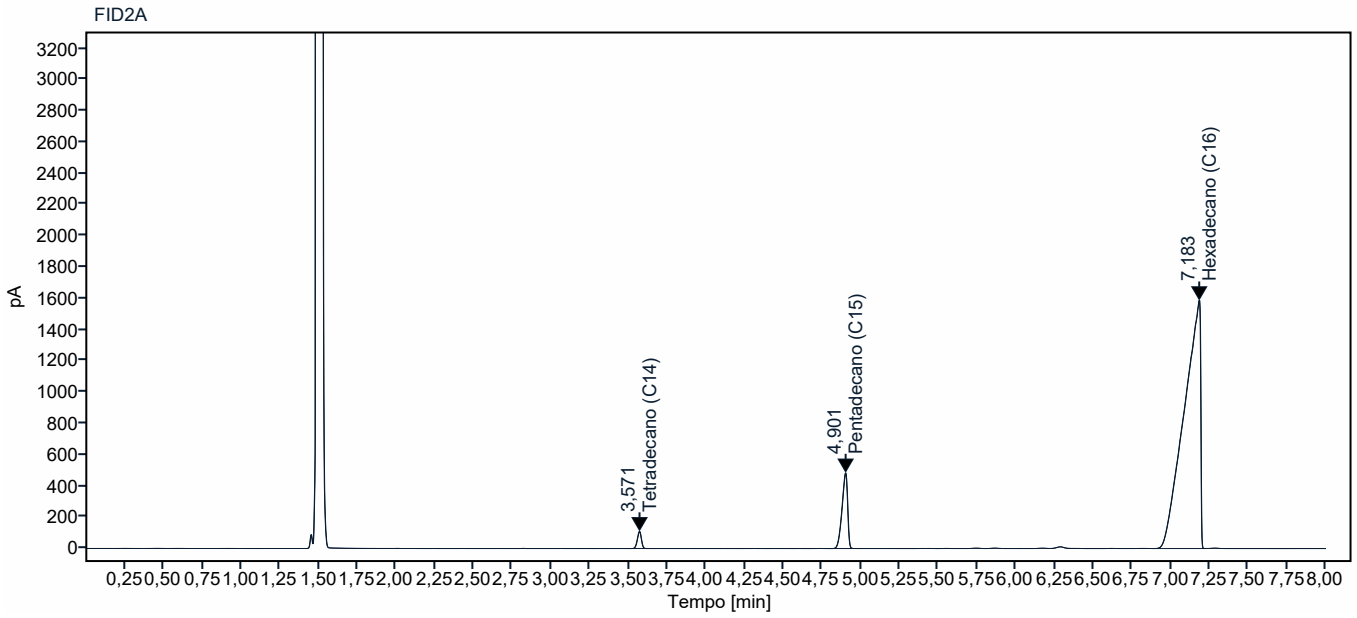

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1833	197,0826	109,310	1,4948
4,901	Pentadecano (C15)	0,2147	1214,7244	483,688	9,2131
7,183	Hexadecano (C16)	0,3415	11772,8960	1586,604	89,2921
		Soma	**13184,7030**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 02.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 11:07:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

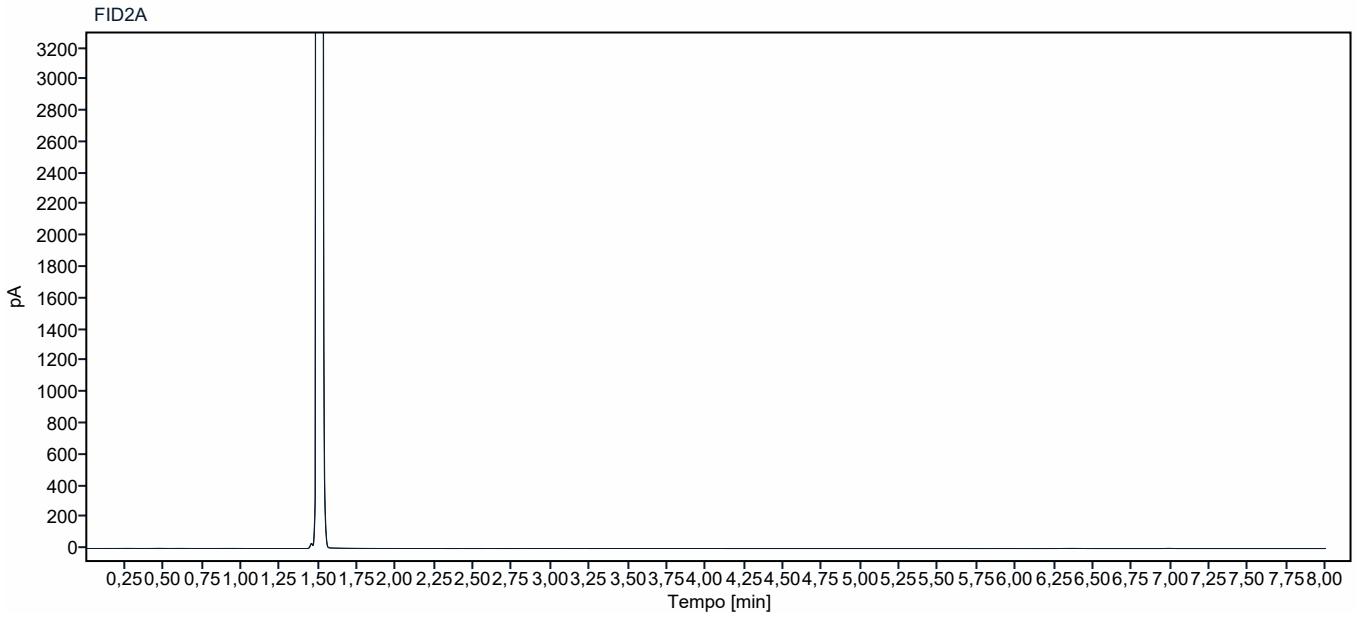


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 04.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 11:17:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

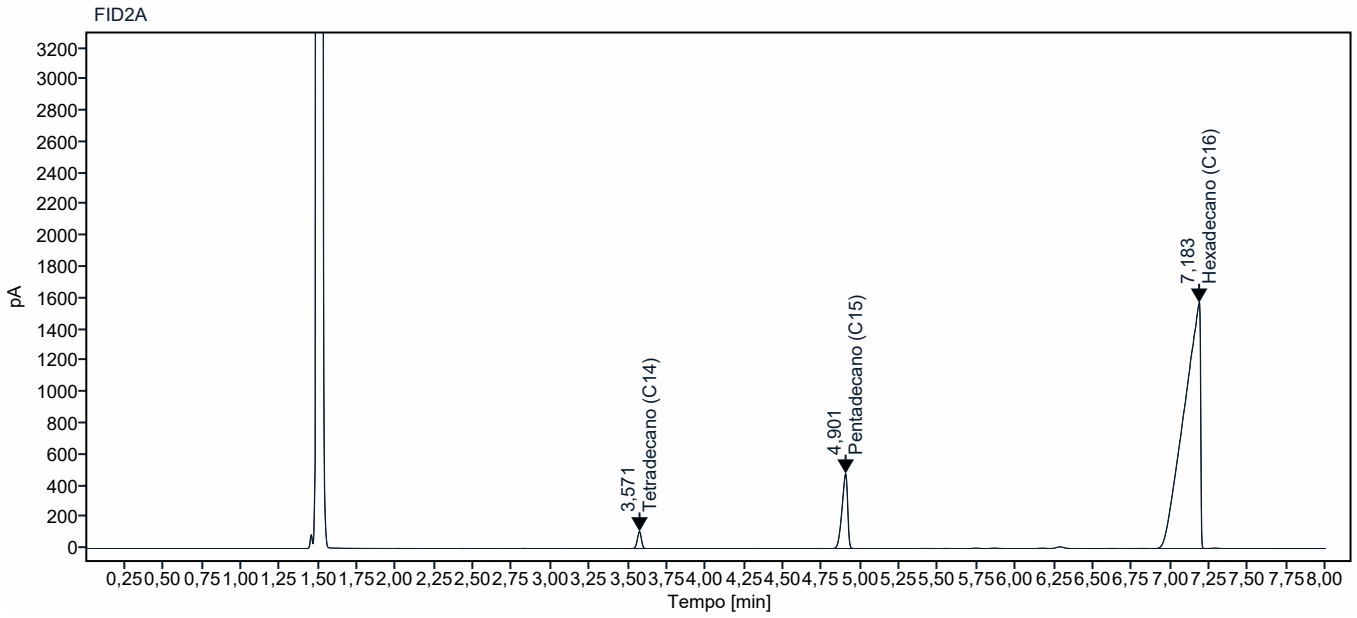

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1472	194,8830	108,592	1,4899
4,901	Pentadecano (C15)	0,1958	1203,0183	478,514	9,1970
7,183	Hexadecano (C16)	0,3423	11682,6788	1572,032	89,3132
		Soma	**13080,5801**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 05.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 11:26:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

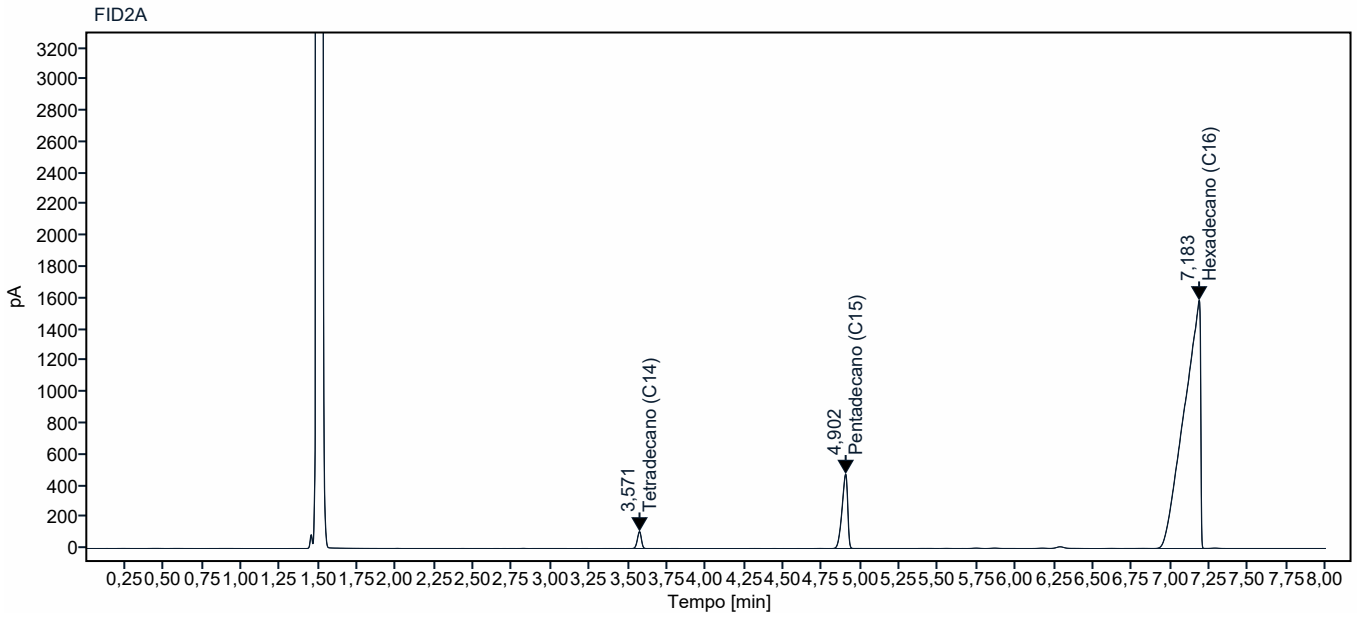

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1732	194,9122	108,353	1,4900
4,902	Pentadecano (C15)	0,2787	1203,3470	475,683	9,1991
7,183	Hexadecano (C16)	0,3417	11682,8342	1586,664	89,3108
		Soma	**13081,0934**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - PCIN 06.dx
Nome da amostra: FRONT - PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 11:36:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

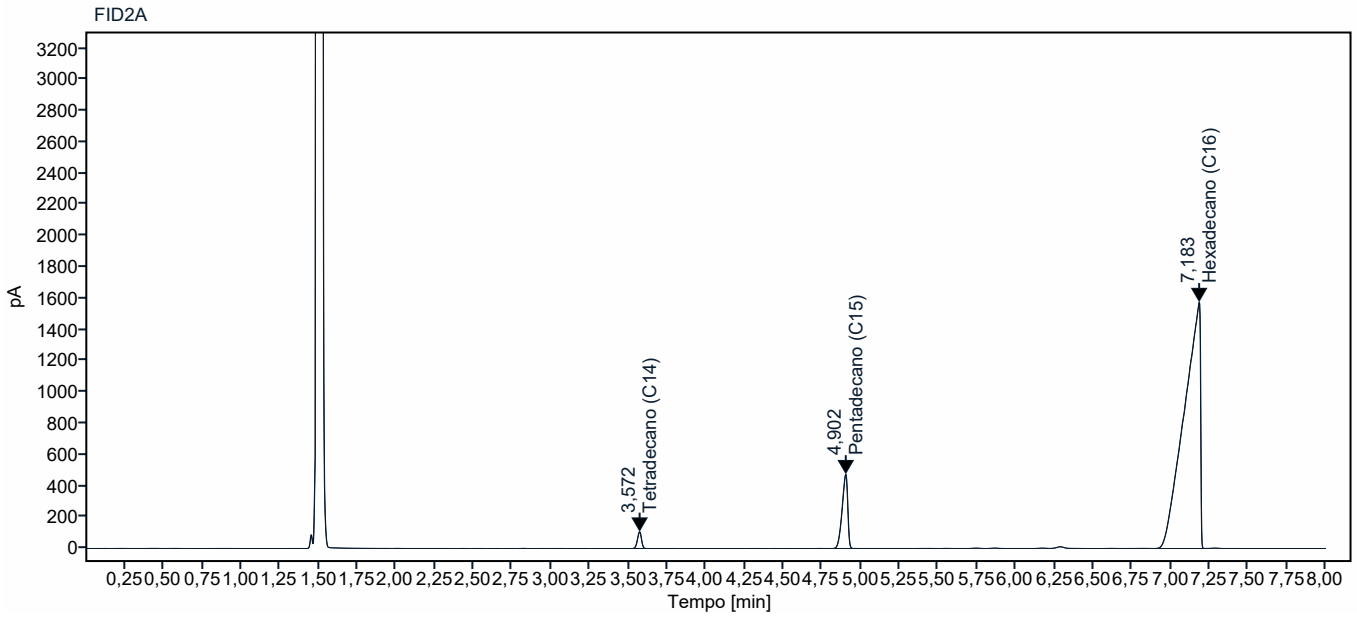

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,572	Tetradecano (C14)	0,1410	192,7746	107,080	1,4887
4,902	Pentadecano (C15)	0,1861	1190,4331	474,697	9,1928
7,183	Hexadecano (C16)	0,3417	11566,3636	1576,066	89,3185
		Soma	**12949,5713**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN FRONT 001.rslt\FRONT - Branco PCIN 03.dx
Nome da amostra:	FRONT - Branco PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 11:45:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

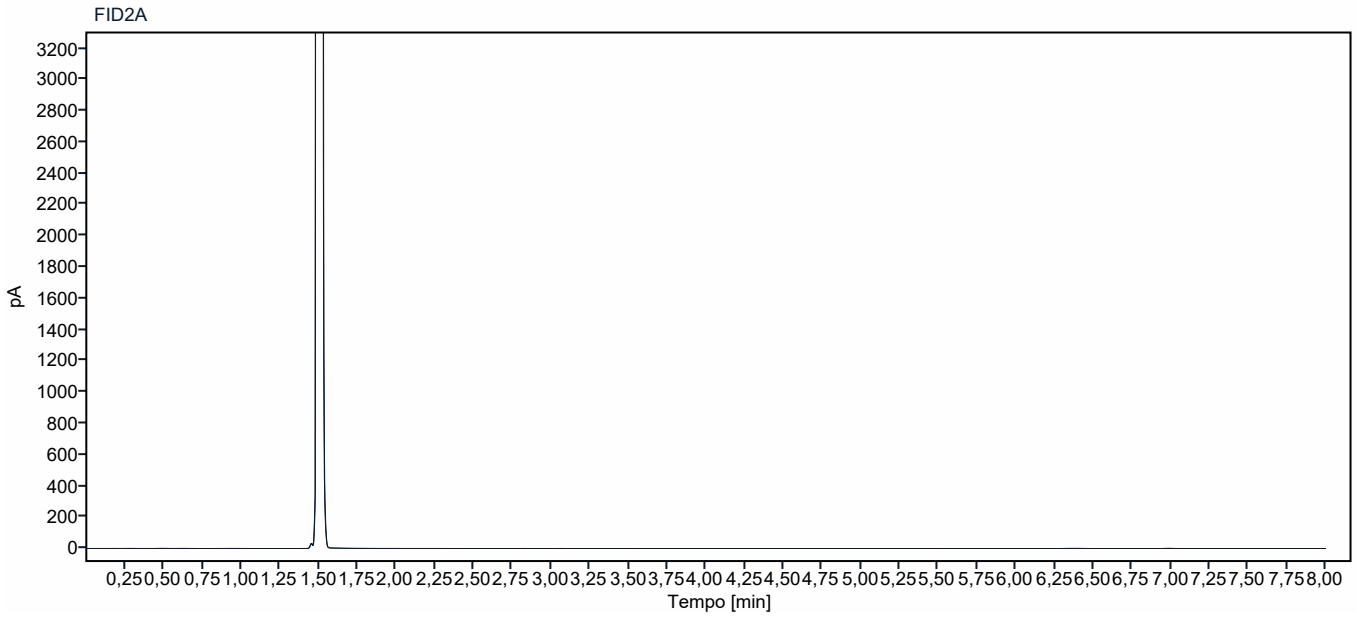


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 01.dx
Nome da amostra: FRONT - LDFI 01
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 11:55:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

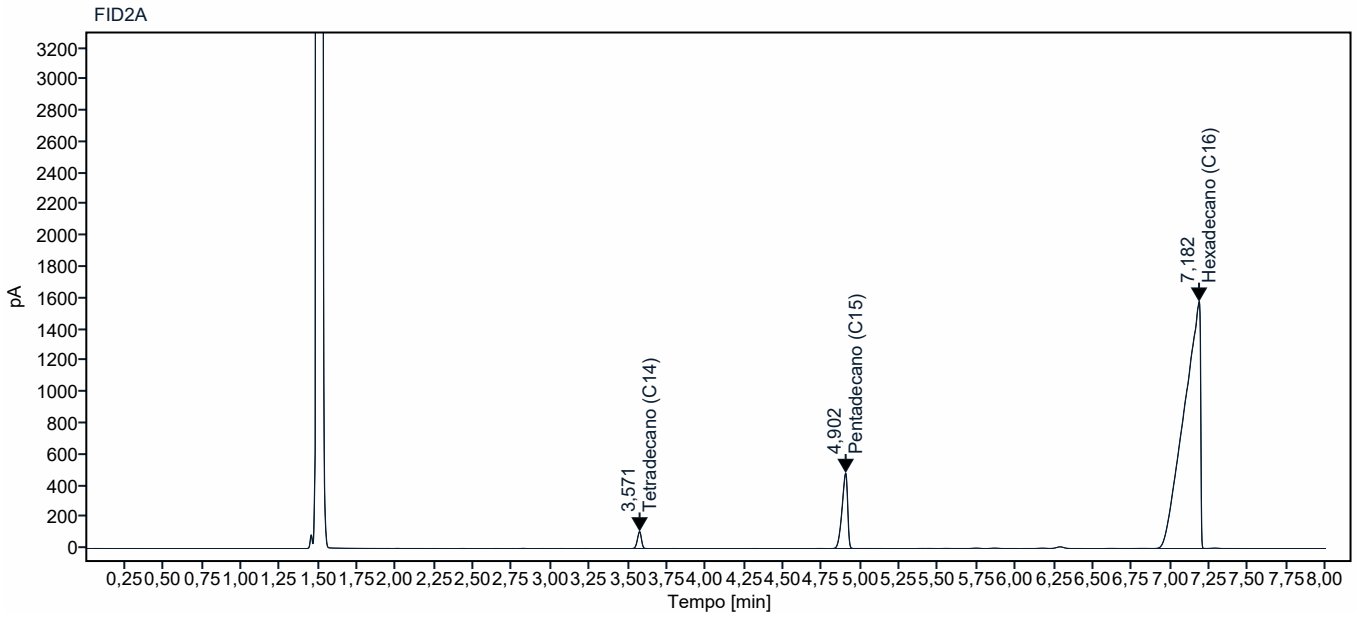

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1338	194,9796	108,234	1,4878
4,902	Pentadecano (C15)	0,2966	1205,1045	482,033	9,1956
7,182	Hexadecano (C16)	0,3430	11705,1768	1578,581	89,3166
		Soma	**13105,2608**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 02.dx
Nome da amostra: FRONT - LDFI 02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 12:04:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

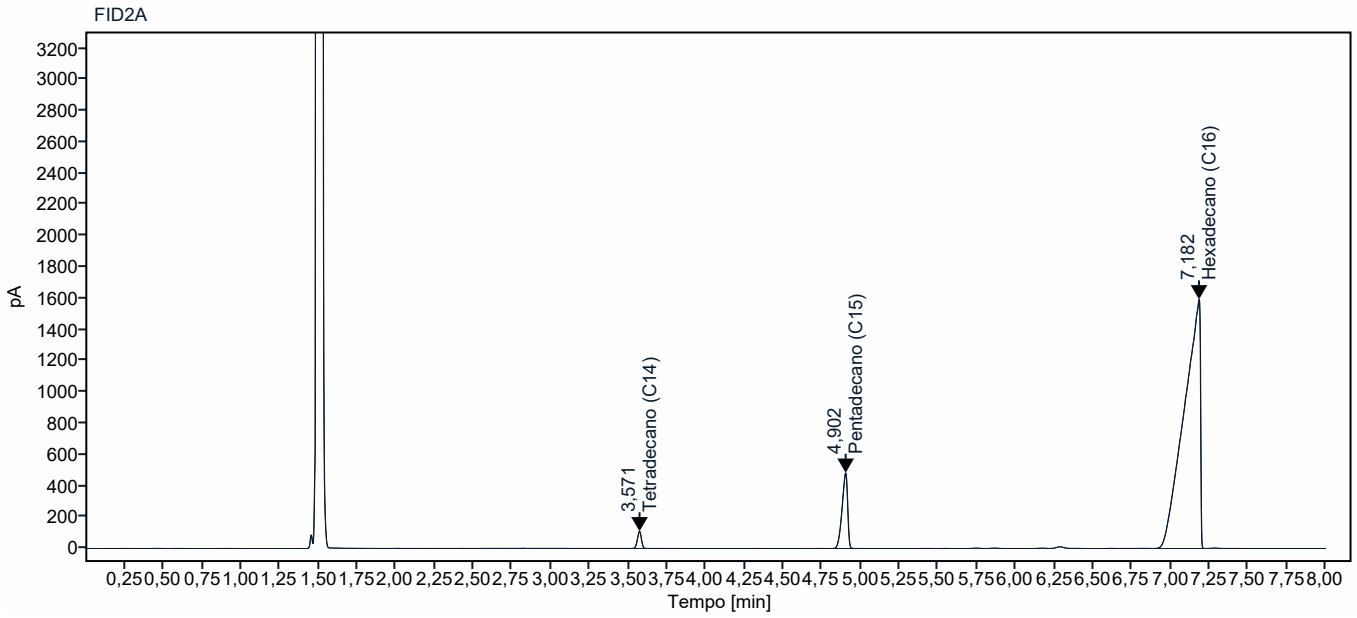

Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,571	Tetradecano (C14)	0,1796	195,1421	109,275	1,4901
4,902	Pentadecano (C15)	0,2053	1204,1559	483,863	9,1947
7,182	Hexadecano (C16)	0,3438	11696,9361	1593,606	89,3153
		Soma	**13096,2341**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI FRONT 001.rslt\FRONT - LDFI 03.dx
Nome da amostra: FRONT - LDFI 03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 12:14:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:26:48-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

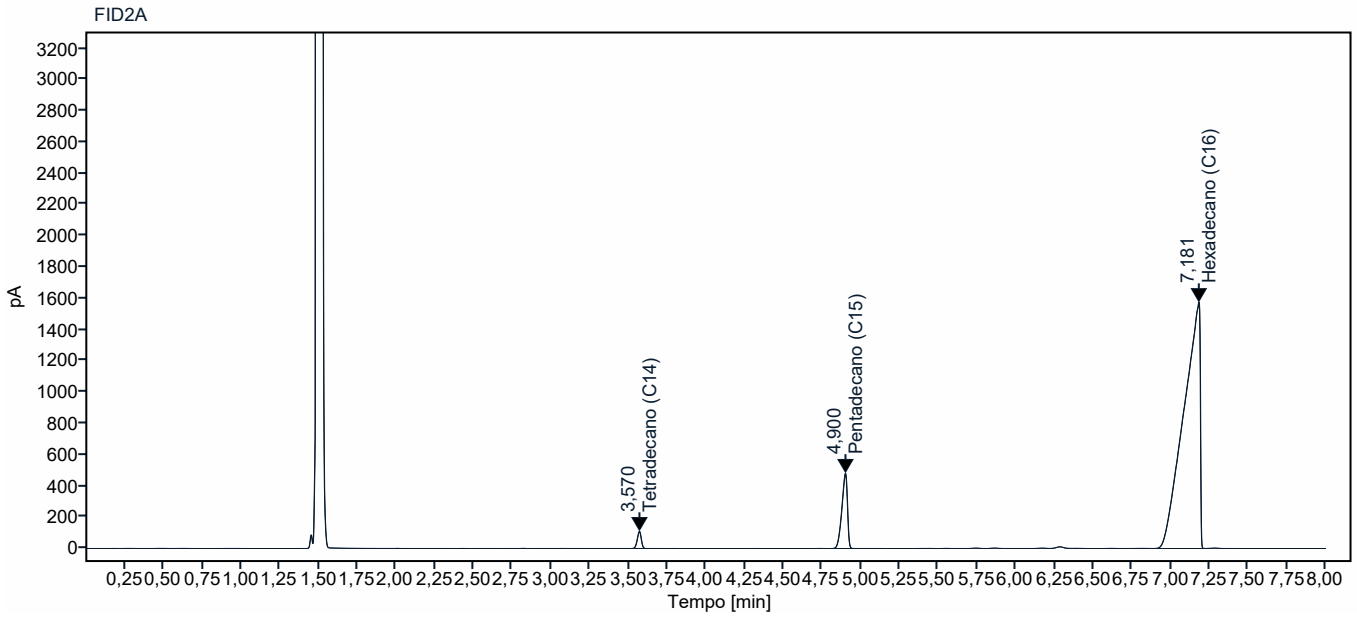

Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,570	Tetradecano (C14)	0,2008	195,0378	109,246	1,4917
4,900	Pentadecano (C15)	0,1911	1202,3750	480,993	9,1960
7,181	Hexadecano (C16)	0,3448	11677,5466	1574,167	89,3123
		Soma	**13074,9594**		


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	RELB FRONT 001.dx\RELB FRONT 001.dx
Nome da amostra:	RELB FRONT 001
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-30 12:22:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB FRONT.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

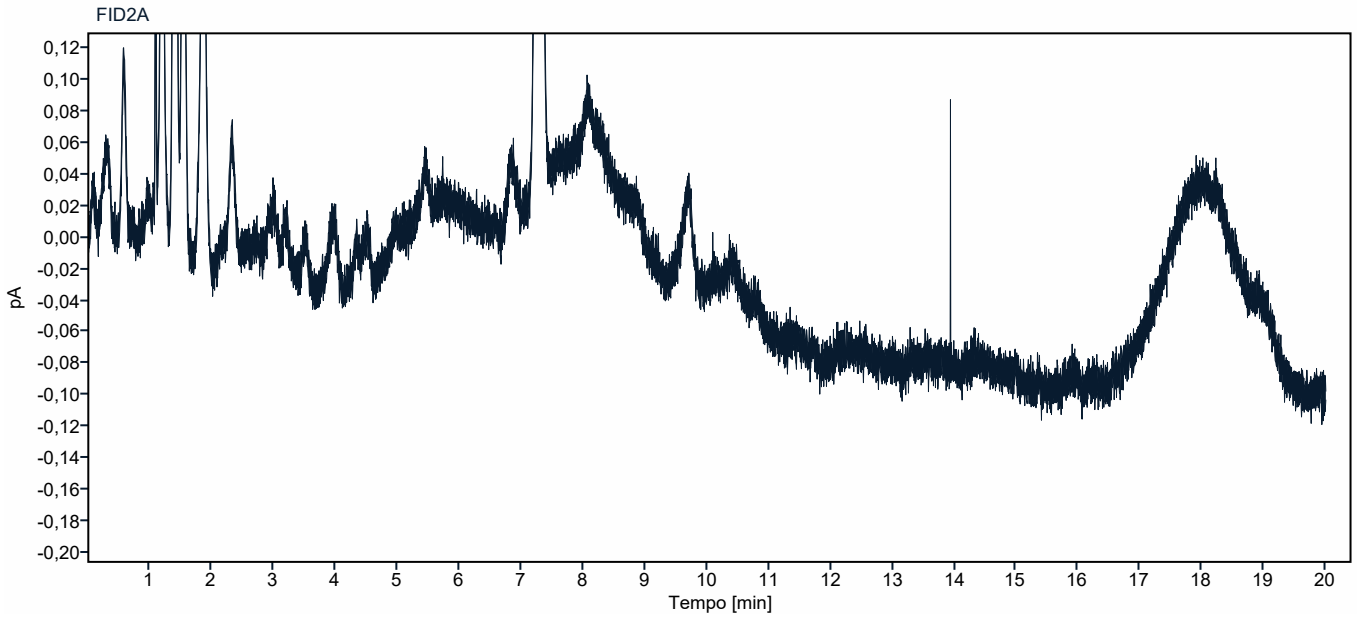


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	RELB FRONT 001.dx\RELB FRONT 001.dx
Nome da amostra:	RELB FRONT 001
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-30 12:22:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB FRONT.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	

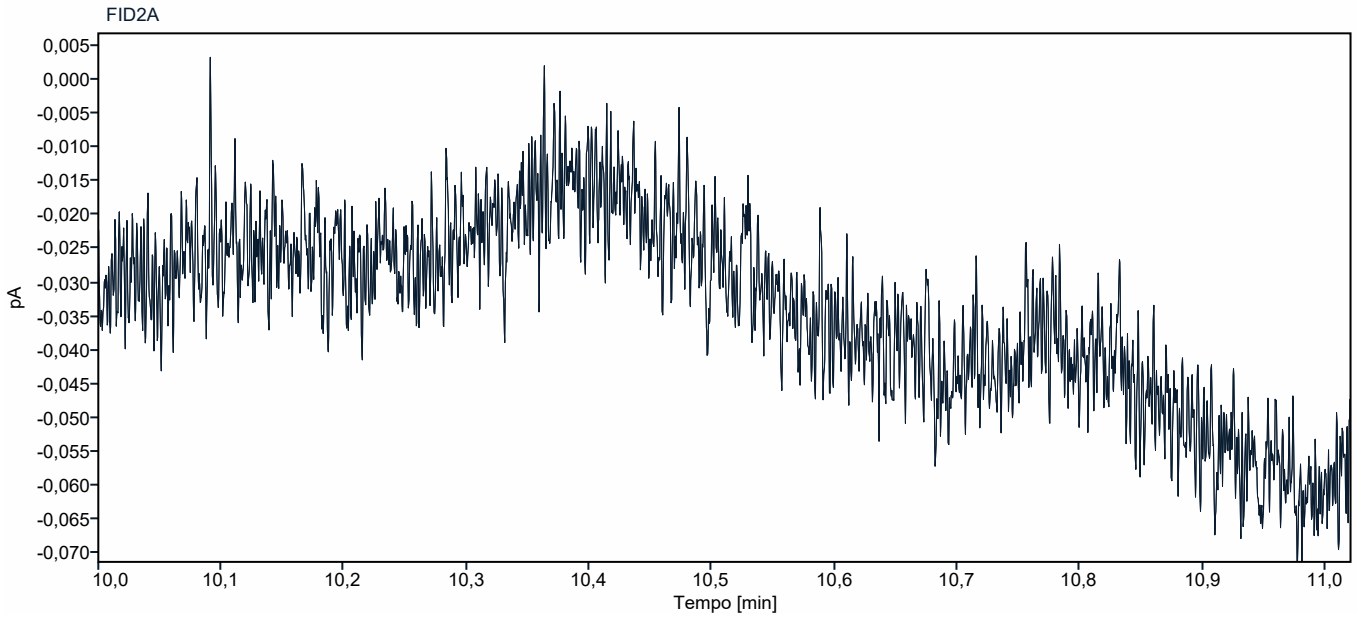

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - Branco PCIN 01.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 14:33:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	




Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 01.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 14:43:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

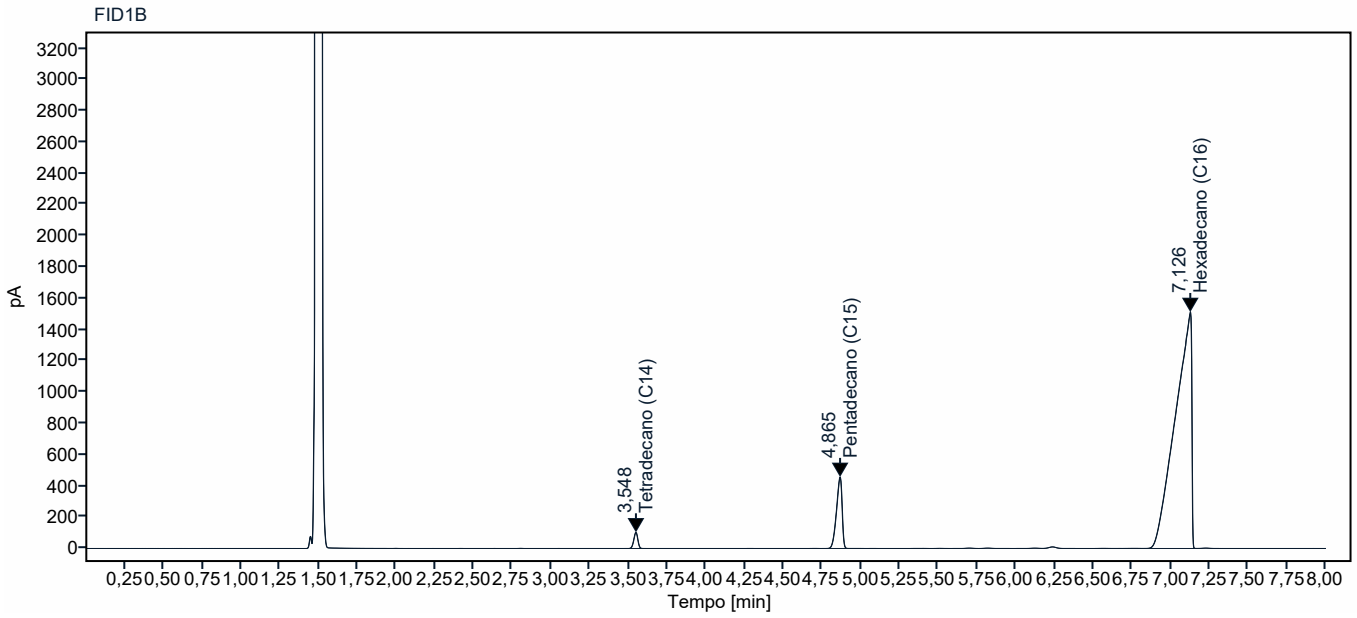

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1387	185,8157	102,716	1,4896
4,865	Pentadecano (C15)	0,2544	1147,9069	457,171	9,2022
7,126	Hexadecano (C16)	0,3371	11140,4789	1512,634	89,3082
		Soma	**12474,2014**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 02.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 14:52:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

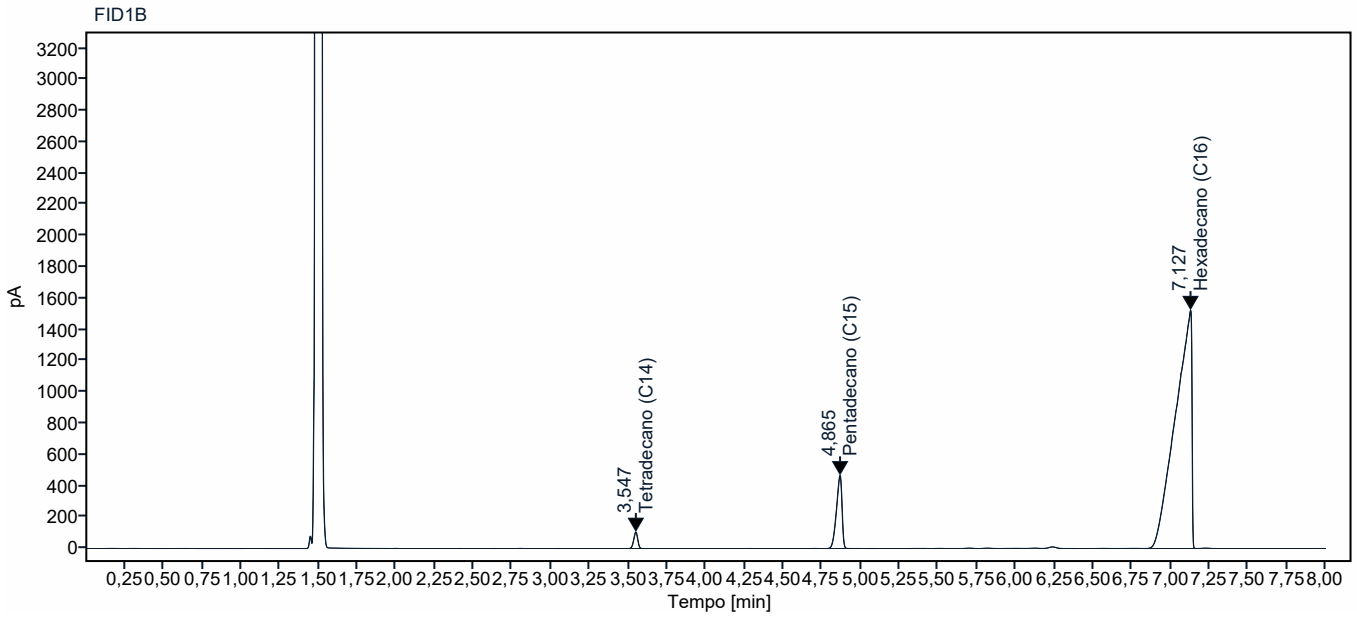

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,547	Tetradecano (C14)	0,1315	187,8636	105,175	1,4913
4,865	Pentadecano (C15)	0,1827	1159,0350	467,296	9,2006
7,127	Hexadecano (C16)	0,3380	11250,4686	1524,792	89,3081
		Soma	**12597,3671**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 03.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 15:02:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

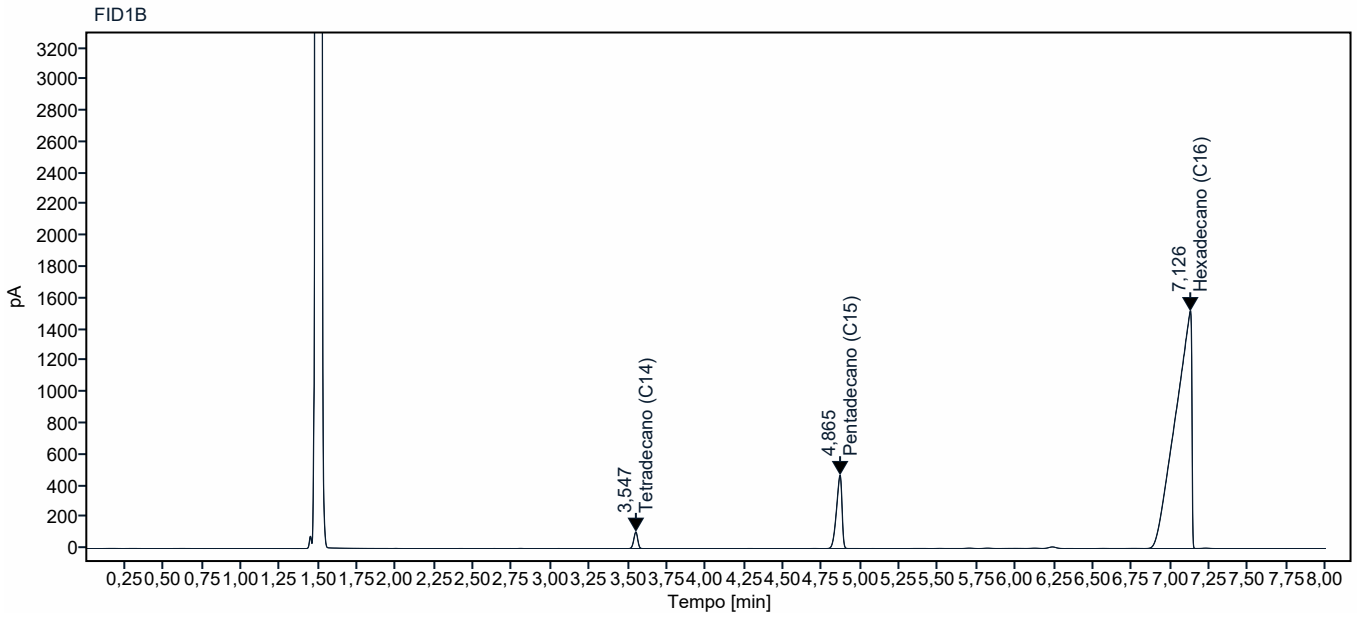

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,547	Tetradecano (C14)	0,1337	186,5744	105,417	1,4916
4,865	Pentadecano (C15)	0,2708	1152,1643	468,215	9,2113
7,126	Hexadecano (C16)	0,3371	11169,4314	1517,278	89,2971
		Soma	**12508,1702**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - Branco PCIN 02.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 02
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 15:11:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

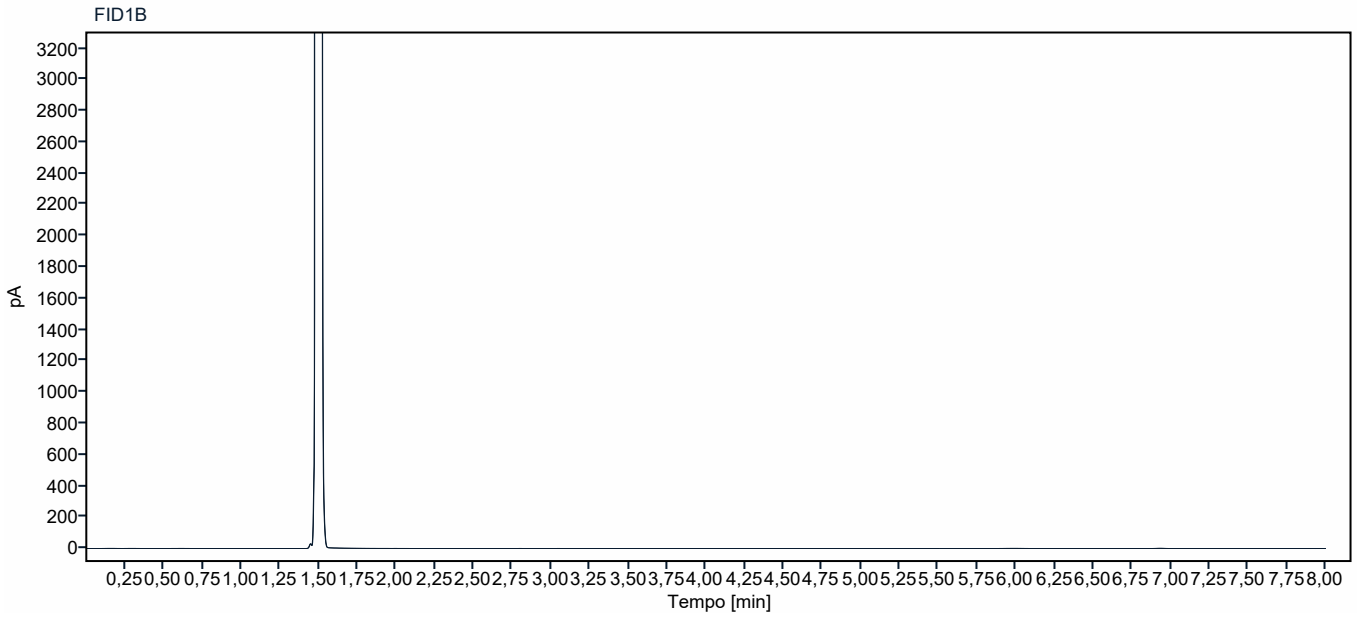


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 04.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 15:21:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

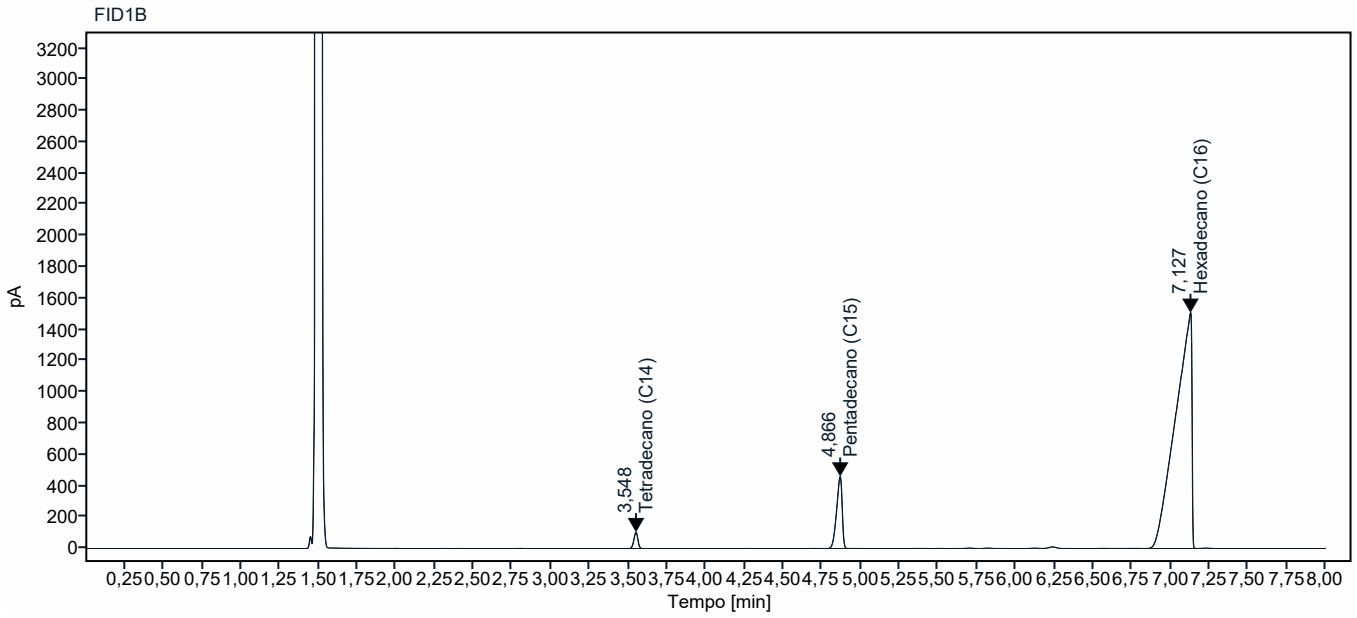


Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1674	185,1457	103,621	1,4921
4,866	Pentadecano (C15)	0,2871	1142,7775	459,886	9,2096
7,127	Hexadecano (C16)	0,3386	11080,6705	1507,369	89,2984
		Soma	**12408,5937**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 05.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 15:31:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	DB-5ms		
Série #:			

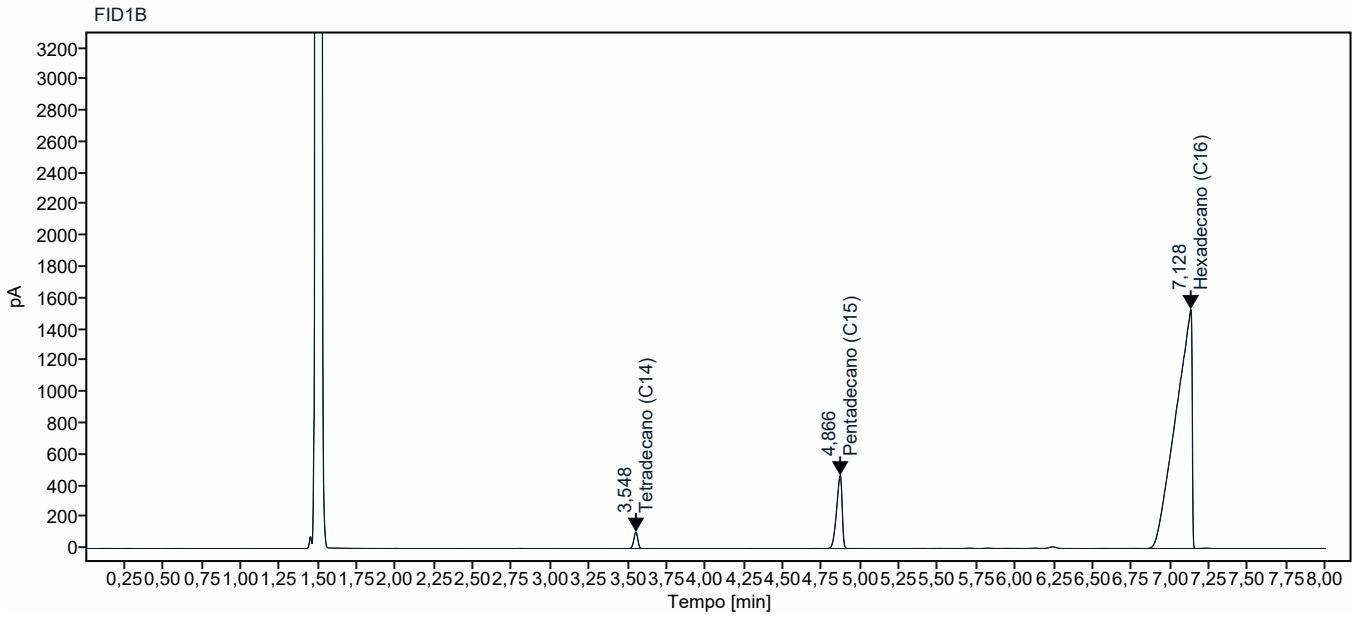

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1657	187,3756	105,245	1,4908
4,866	Pentadecano (C15)	0,2921	1157,0232	466,663	9,2057
7,128	Hexadecano (C16)	0,3389	11224,1661	1529,931	89,3035
		Soma	**12568,5648**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - PCIN 06.dx
Nome da amostra: BACK - PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 15:41:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

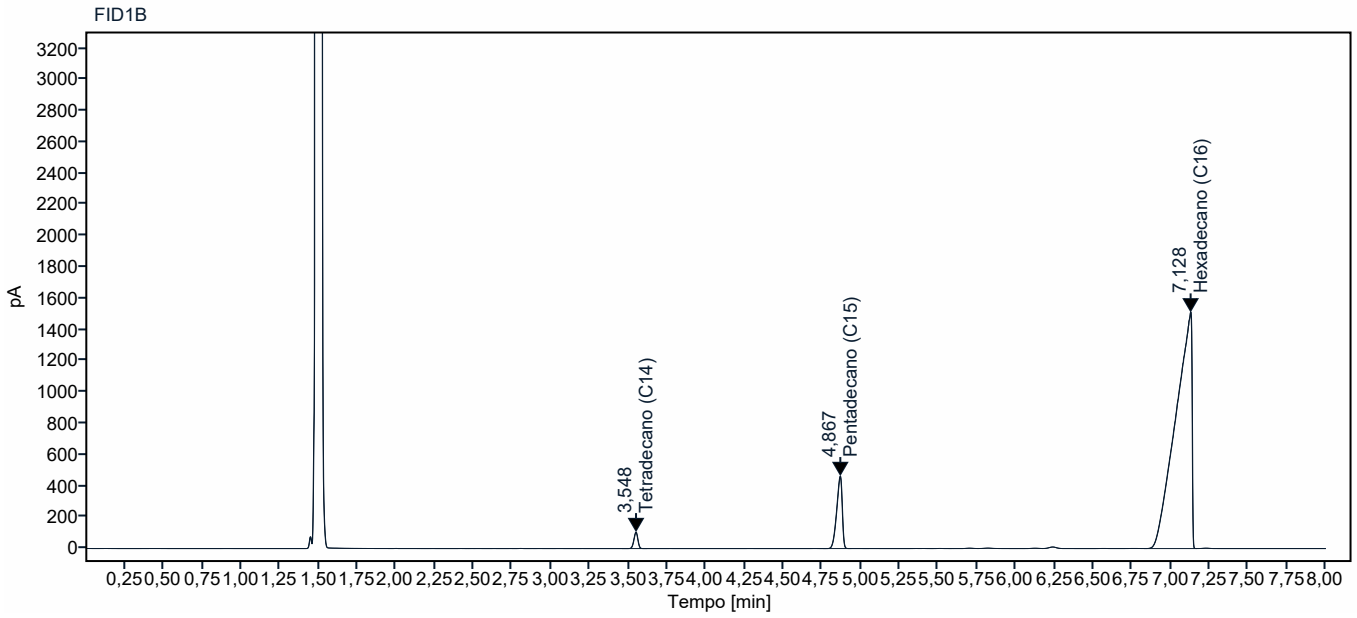

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1617	185,4430	104,464	1,4921
4,867	Pentadecano (C15)	0,1816	1142,9609	463,153	9,1967
7,128	Hexadecano (C16)	0,3416	11099,5264	1510,501	89,3111
		Soma	**12427,9303**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\PCIN BACK 002.rslt\BACK - Branco PCIN 03.dx
Nome da amostra:	BACK - Branco PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	51
Data da injeção:	2025-10-30 15:50:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:32:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	

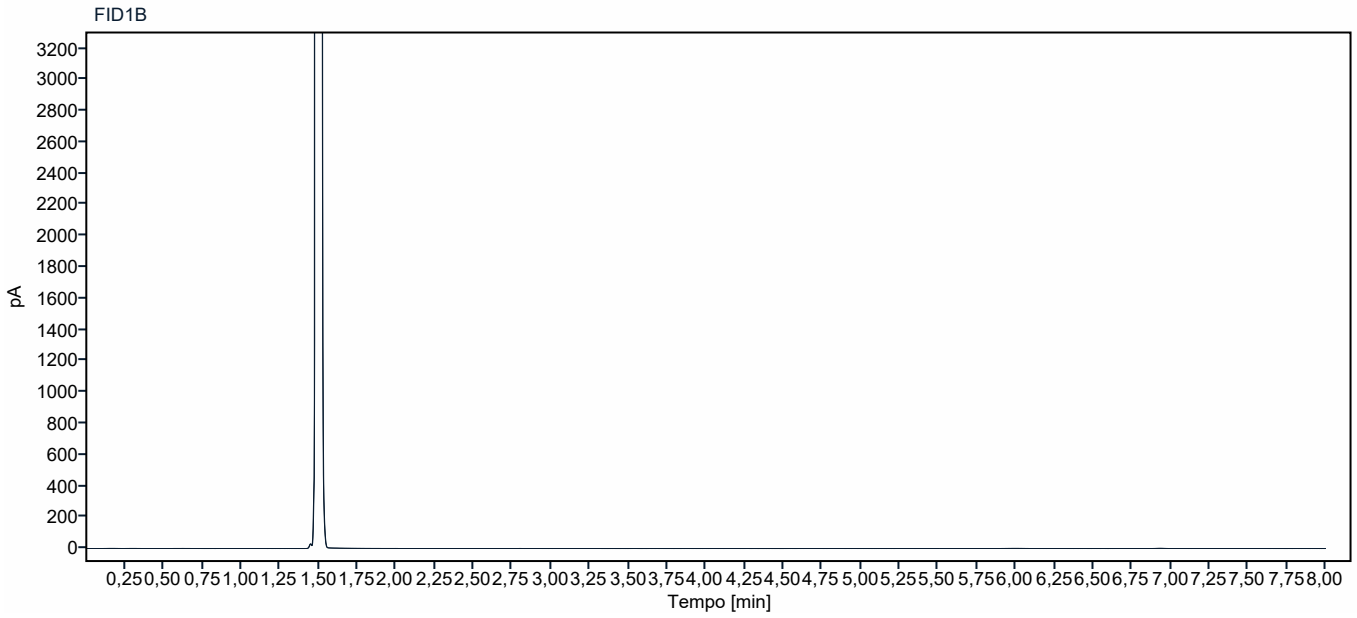


Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI BACK 001.rslt\BACK - LDFI 01.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 01
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 16:00:35-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:30:20-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

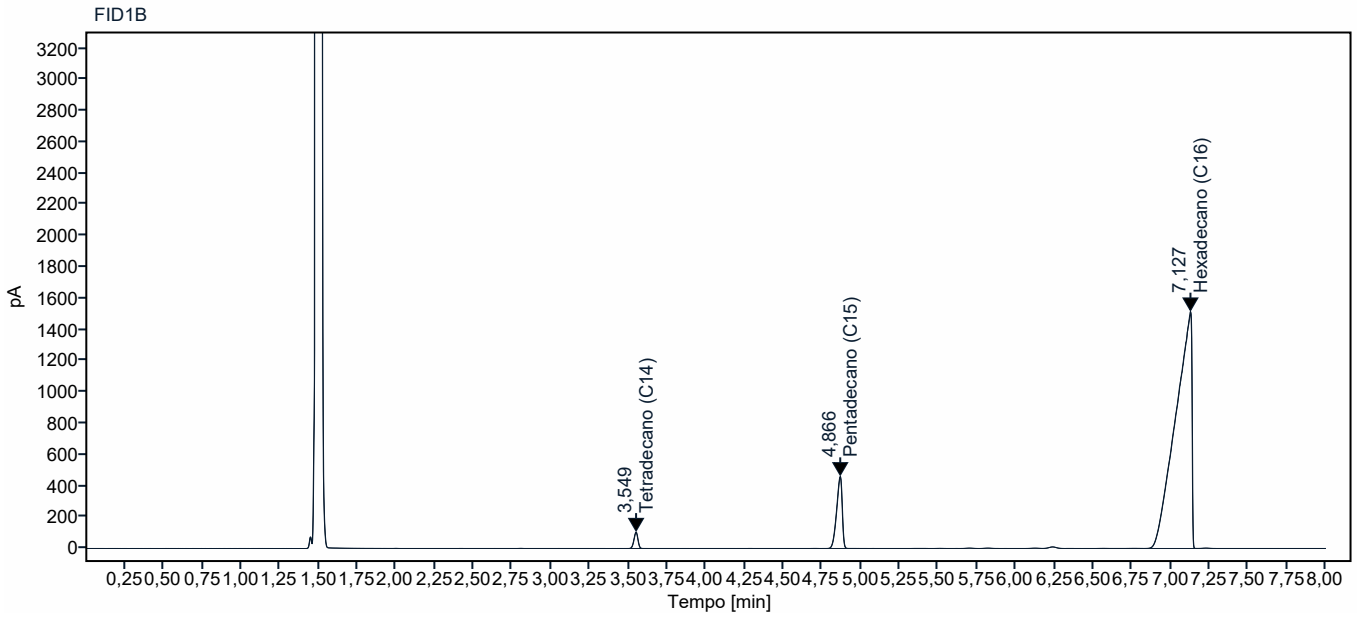

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,549	Tetradecano (C14)	0,1273	185,6850	104,000	1,4903
4,866	Pentadecano (C15)	0,2877	1147,2399	460,777	9,2077
7,127	Hexadecano (C16)	0,3391	11126,5968	1514,547	89,3020
		Soma	**12459,5217**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI BACK 001.rslt\BACK - LDFI 02.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 02
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 16:10:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:30:20-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

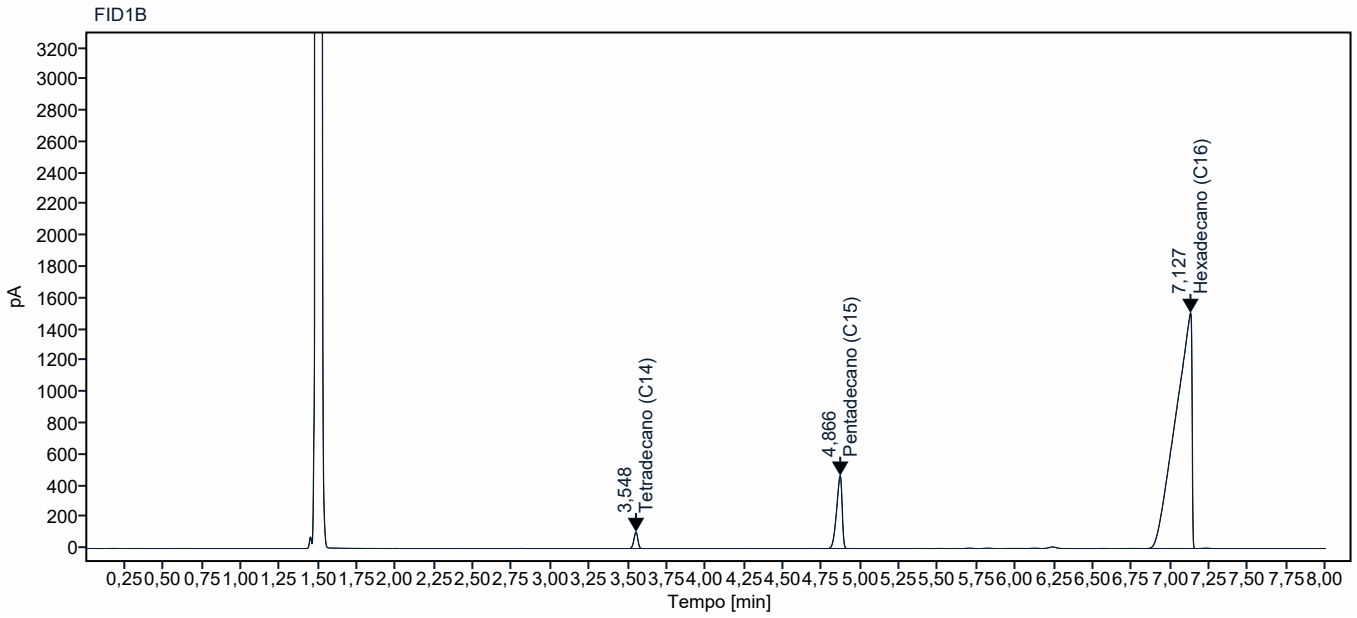

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1147	185,5131	104,865	1,4923
4,866	Pentadecano (C15)	0,1883	1144,2815	464,918	9,2047
7,127	Hexadecano (C16)	0,3375	11101,7346	1506,633	89,3030
		Soma	**12431,5291**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\2025\QPack\LDFI BACK 001.rslt\BACK - LDFI 03.dx
Nome da amostra: BACK - LDFI 03
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	52
Data da injeção:	2025-10-30 16:19:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPack - Integração.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 16:30:20-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:

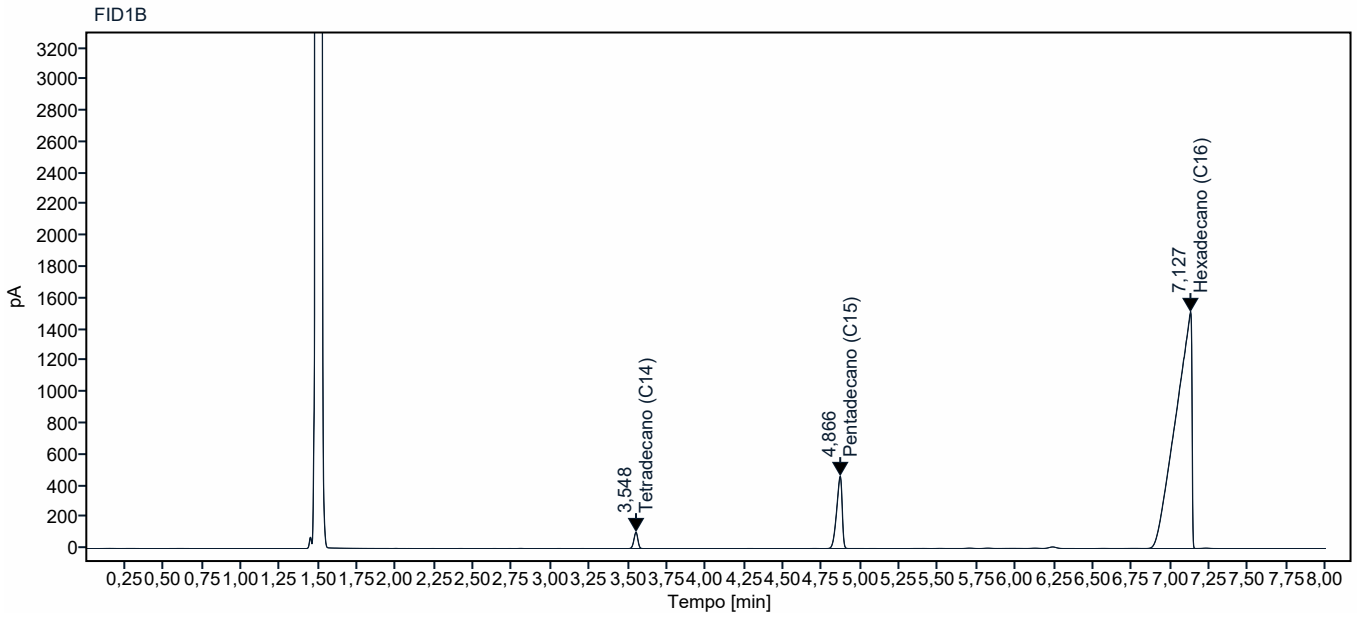

Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,548	Tetradecano (C14)	0,1821	183,7985	103,723	1,4909
4,866	Pentadecano (C15)	0,1897	1134,3213	462,426	9,2010
7,127	Hexadecano (C16)	0,3381	11010,1821	1512,079	89,3082
		Soma	**12328,3019**		

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: RELB BACK 001.dx\RELB BACK 001.dx
Nome da amostra: RELB BACK 001
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-30 16:28:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

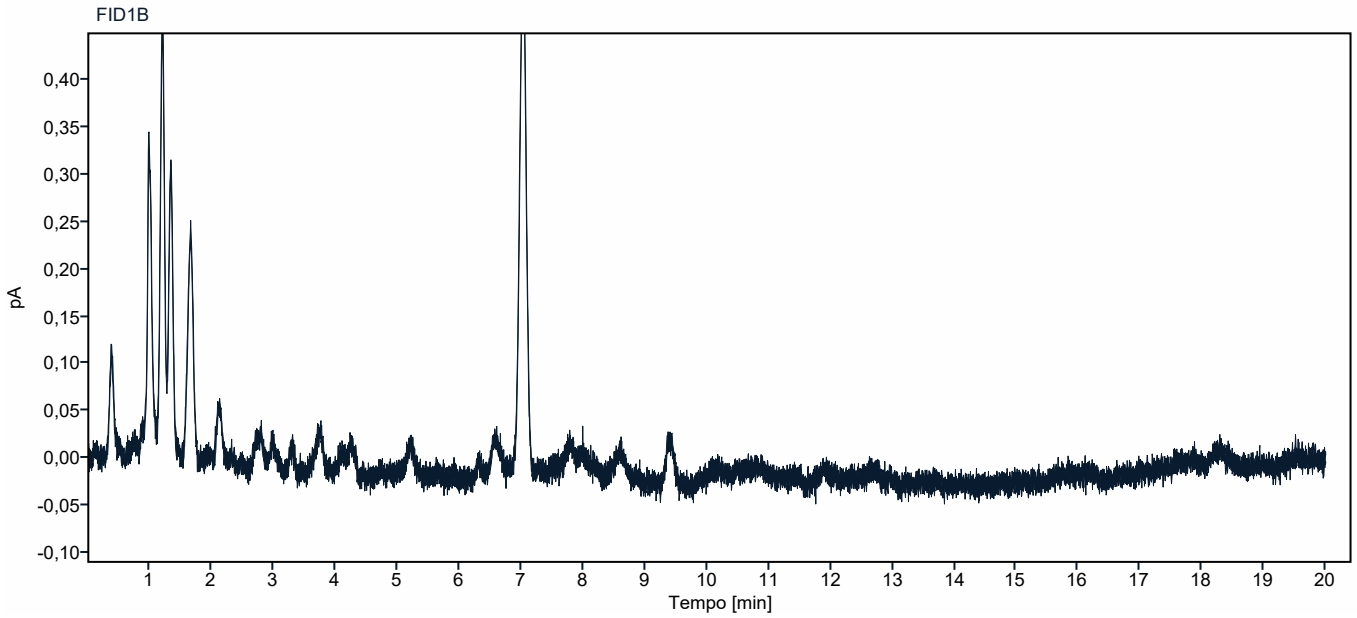

Teste PCIN - Detector FID FRONT

Arquivo de dados: RELB BACK 001.dx\RELB BACK 001.dx
Nome da amostra: RELB BACK 001
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	
Data da injeção:	2025-10-30 16:28:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,000
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-1
Série #:

