Relatório de Injeção Única


Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\Branco 012025-10-28 12-44-50-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 01
Descrição:	

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2025-10-28 12:45:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

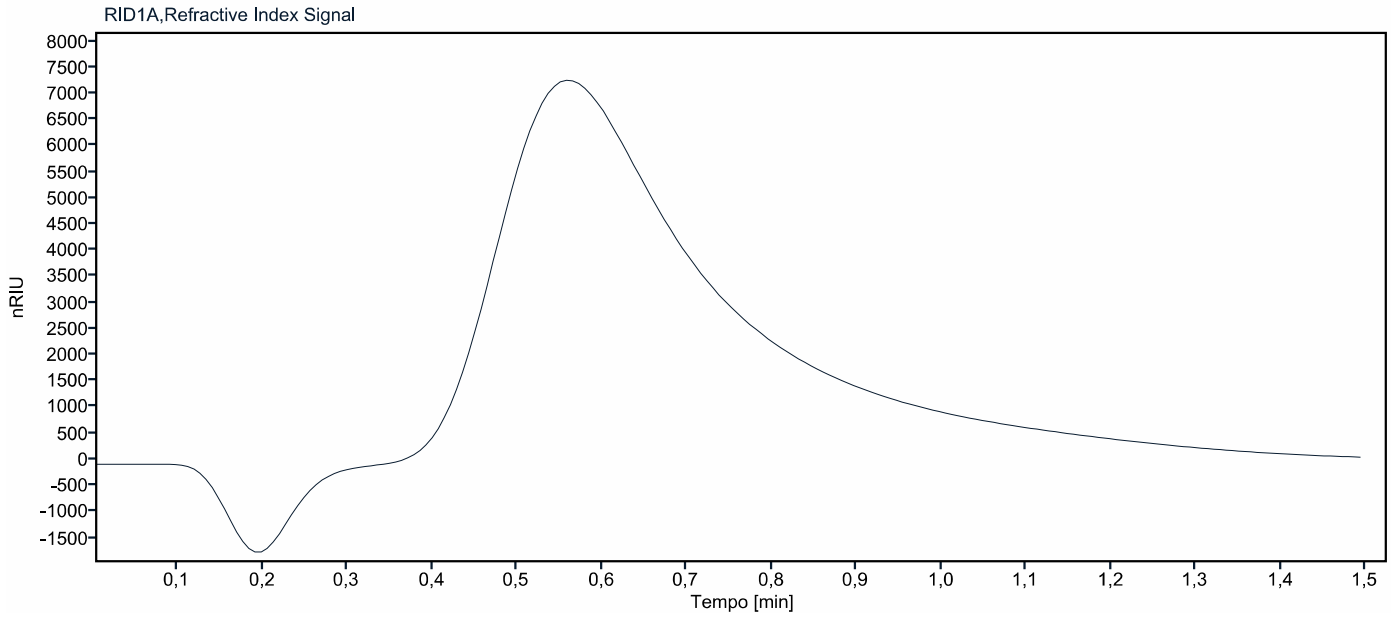


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 012025-10-28 12-47-17-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 12:48:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

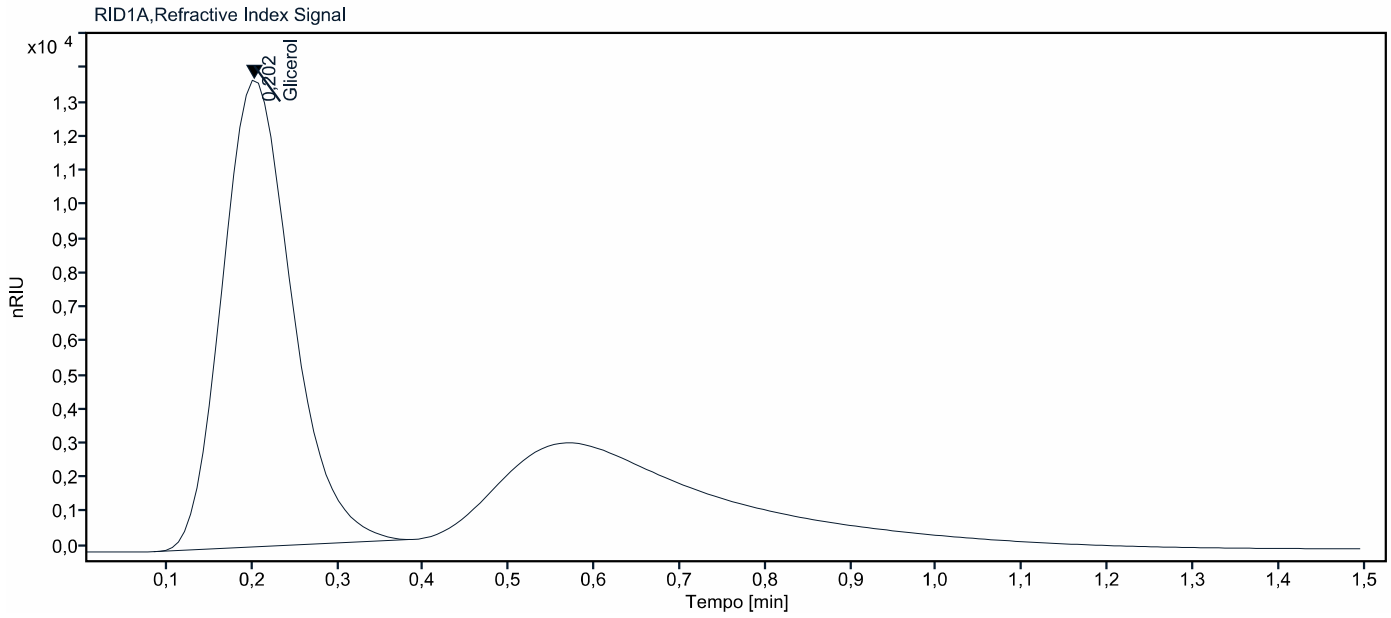

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	77874,9337	13707,755	Glicerol
Soma	**77874,9337**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 022025-10-28 12-49-46-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 12:50:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

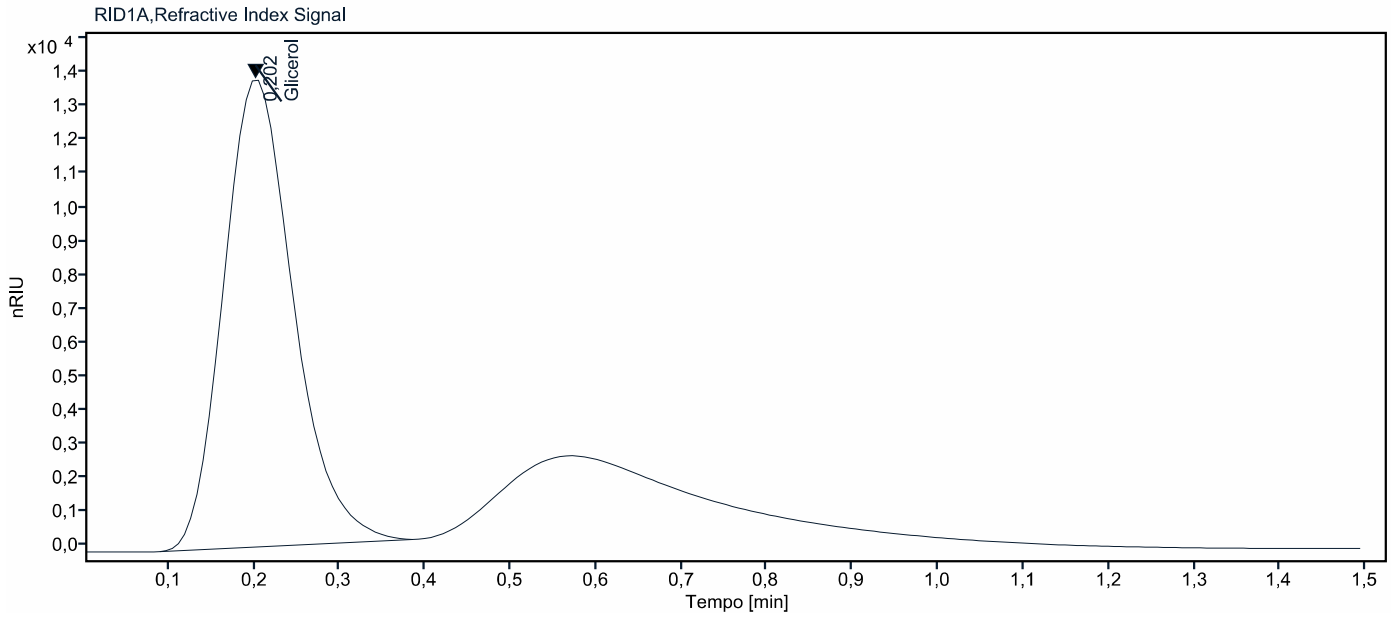

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	78698,7884	13851,072	Glicerol
Soma	**78698,7884**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 032025-10-28 12-52-15-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 12:53:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

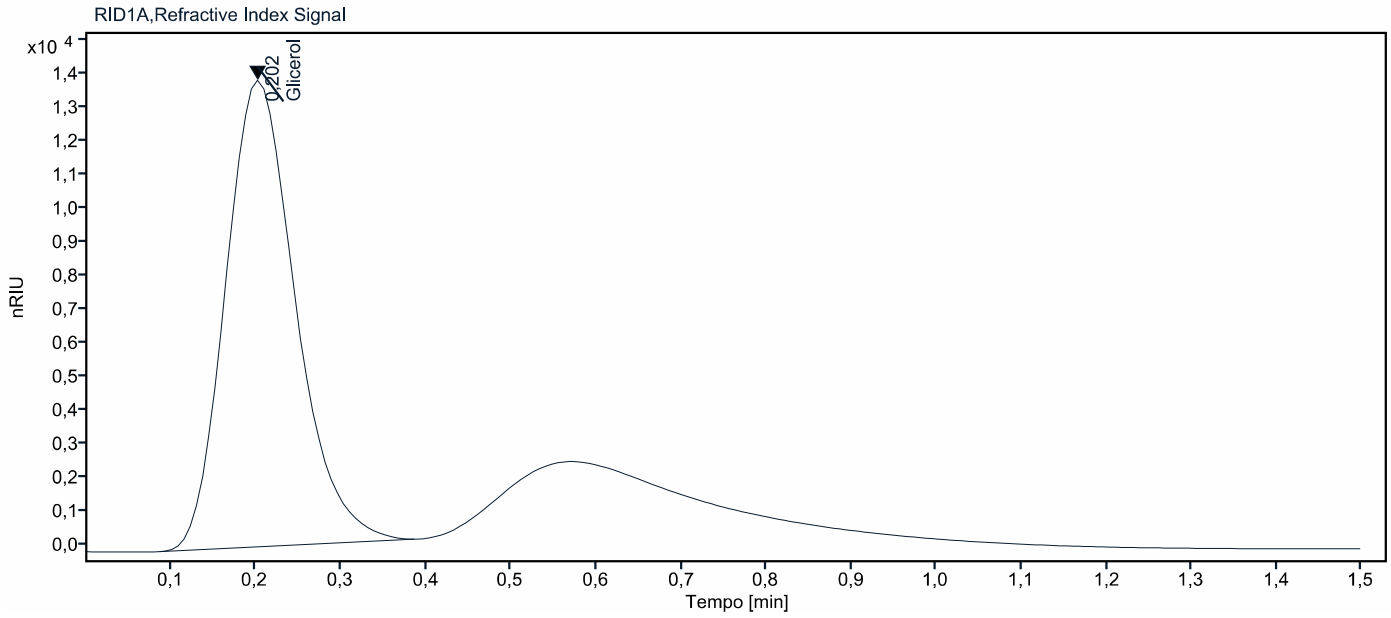

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	78872,4237	13836,606	Glicerol
Soma	**78872,4237**		


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\Branco 022025-10-28 12-54-44-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 02
Descrição:	

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2025-10-28 12:55:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

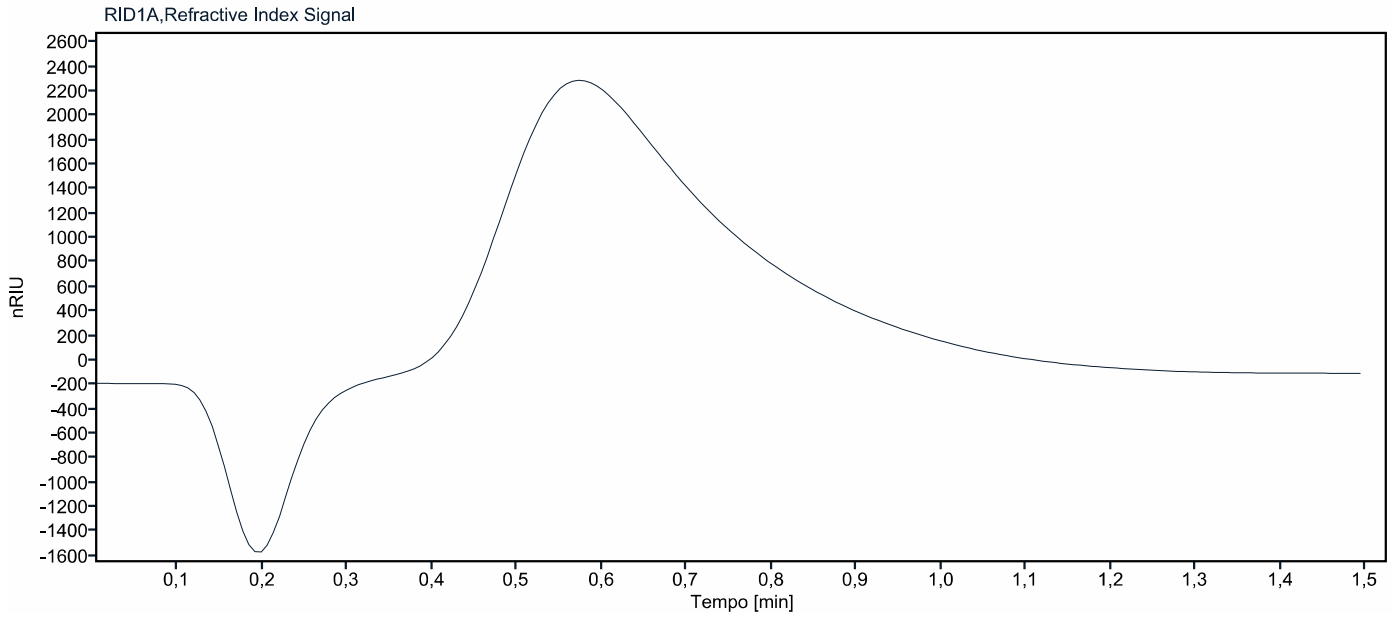


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 042025-10-28 12-57-10-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 12:58:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

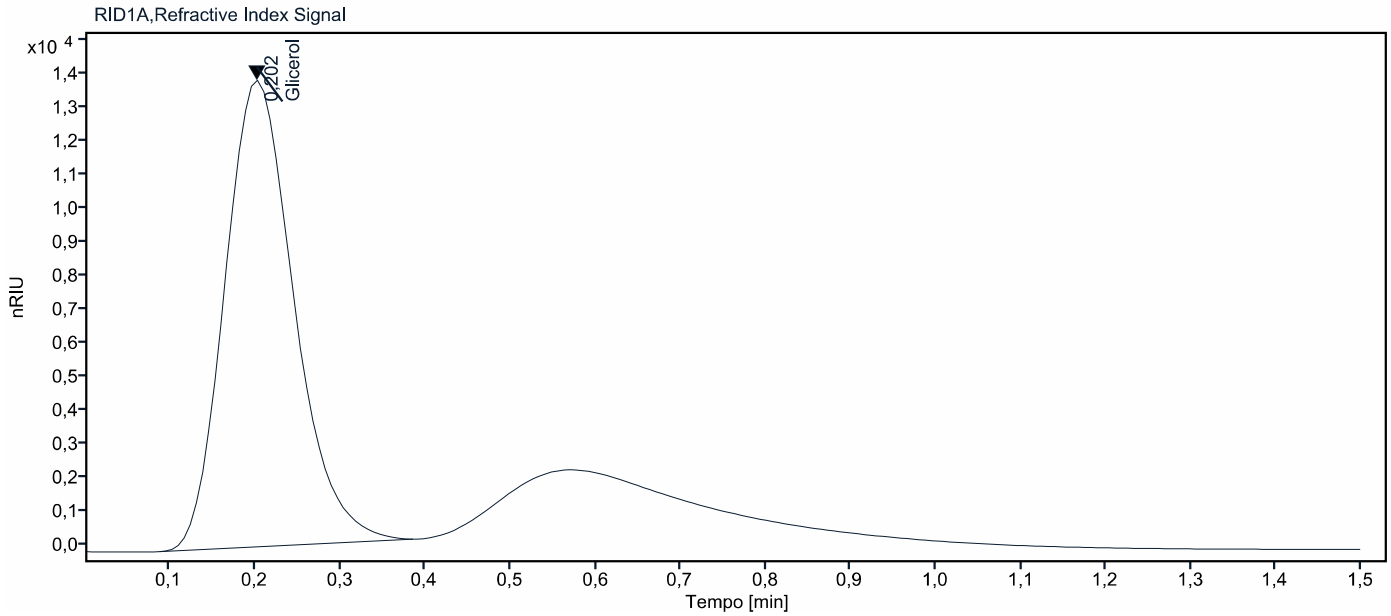

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	78412,7928	13889,417	Glicerol
Soma	**78412,7928**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 052025-10-28 12-59-39-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:00:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

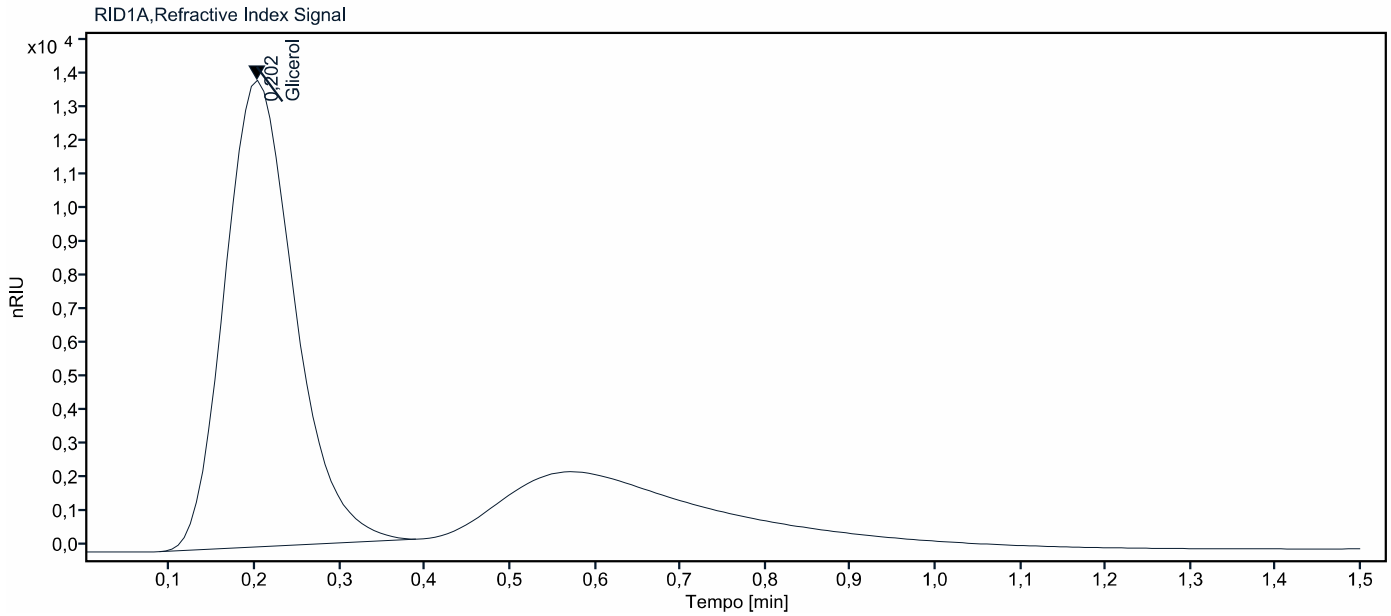

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	79143,5483	13870,282	Glicerol
Soma	**79143,5483**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\PCIN 062025-10-28 13-02-08-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:02:59-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

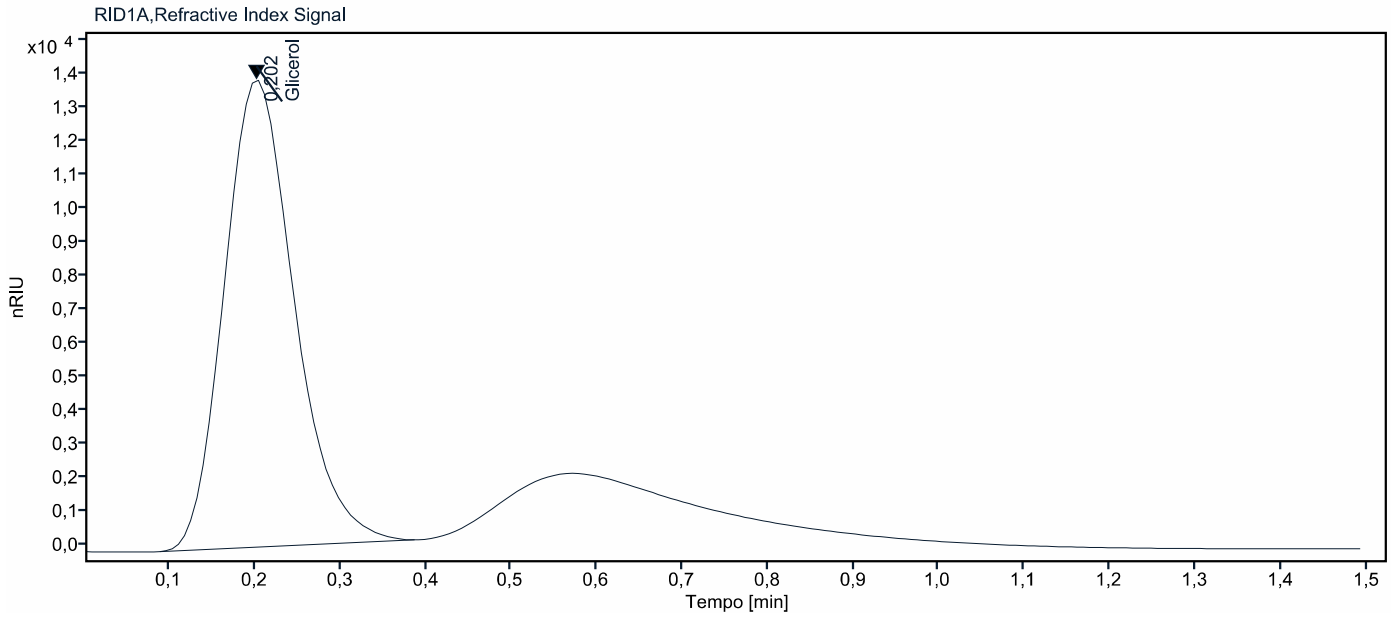

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	78991,7715	13882,811	Glicerol
Soma	**78991,7715**		

Relatório de Injeção Única


Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\Branco 032025-10-28 13-04-37-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 03
Descrição:	

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2025-10-28 13:05:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

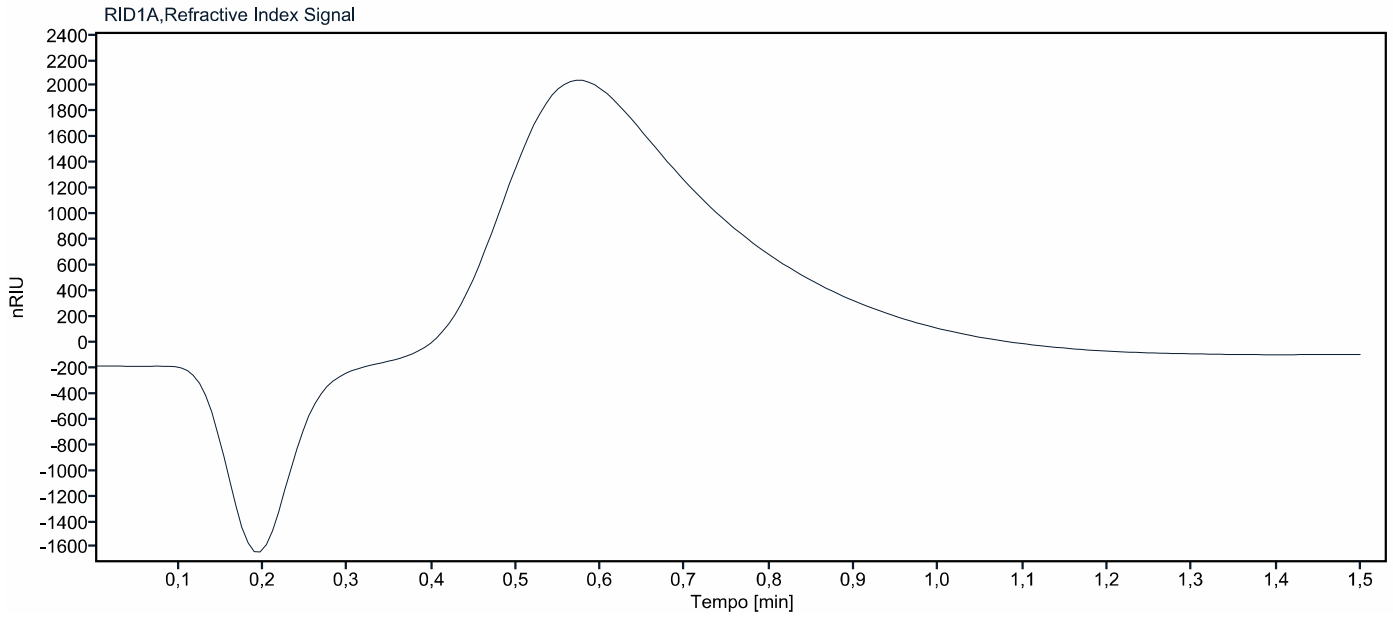


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\LIIN 012025-10-28 13-07-04-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:07:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

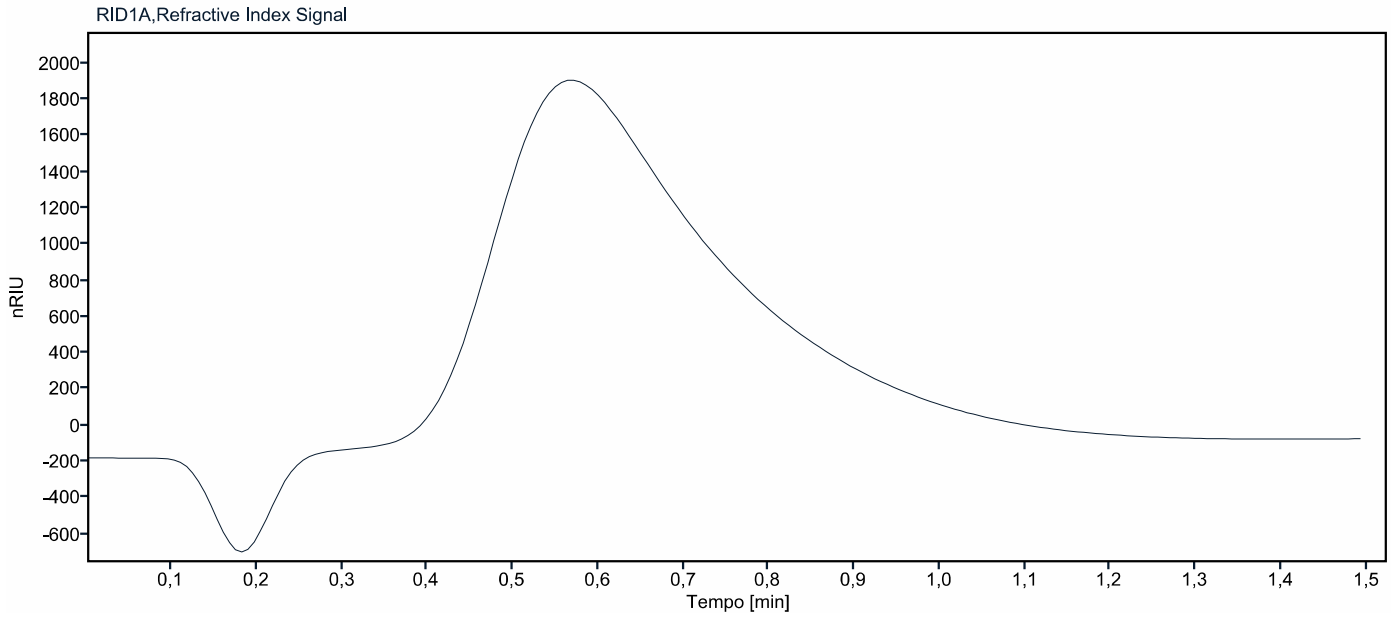


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\LIIN 022025-10-28 13-09-30-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:10:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

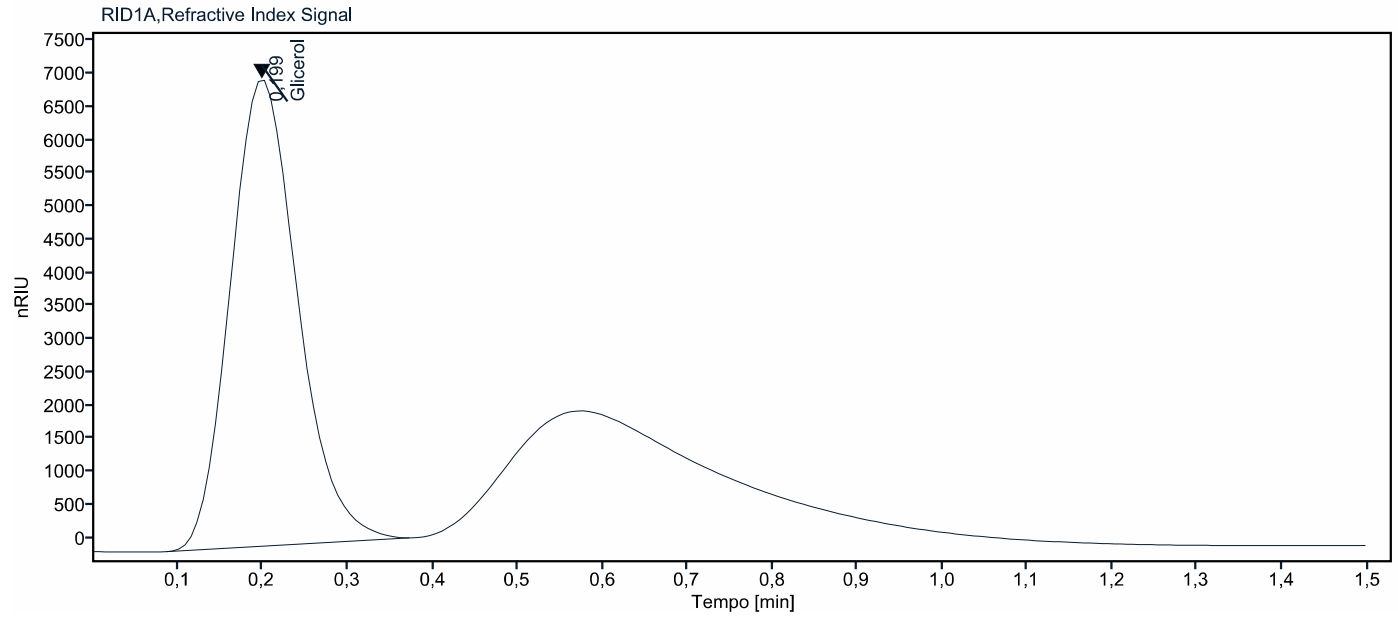

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,199	38732,3783	7049,748	Glicerol
Soma	**38732,3783**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\LIIN 032025-10-28 13-11-54-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:12:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

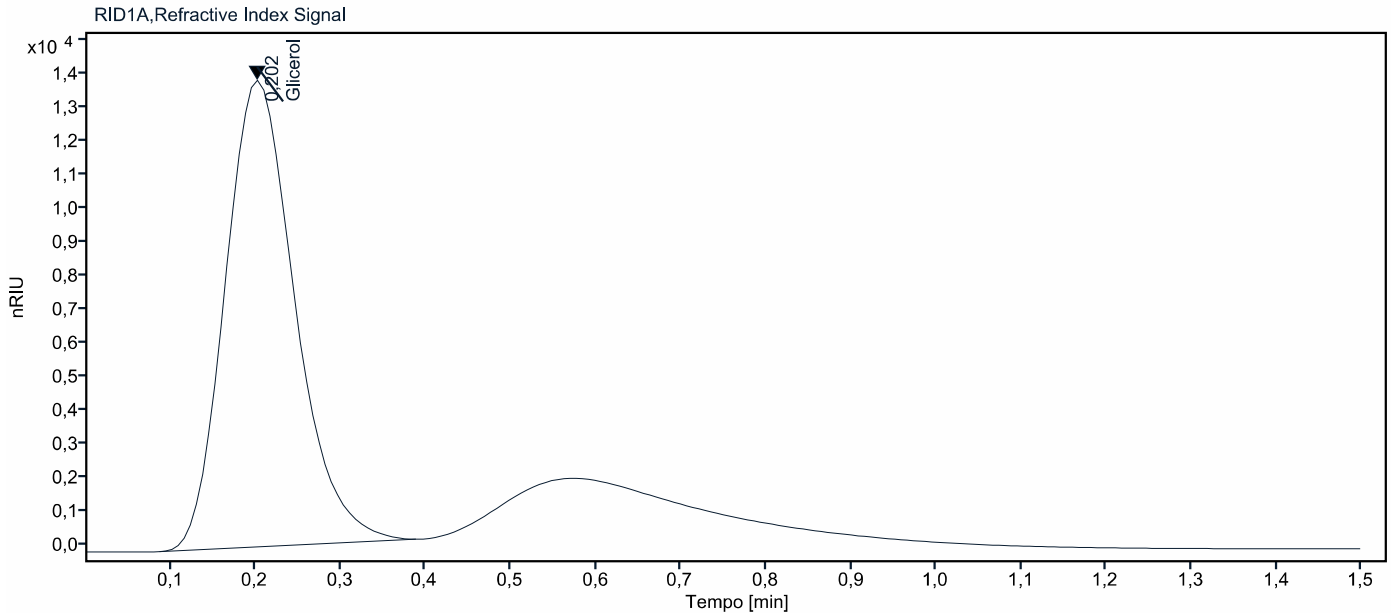

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	78805,2760	13854,086	Glicerol
Soma	**78805,2760**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\LIIN 042025-10-28 13-14-22-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:15:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

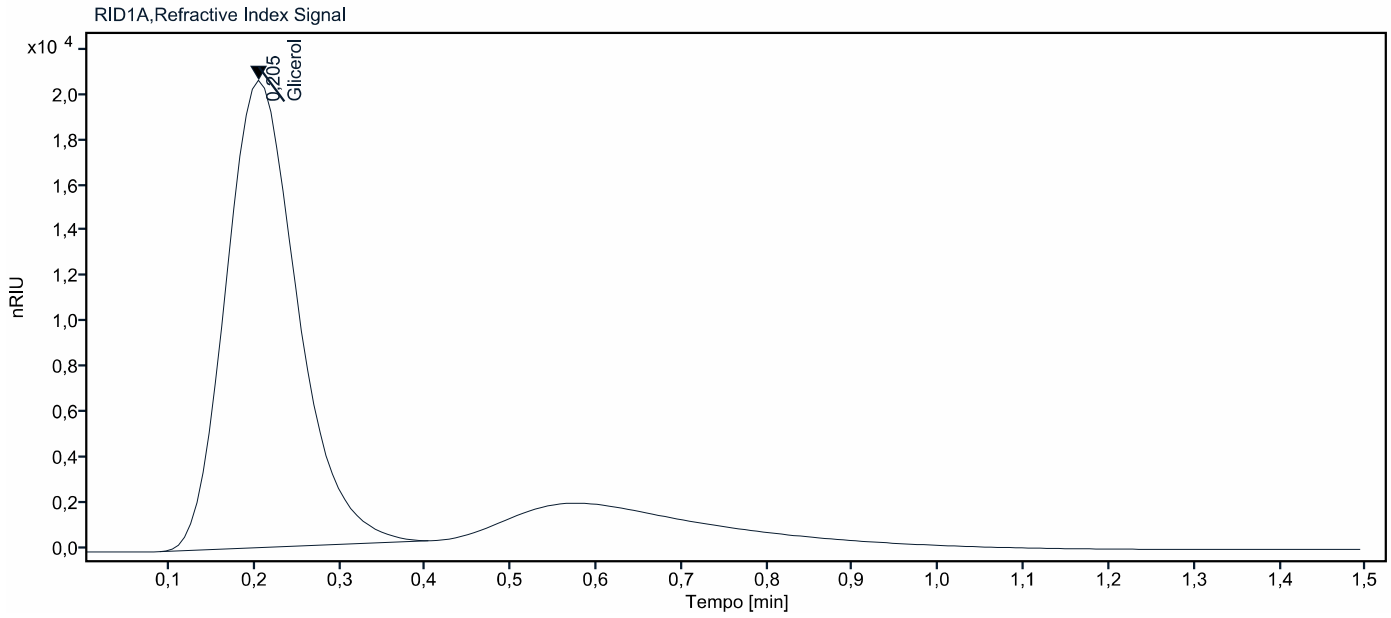

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,205	120602,6034	20643,971	Glicerol
Soma	**120602,6034**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-28 12-44-45-03-00.rslt\LIIN 052025-10-28 13-16-52-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-28 13:17:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 10:35:09-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

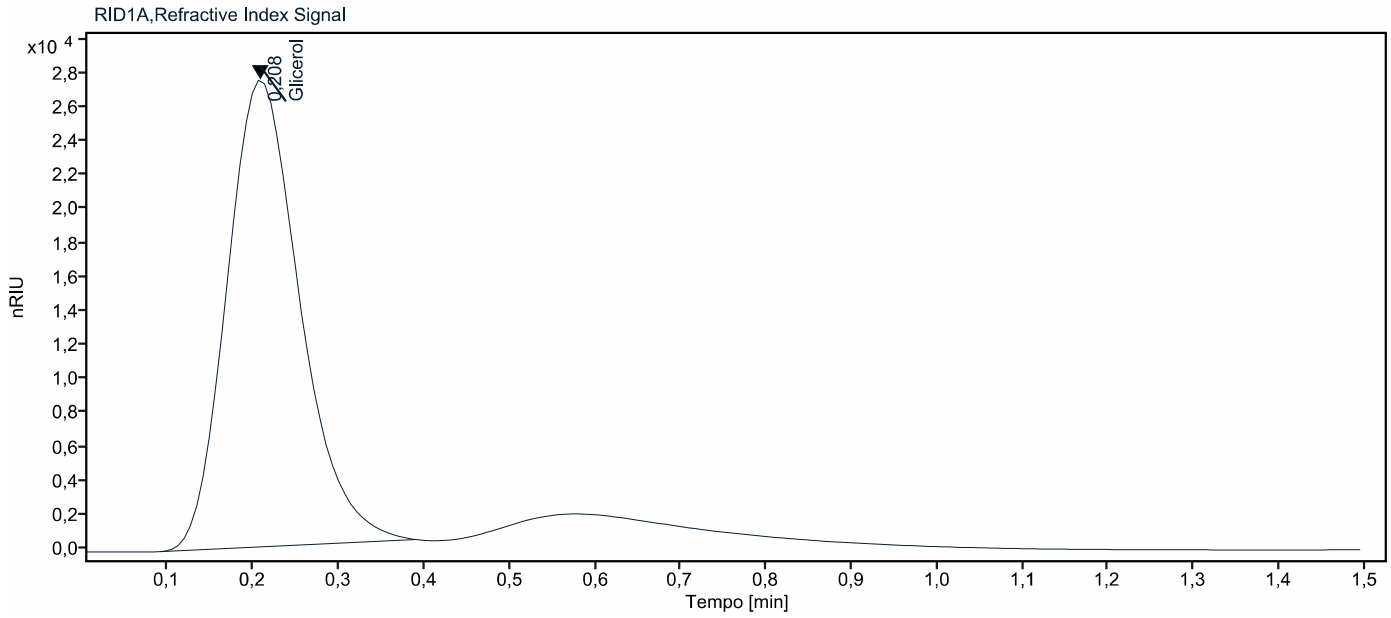

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome
0,208	163153,4998	27512,074	Glicerol
Soma	**163153,4998**		


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-29 12-56-07-03-00.rslt\LDIR 012025-10-29 12-56-12-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F1
Data da injeção:	2025-10-29 12:57:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 13:12:41-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

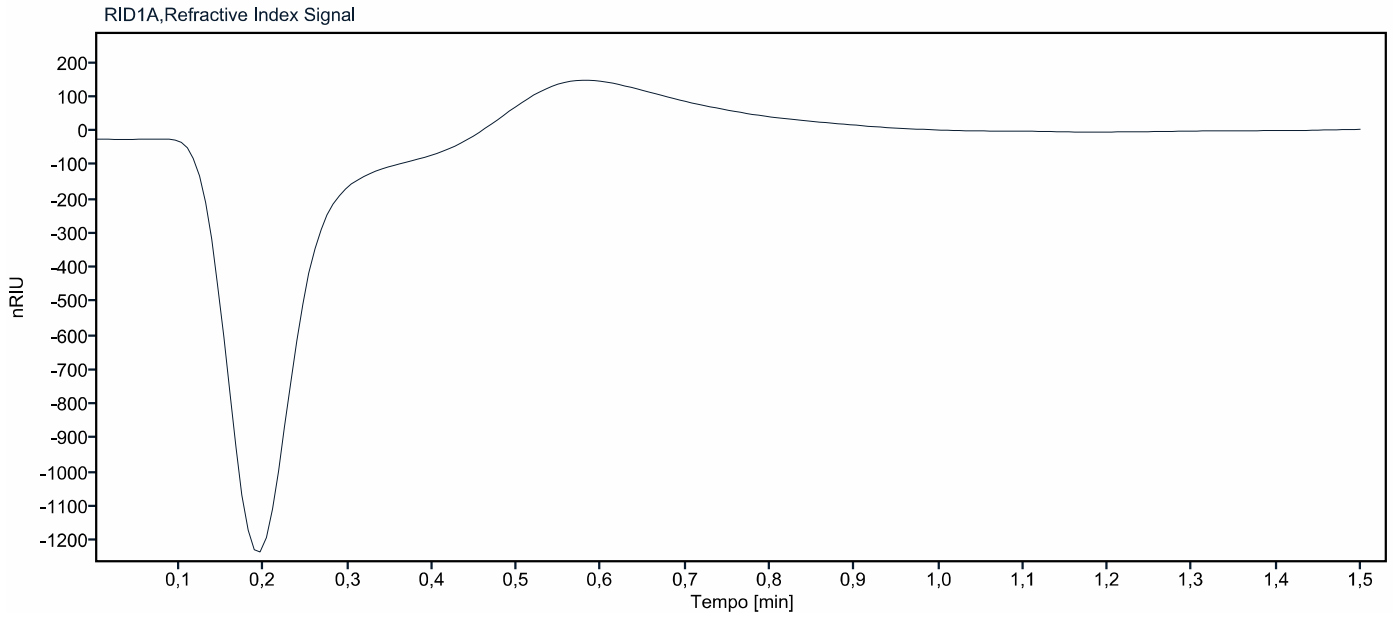


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-29 12-56-07-03-00.rslt\LDIR 022025-10-29 12-58-38-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F2
Data da injeção:	2025-10-29 12:59:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 13:12:41-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

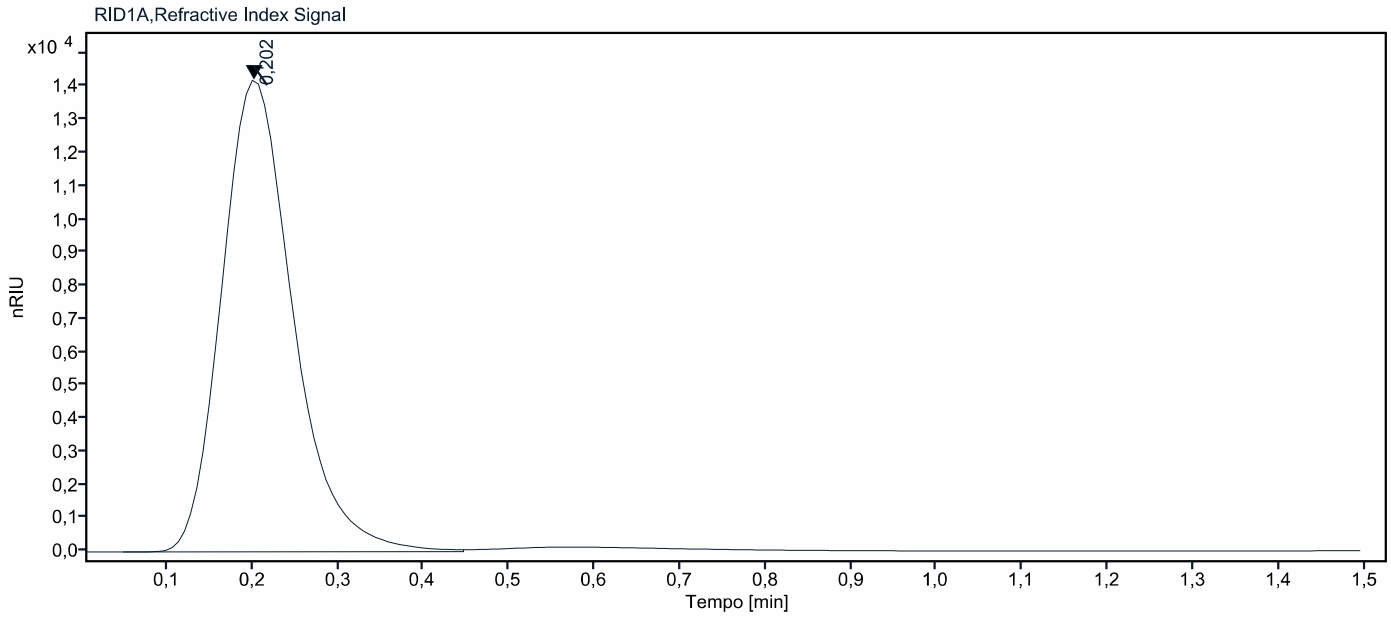

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome
0,202	82457,9136	14235,549	
Soma	**82457,9136**		


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-29 12-56-07-03-00.rslt\LDIR 032025-10-29 13-01-05-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F3
Data da injeção:	2025-10-29 13:01:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 13:12:41-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

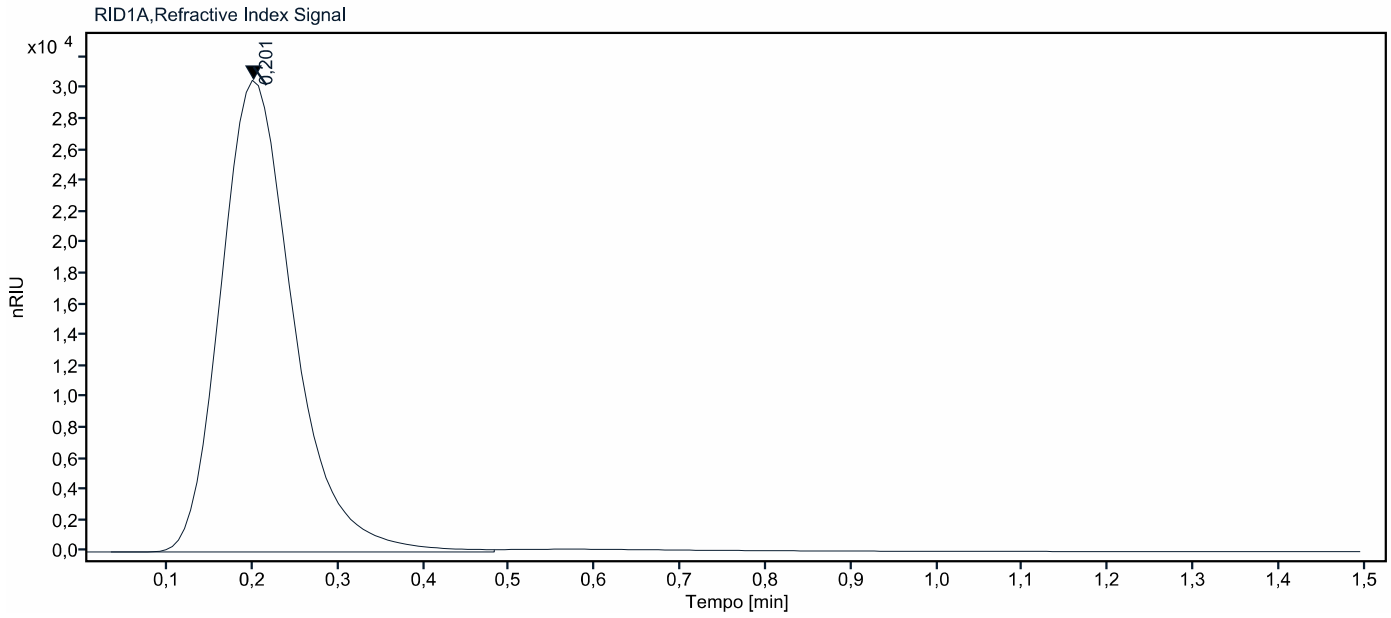

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,201	180100,1405	30576,097	
Soma	**180100,1405**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-29 12-56-07-03-00.rslt\LDIR 042025-10-29 13-03-32-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F4
Data da injeção:	2025-10-29 13:04:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 13:12:41-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

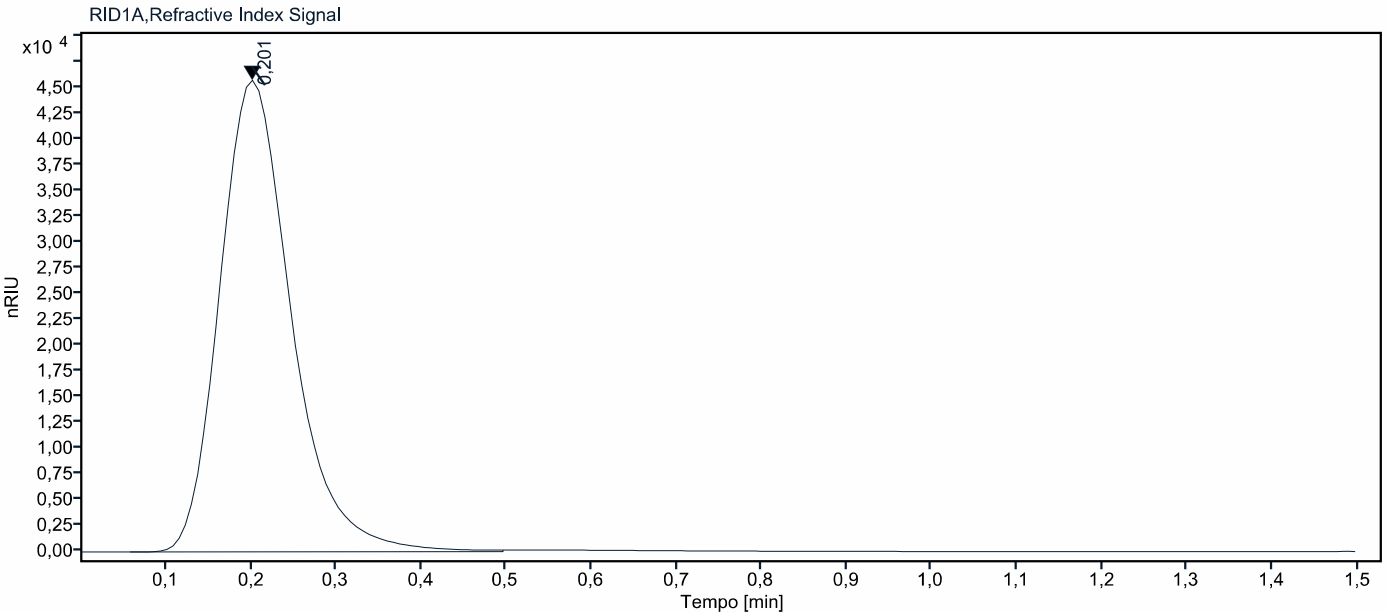

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome
0,201	267453,0859	45740,910	
Soma	**267453,0859**		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC RID-2025-10-29 12-56-07-03-00.rslt\LDIR 052025-10-29 13-06-00-03-00.dx
Nome da amostra: LDIR 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC RID	**Localização:**	P1-F5
Data da injeção:	2025-10-29 13:06:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 13:12:41-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

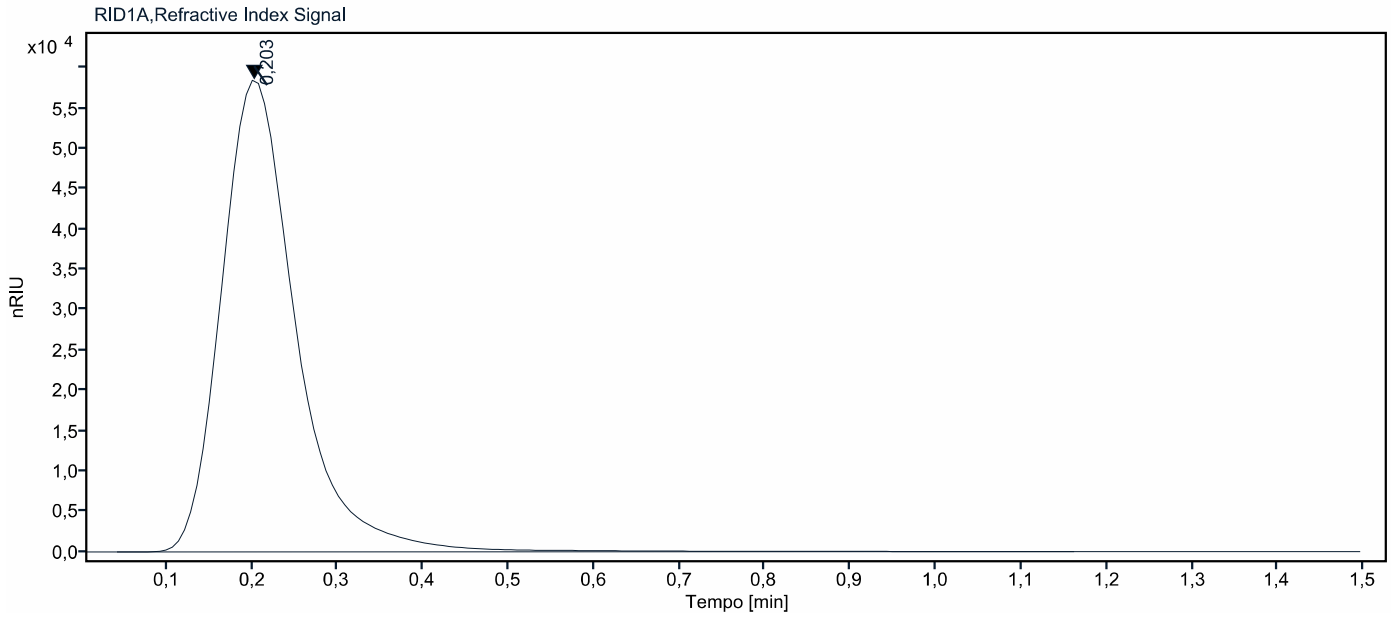

Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome
0,203	355796,6016	58644,402	
Soma	**355796,6016**		