
Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 012025-10-30 09-53-47-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 01
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 09:54:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	EDUV.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:57:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

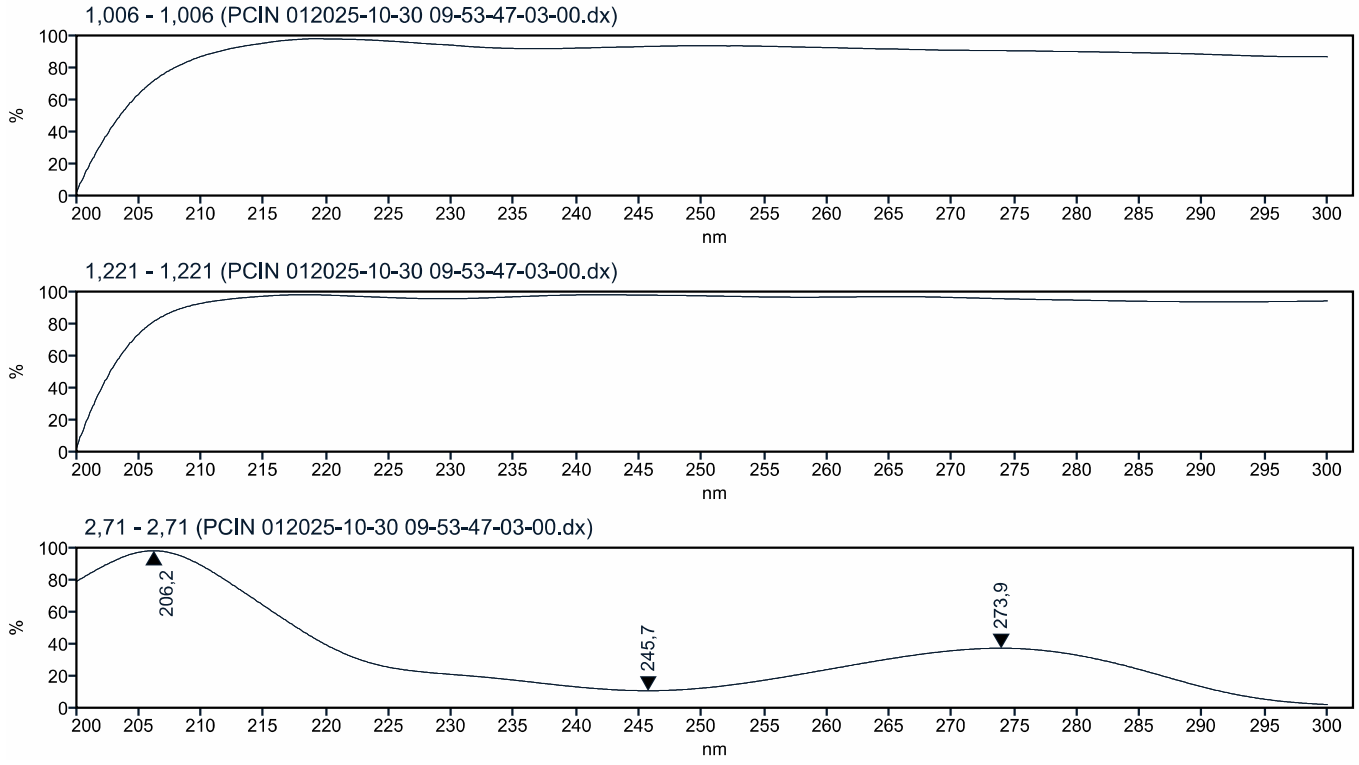


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-29 15-10-19-03-00.rslt\2025-10-29 15-10-26-03-00-01.dx
Nome da amostra: Gradiente AB
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2025-10-29 15:11:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 17:19:24-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

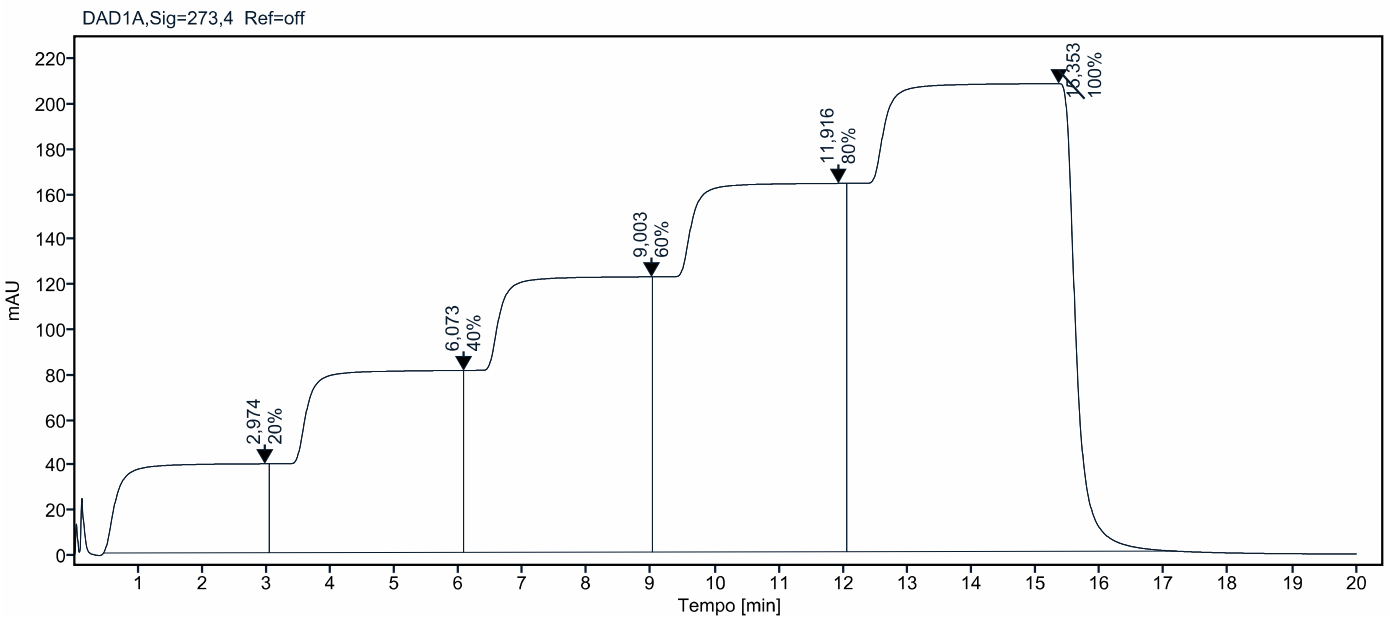

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,974	MM m	5615,8715	39,559			20%
6,073	MM m	13150,1356	80,735			40%
9,003	MM m	20137,1605	122,175			60%
11,916	MM m	28110,5834	163,464			80%
15,353	MM m	43273,4096	207,566			100%
	Soma	**110287,1607**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-29 16-19-14-03-00.rslt\2025-10-29 16-19-19-03-00-01.dx
Nome da amostra: Gradiente CD
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2025-10-29 16:20:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-29 17:38:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

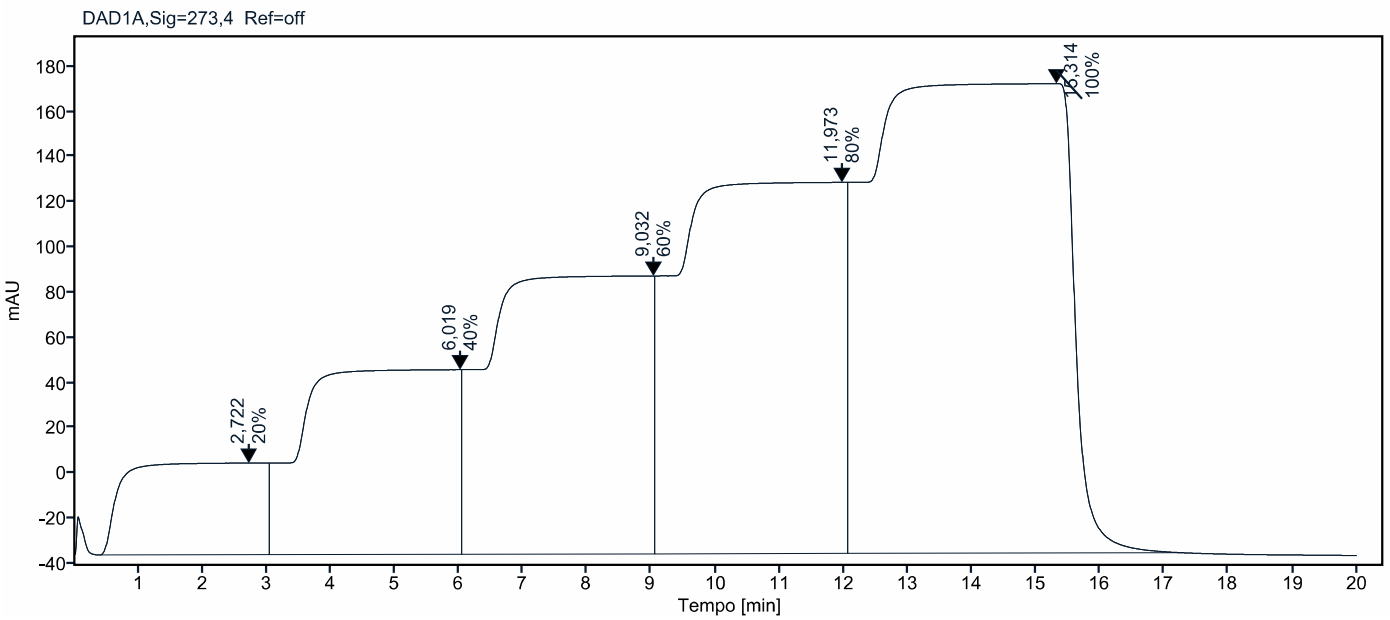

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,722	MM m	5812,3286	40,555			20%
6,019	MM m	13174,1045	81,694			40%
9,032	MM m	20698,9086	123,017			60%
11,973	MM m	28179,9144	164,298			80%
15,314	MM m	43193,5416	207,841			100%
	Soma	**111058,7977**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\Branco 012025-10-30 09-47-47-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 01
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B3
Data da injeção:	2025-10-30 09:48:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

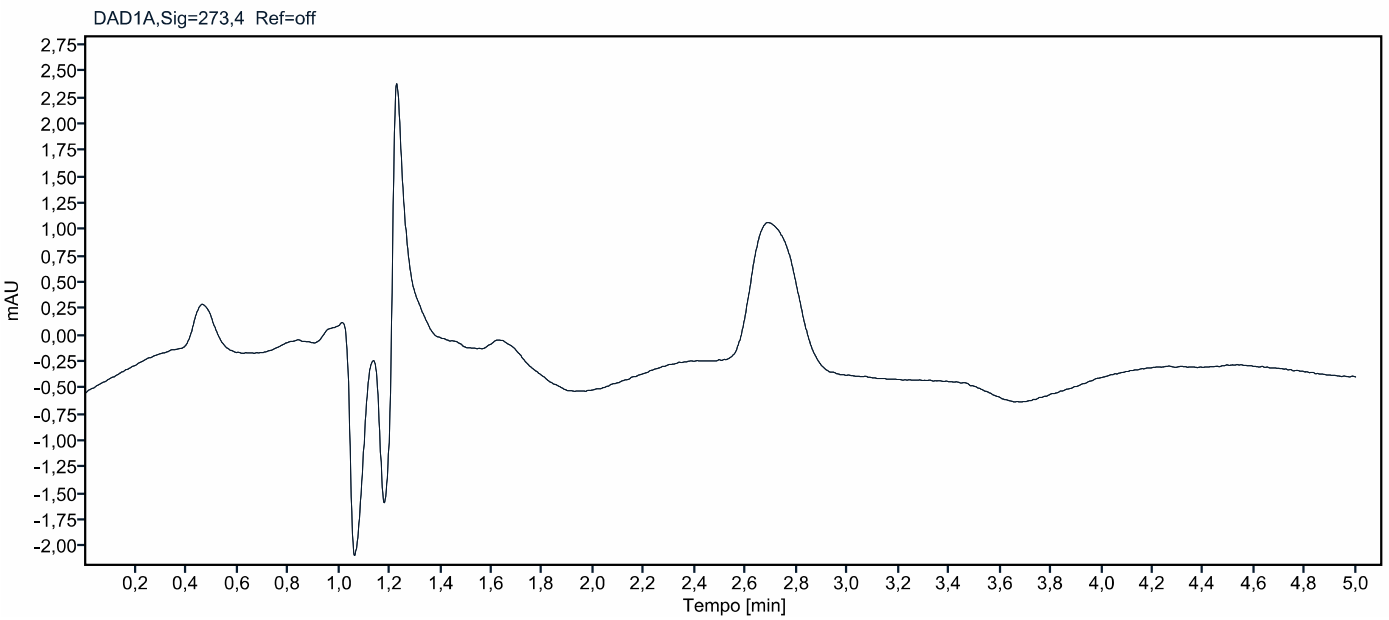


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 012025-10-30 09-53-47-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 01
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 09:54:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*EDUV.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 17:07:19-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

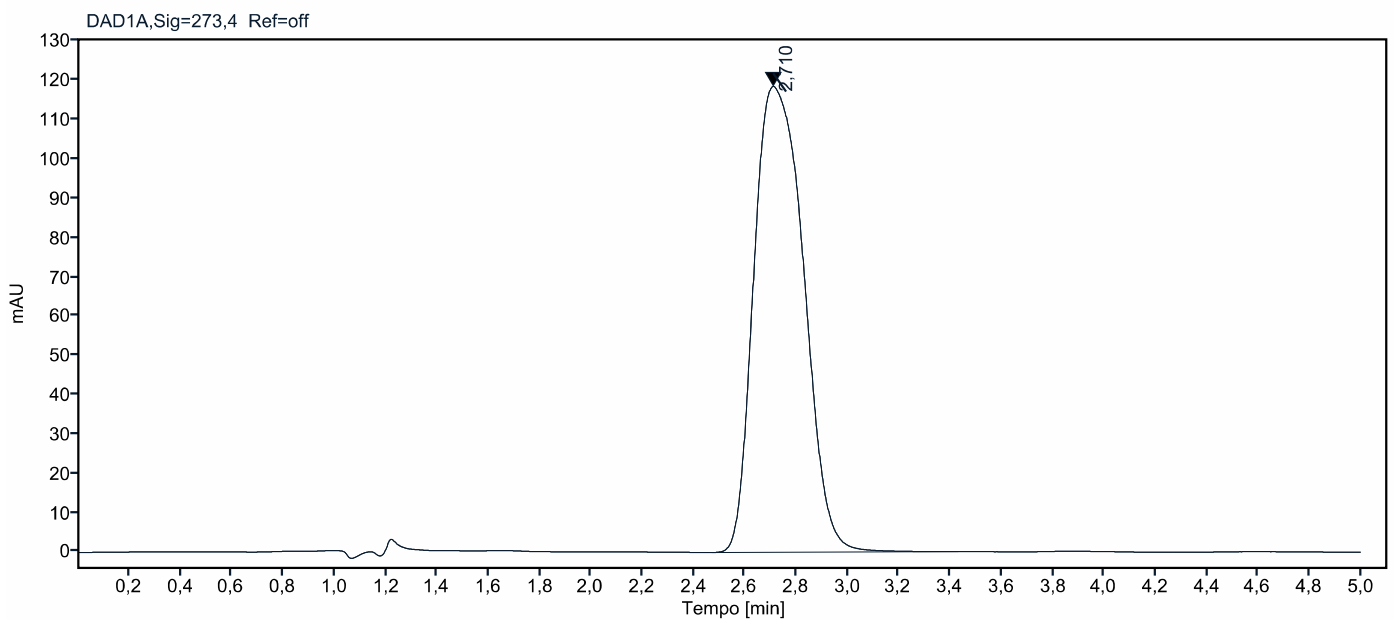

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,710	1597,6714	118,558			
Soma	**1597,6714**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 022025-10-30 09-59-48-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 10:00:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

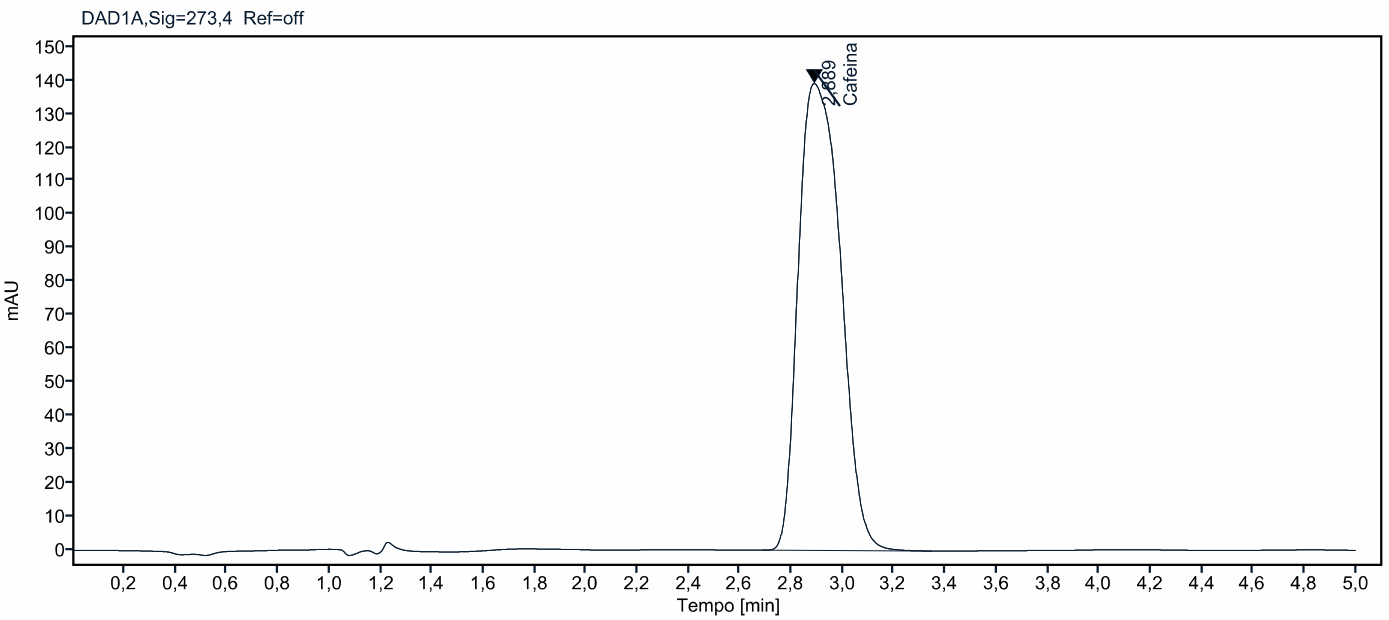

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,889	1591,1980	138,940			Cafeina
Soma	**1591,1980**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 032025-10-30 10-05-49-03-00.dx
Nome da amostra:	PCIN 03
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 10:06:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

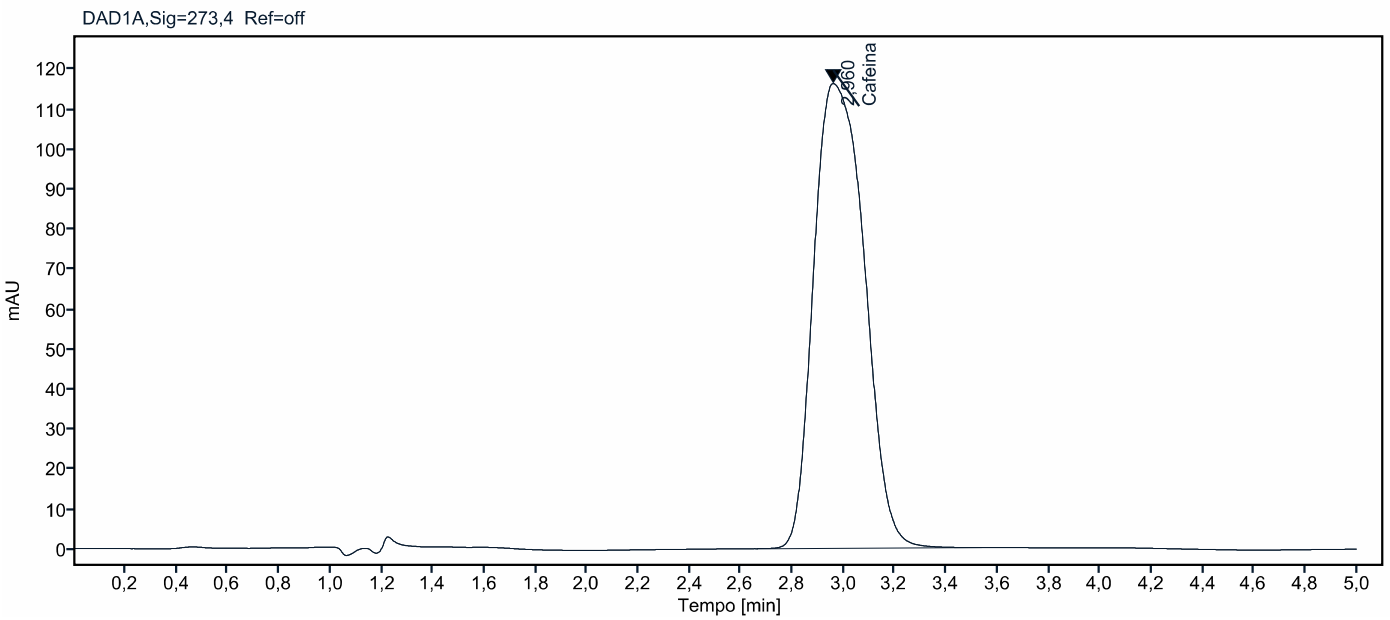

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,960	1597,2718	116,164			Cafeina
Soma	**1597,2718**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\Branco 022025-10-30 10-11-49-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 02
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B3
Data da injeção:	2025-10-30 10:12:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

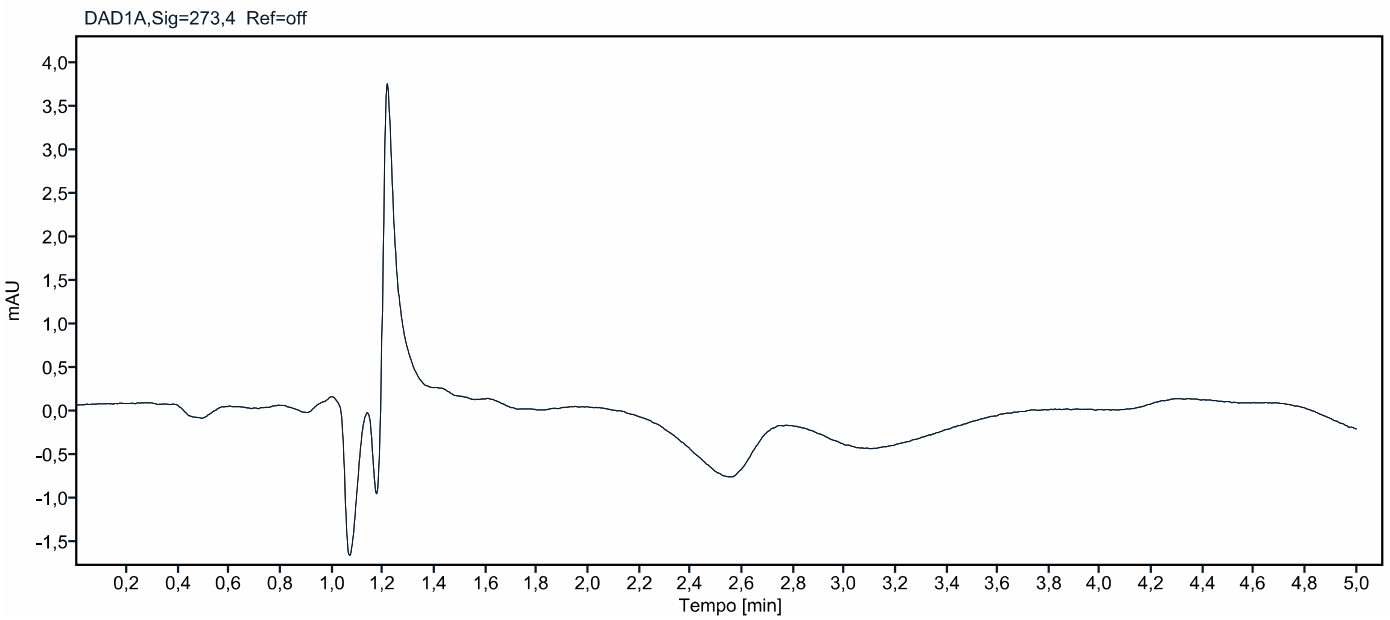


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 042025-10-30 10-17-49-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 10:18:47-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

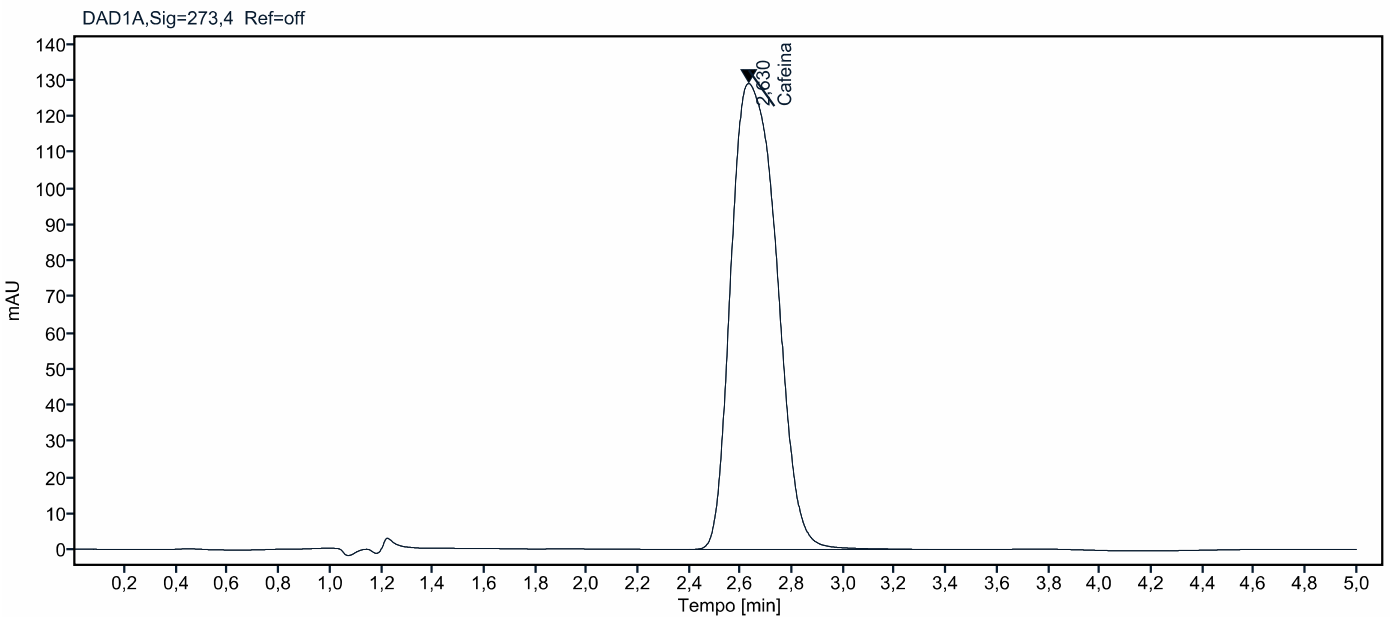

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,630	1597,8454	129,097			Cafeina
Soma	**1597,8454**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 052025-10-30 10-23-50-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 10:24:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

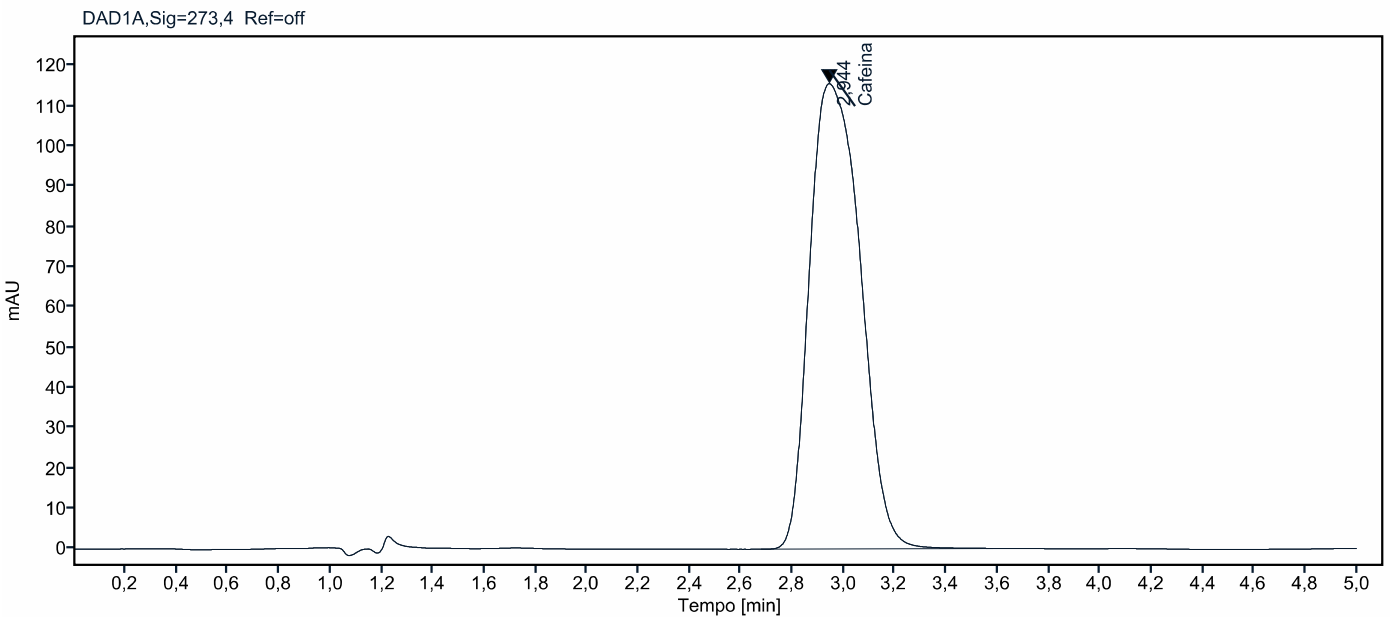

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,944	1596,4386	115,595			Cafeina
Soma	**1596,4386**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\PCIN 062025-10-30 10-29-51-03-00.dx
Nome da amostra: PCIN 06
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B4
Data da injeção:	2025-10-30 10:30:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

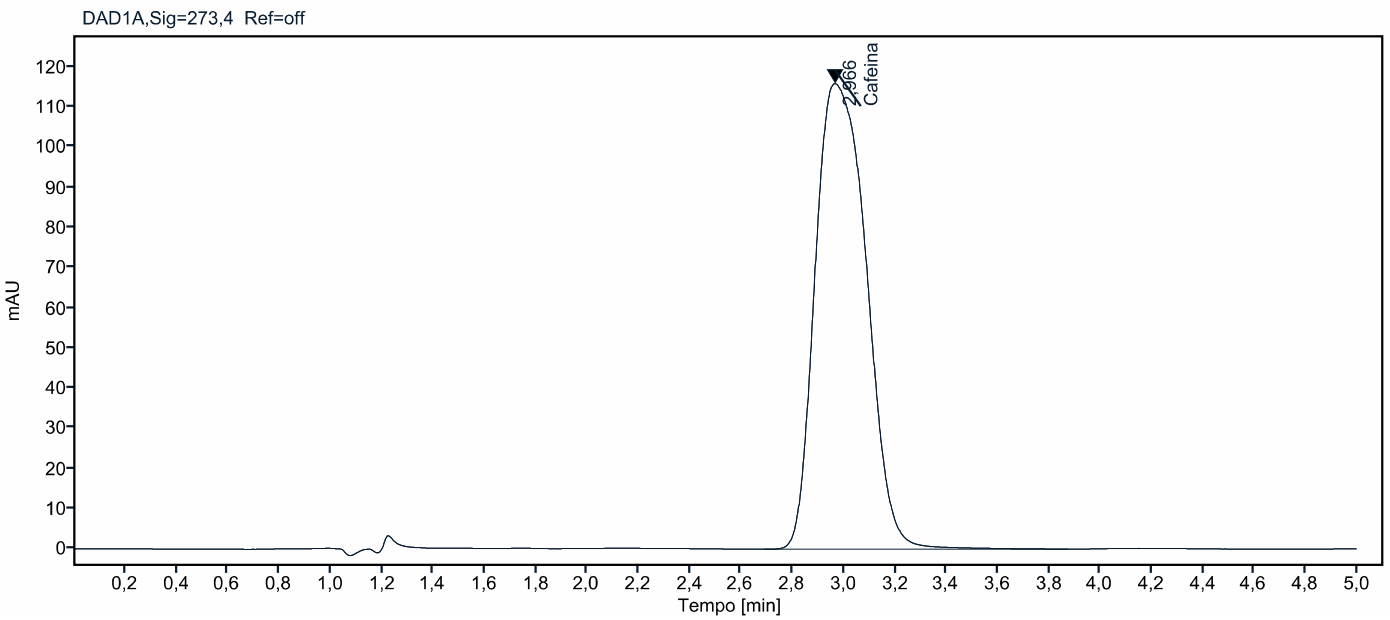

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,966	1606,4193	115,927			Cafeina
Soma	**1606,4193**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\Branco 032025-10-30 10-35-52-03-00.dx
Nome da amostra:	Branco 03
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-B3
Data da injeção:	2025-10-30 10:36:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

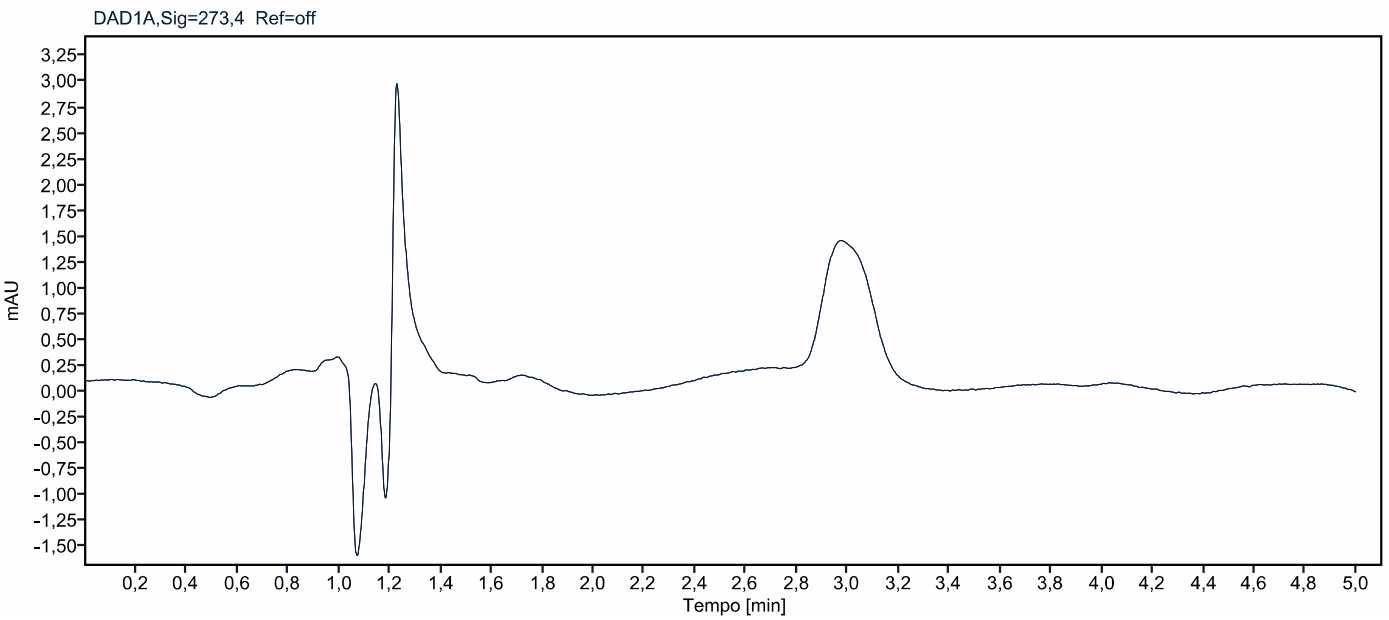


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LDUV 012025-10-30 10-41-53-03-00.dx
Nome da amostra:	LDUV 01
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A1
Data da injeção:	2025-10-30 10:42:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

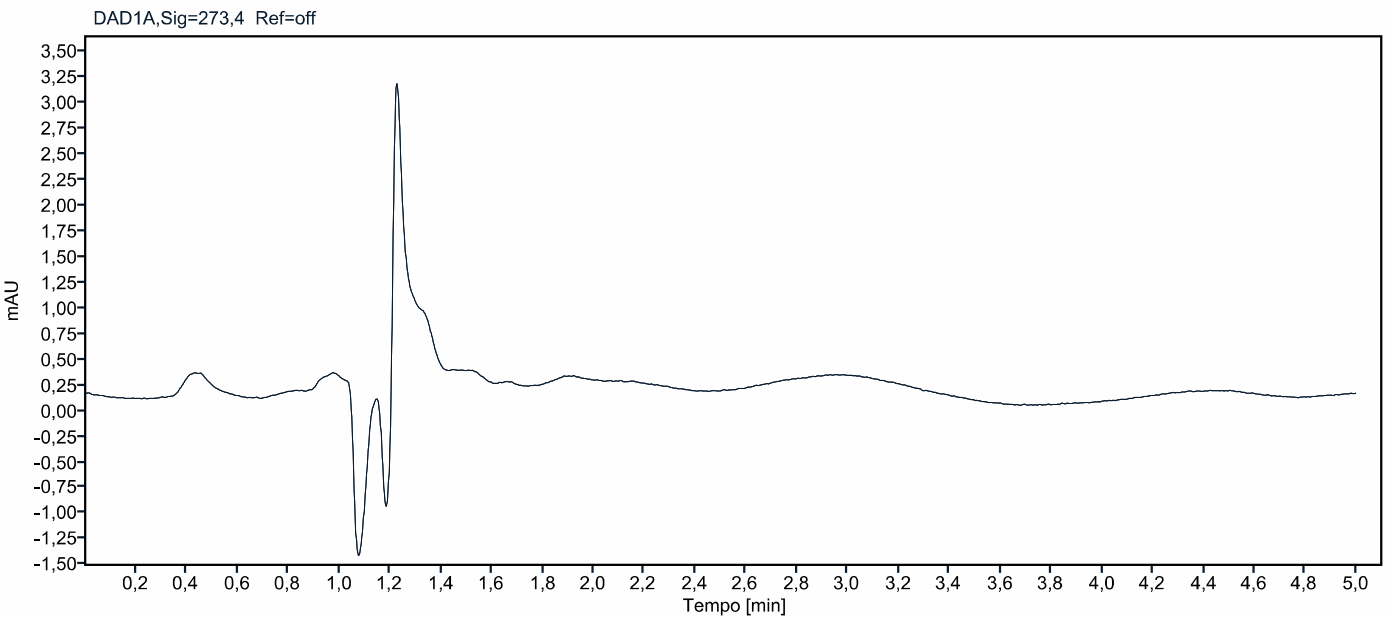


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LDUV 022025-10-30 10-47-56-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A2
Data da injeção:	2025-10-30 10:48:56-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

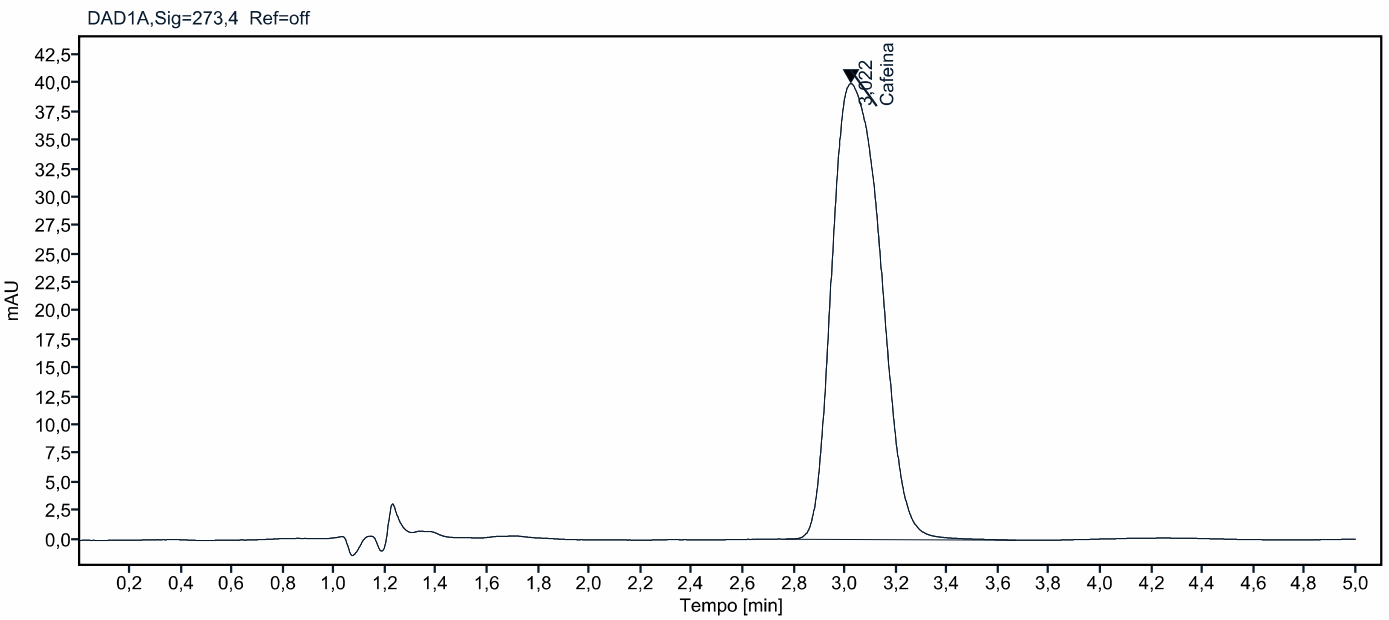

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
3,022	530,7579	39,990			Cafeina
Soma	**530,7579**				


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LDUV 032025-10-30 10-53-58-03-00.dx
Nome da amostra:	LDUV 03
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A3
Data da injeção:	2025-10-30 10:54:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

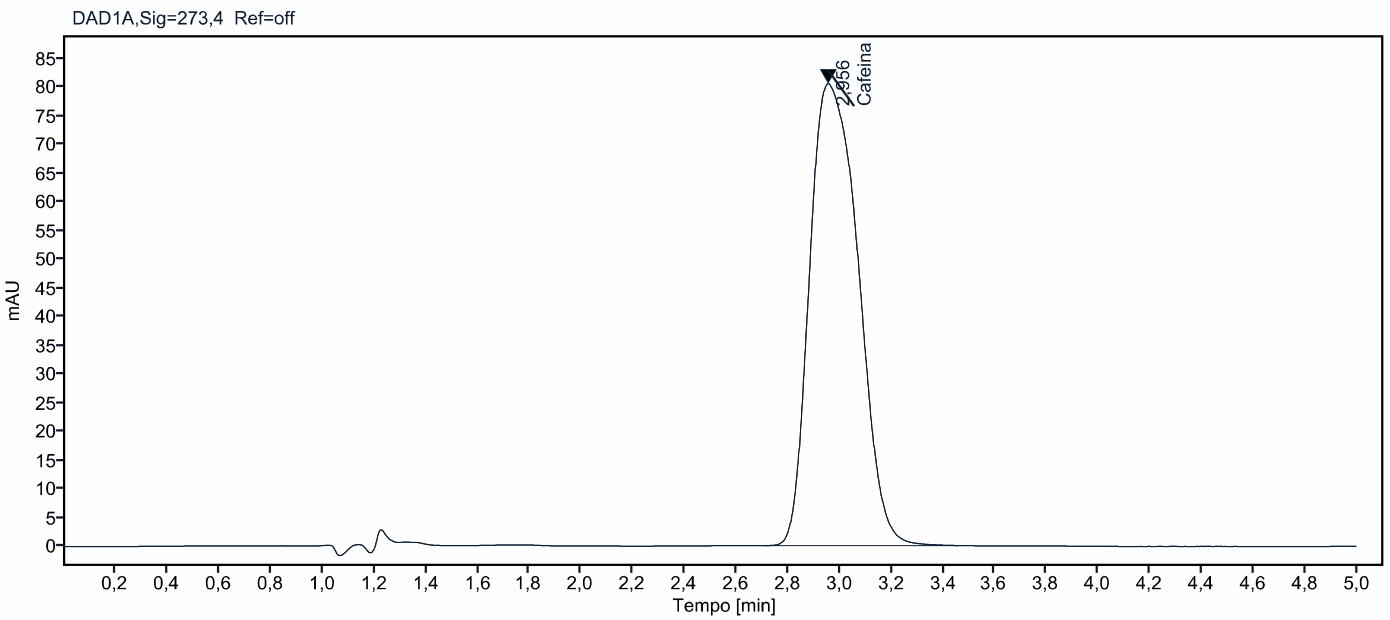

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,956	1054,7545	80,654			Cafeina
Soma	**1054,7545**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LDUV 042025-10-30 10-59-59-03-00.dx
Nome da amostra:	LDUV 04
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A4
Data da injeção:	2025-10-30 11:00:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

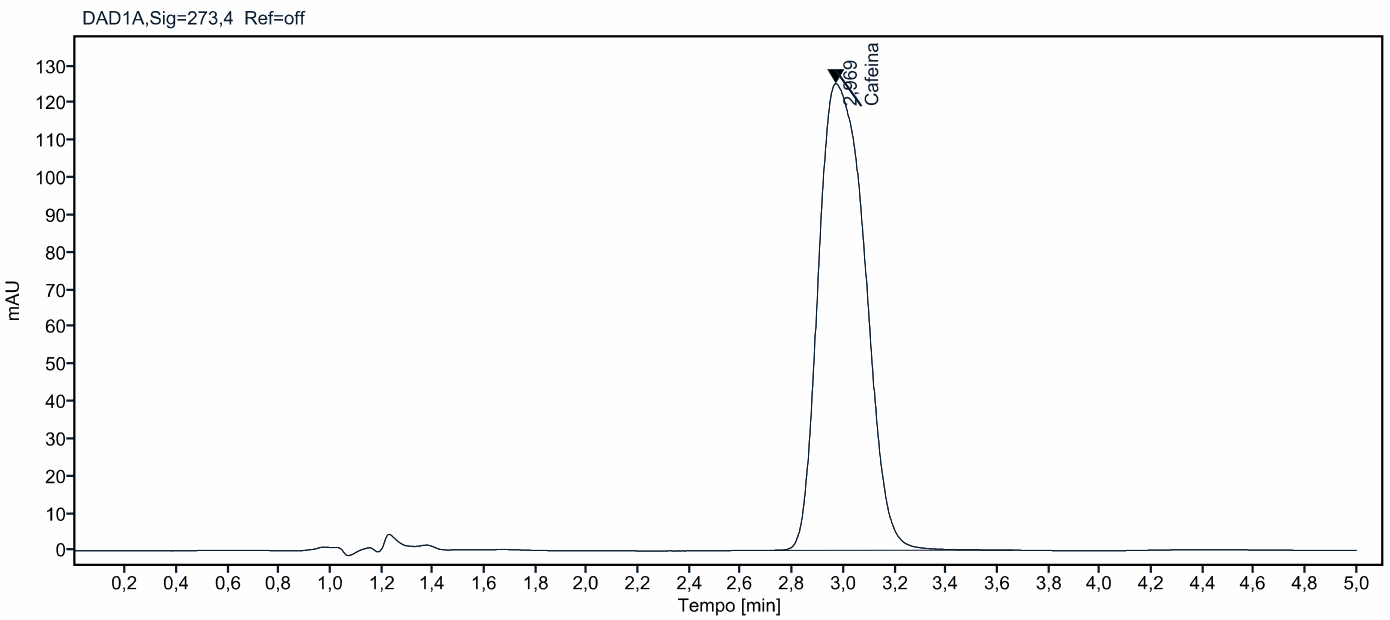

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,969	1576,6871	125,190			Cafeina
Soma	**1576,6871**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LDUV 052025-10-30 11-05-59-03-00.dx
Nome da amostra: LDUV 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A5
Data da injeção:	2025-10-30 11:06:57-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

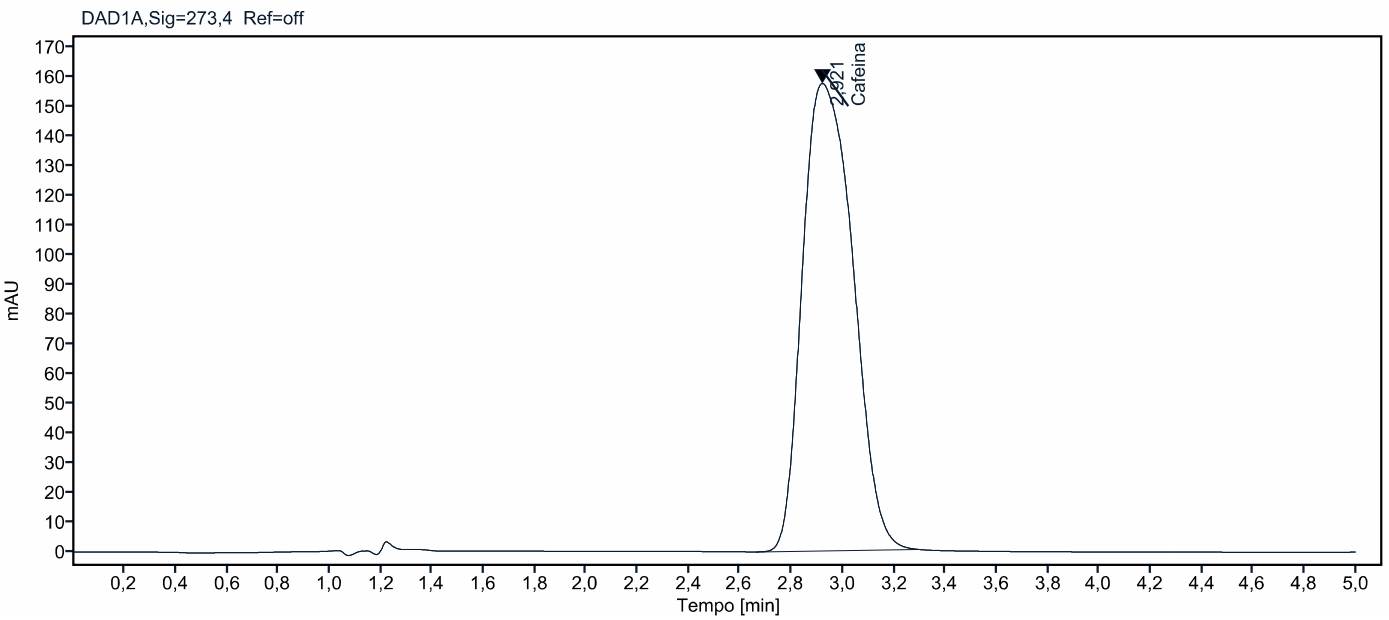

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,921	2161,2741	157,390			Cafeina
Soma	**2161,2741**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LIIN 012025-10-30 11-12-00-03-00.dx
Nome da amostra:	LIIN 01
Descrição:	

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2025-10-30 11:12:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

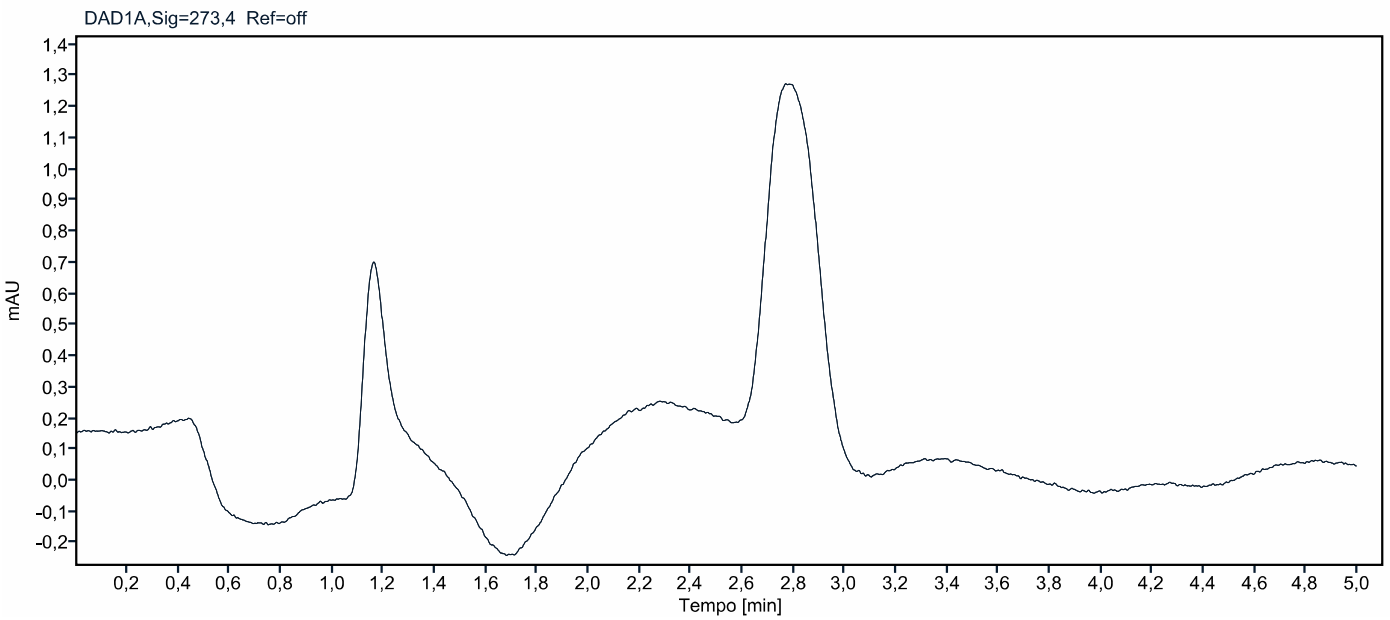


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LIIN 022025-10-30 11-17-57-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 02
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2025-10-30 11:18:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

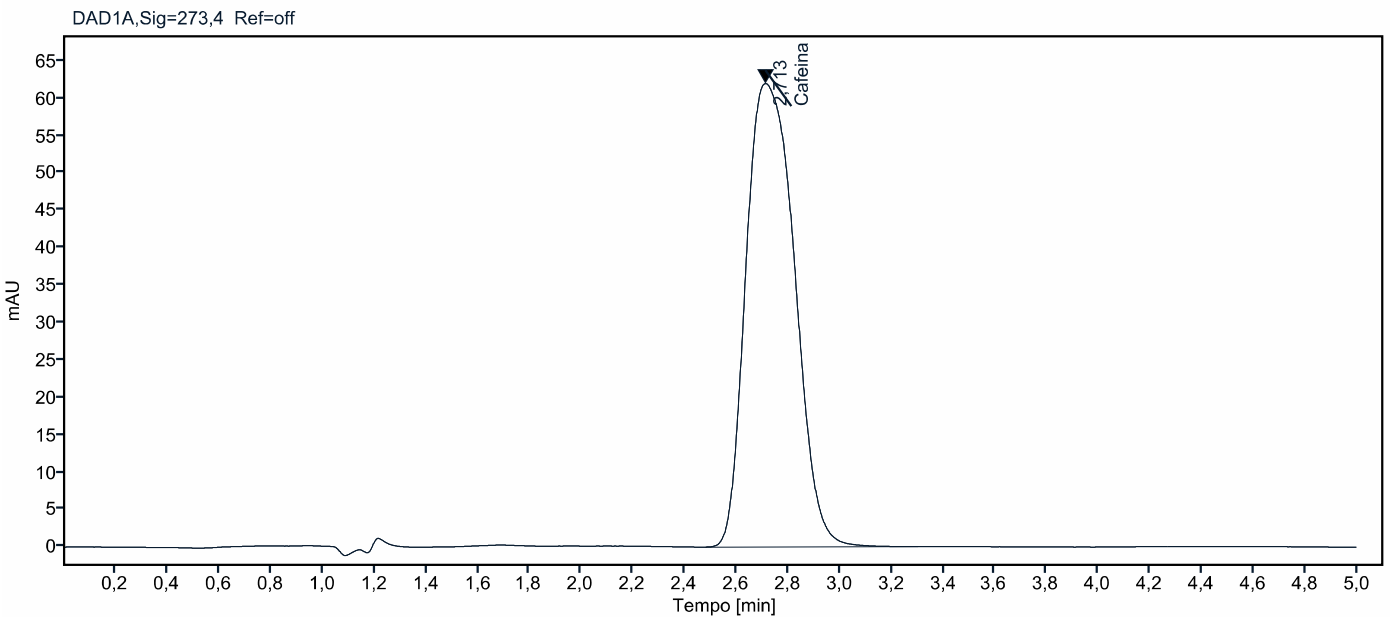

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,713	809,9737	61,969			Cafeina
Soma	**809,9737**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LIIN 032025-10-30 11-23-52-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 03
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2025-10-30 11:24:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

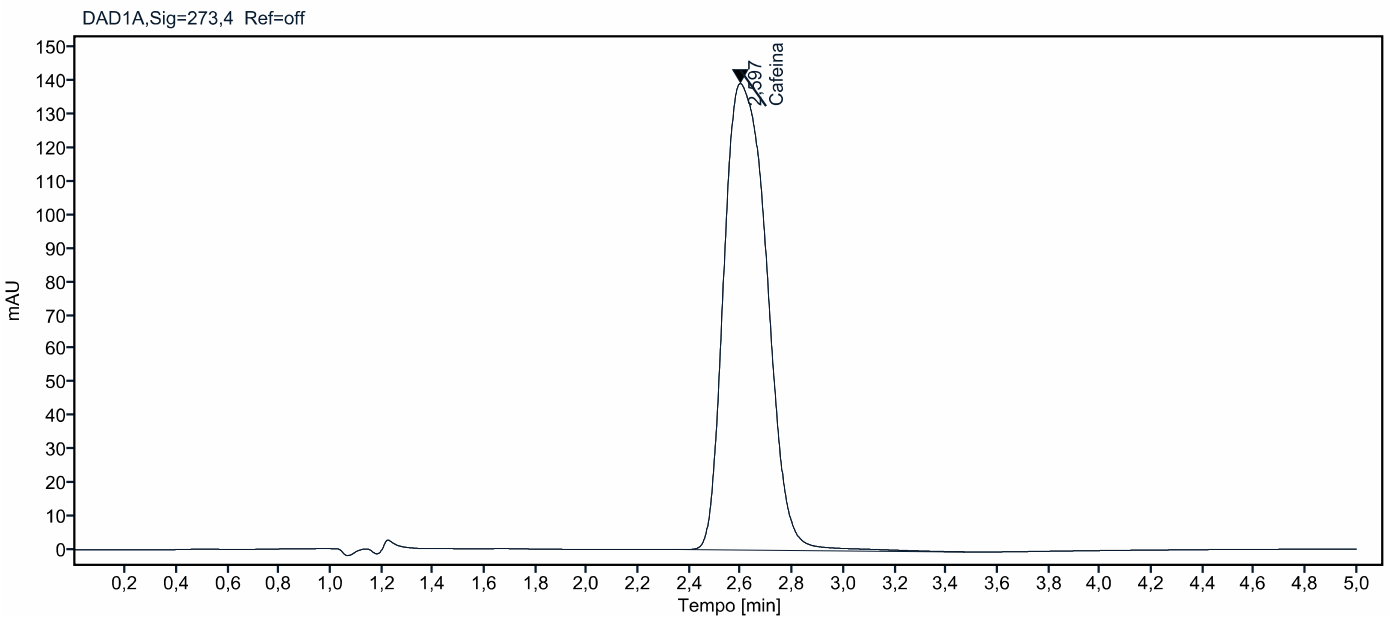

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,597	1622,7186	139,377			Cafeina
Soma	**1622,7186**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LIIN 042025-10-30 11-29-51-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 04
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2025-10-30 11:30:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

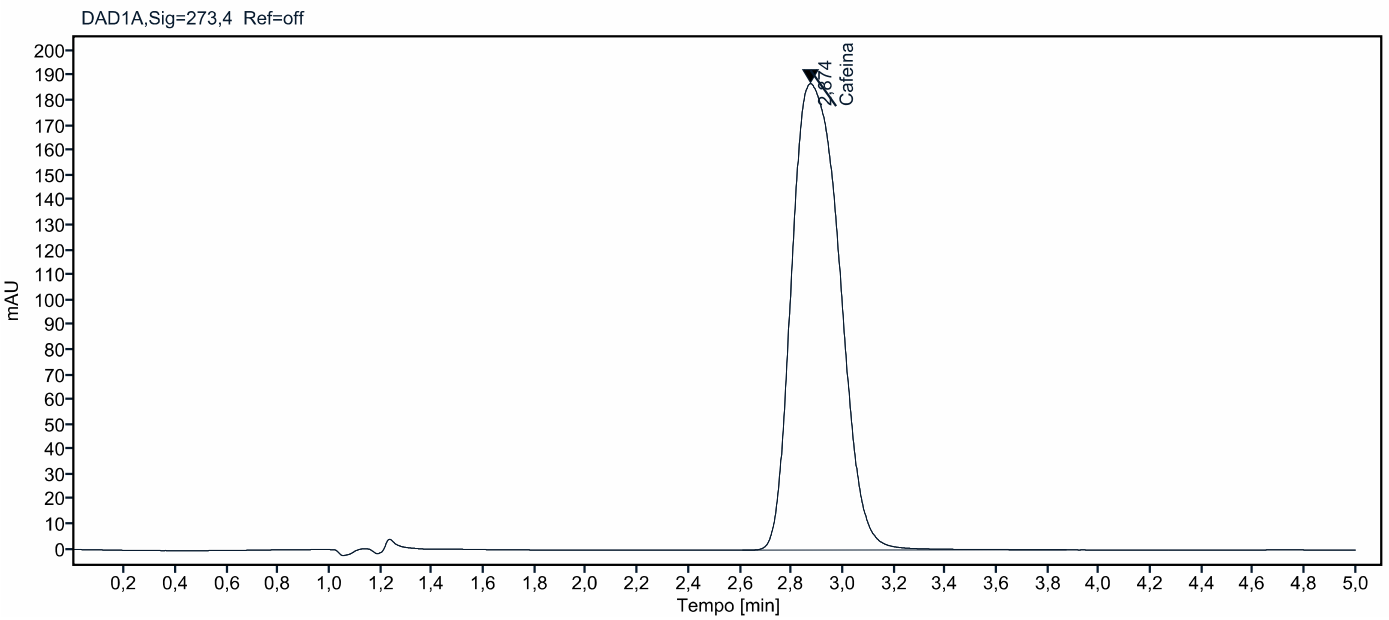

Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,874	2425,4326	187,109			Cafeina
Soma	**2425,4326**				

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Qualificação\Results\HPLC DAD 01-2025-10-30 09-41-38-03-00.rslt\LIIN 052025-10-30 11-35-52-03-00.dx
Nome da amostra: LIIN 05
Descrição:

Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P1-A6
Data da injeção:	2025-10-30 11:36:54-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2025-10-30 14:49:05-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:
Série #:

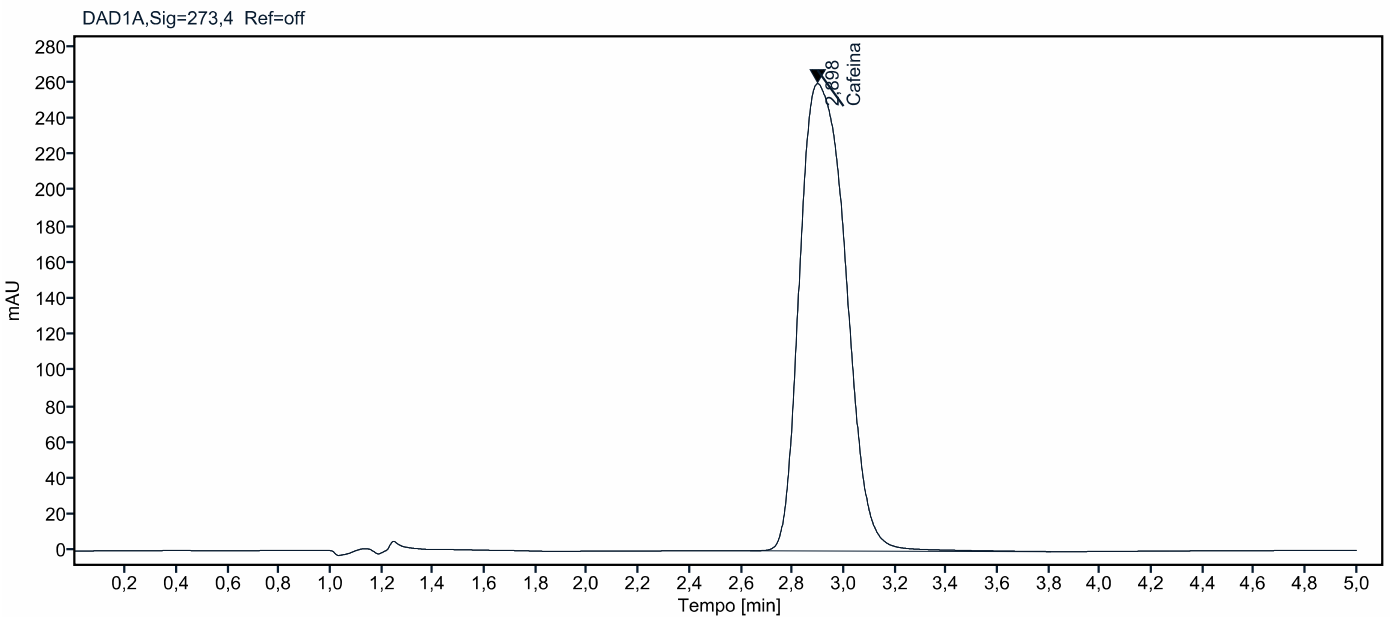


Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
2,898	3240,6661	259,584			Cafeina
Soma	**3240,6661**				

Certificado Nº:493/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/10/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**158,4400**

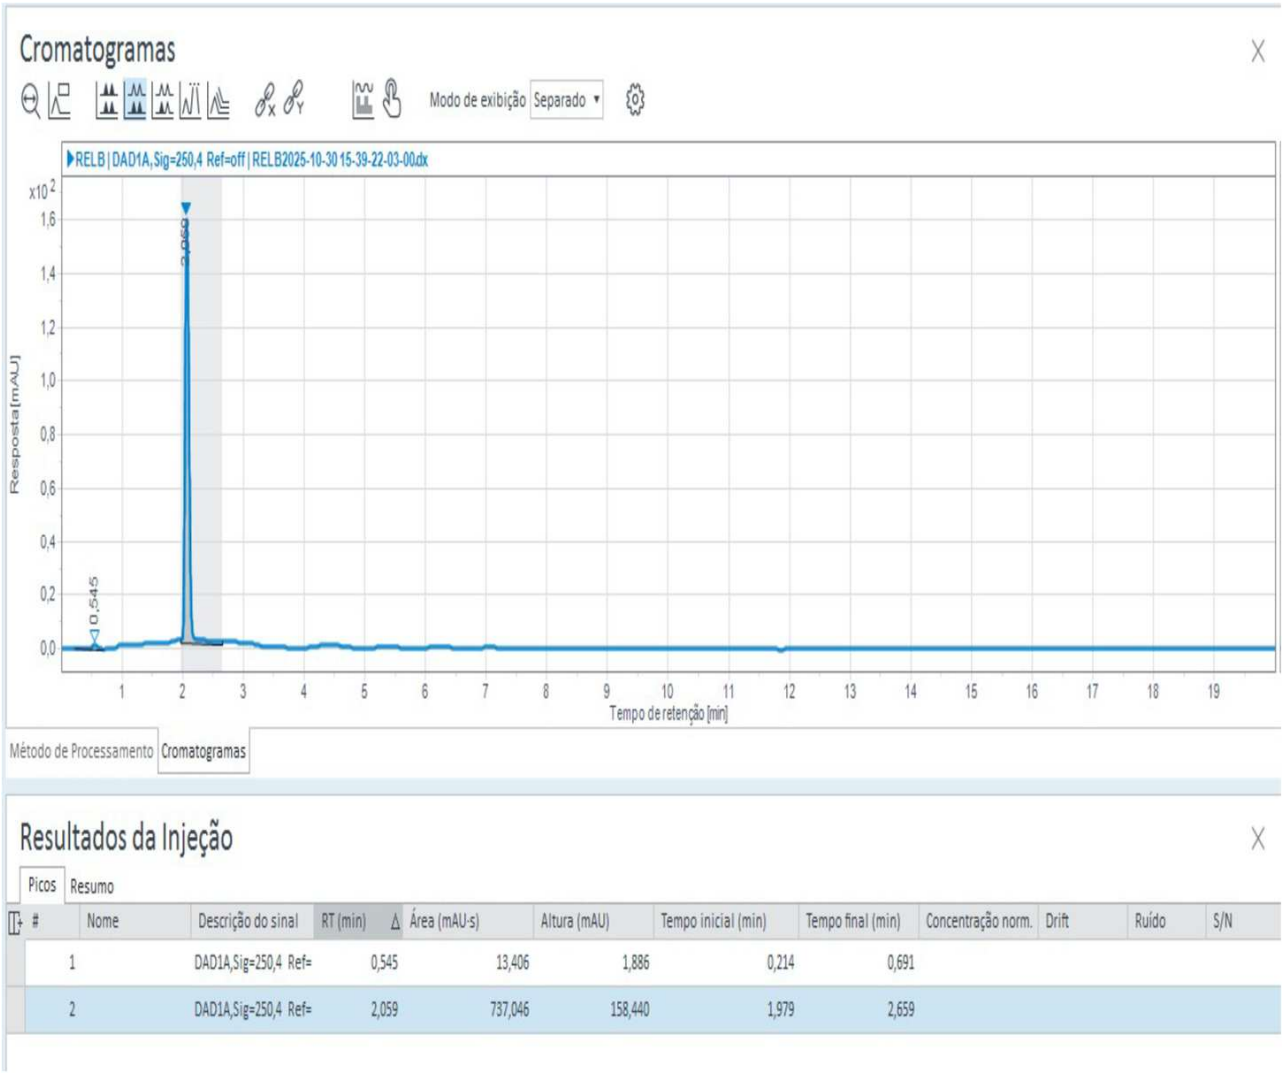

Resultados da Injeção

Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Tempo inicial (min)	Tempo final (min)	Concentração norm.	Drift	Ruído	S/N
1		DAD1A,Sig=250,4 Ref=	0,545	13,406	1,886	0,214	0,691				
2		DAD1A,Sig=250,4 Ref=	2,059	737,046	158,440	1,979	2,659				

Certificado Nº: 493/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/10/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído


Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,1300
VALOR MÍNIMO:	0,0900
	Ruído
	0,0400



Certificado Nº: 493/25 - RELB	Início da Qualificação: 29/10/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,1000	-0,1500
VALOR MÍNIMO:	0,1500	
Resultado:	-0,0500	

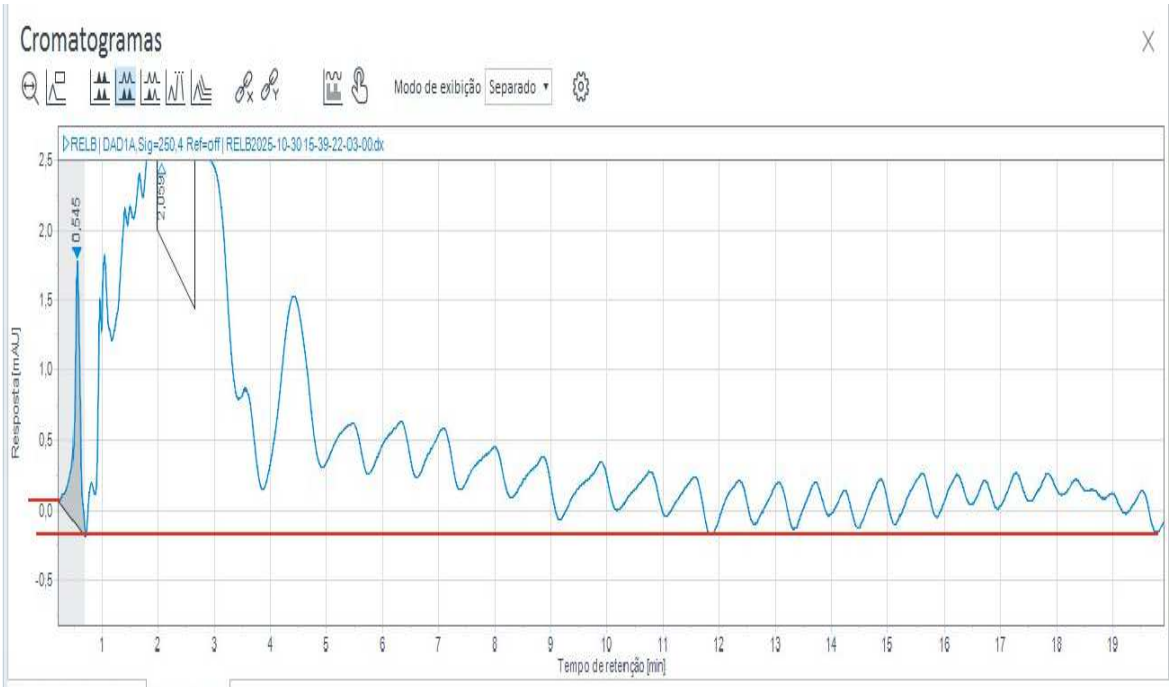

Resultados da Injeção

Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Tempo inicial (min)	Tempo final (min)	Concentração norm.	Drift	Ruído	S/N
1		DAD1A,Sig=250,4 Ref=	0,545	13,406	1,886	0,214	0,691				
2		DAD1A,Sig=250,4 Ref=	2,059	737,046	158,440	1,979	2,659				