




LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 190
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
(204, 2366,52275)
2000
1500
1000
200
220
240
260
280
300
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
MTD.docx [Some...
LB-453 - Agilent L...
Qualificação 2018
Sem título - Paint
EDUV 245.pdf - A...
PT
10:56
17/08/2018


LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 190
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
2000
1500
1000
(246, 924,047753)
200
220
240
260
280
300
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
MTD.docx [Some...
LB-453 - Agilent L...
Qualificação 2018
Sem título - Paint
PT
10:55
17/08/2018


LB-453 - Agilent Lab Advisor
Agilent Lab Advisor
Service & Diagnostics
Basic Version
Tasks
Spectral Scan
LB-453 » LB-453 » G1314F:DEABB13551
Lab Advisor
System Overview
Configuration
Apps
Firmware Update
Logs & Results
LB-453
Service & Diagnostics
Instrument Control
EMFs
System Report
Help
Context Help (F1)
Help Topics
What's New?
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
UV Lamp On
Blank Scan
Sample Scan
from 190
to 300
step 2
Export Data
Absorbance [mAU]
Spectral Scan - 1260 VWD [DEABB13551]
2000
1500
1000
(274, 1234,429239)
200
220
240
260
280
300
Wavelength [nm]
more...
Print Result
Back
Connection Address: 192.168.254.11
Version B.02.06 [122] - Basic | Licenses 4/10
MTD.docx [Some...
LB-453 - Agilent L...
Qualificação 2018
PT
10:54
17/08/2018

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\Branco PCIN 001.dat
Usuário: SYSTEM (SYSTEM)
Adquirido: 17/08/2018 11:13:12 (GMT -03:00)
Impresso: 17/08/2018 12:01:02 (GMT -03:00)

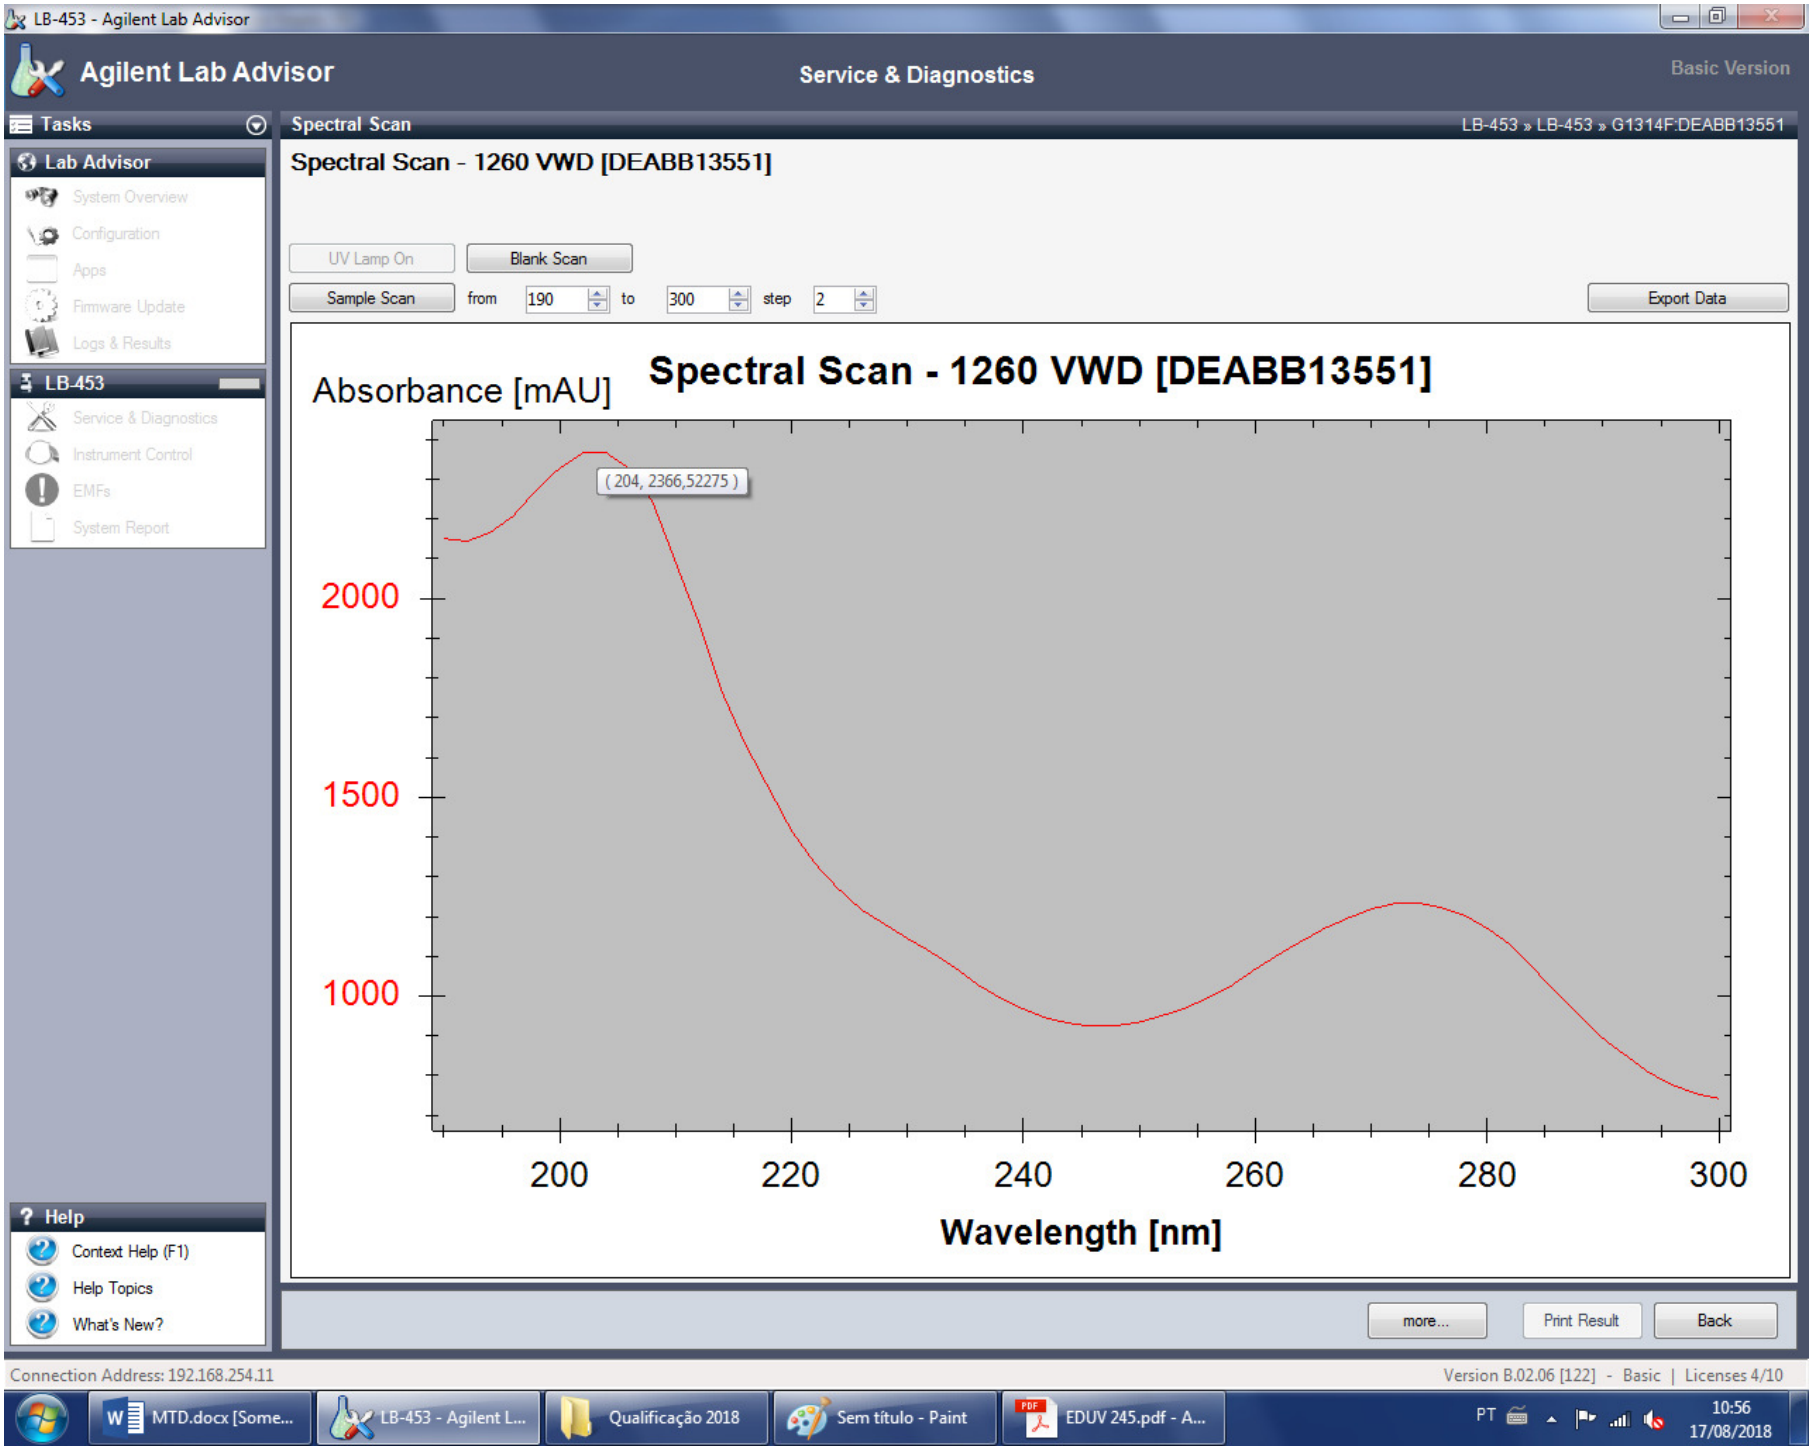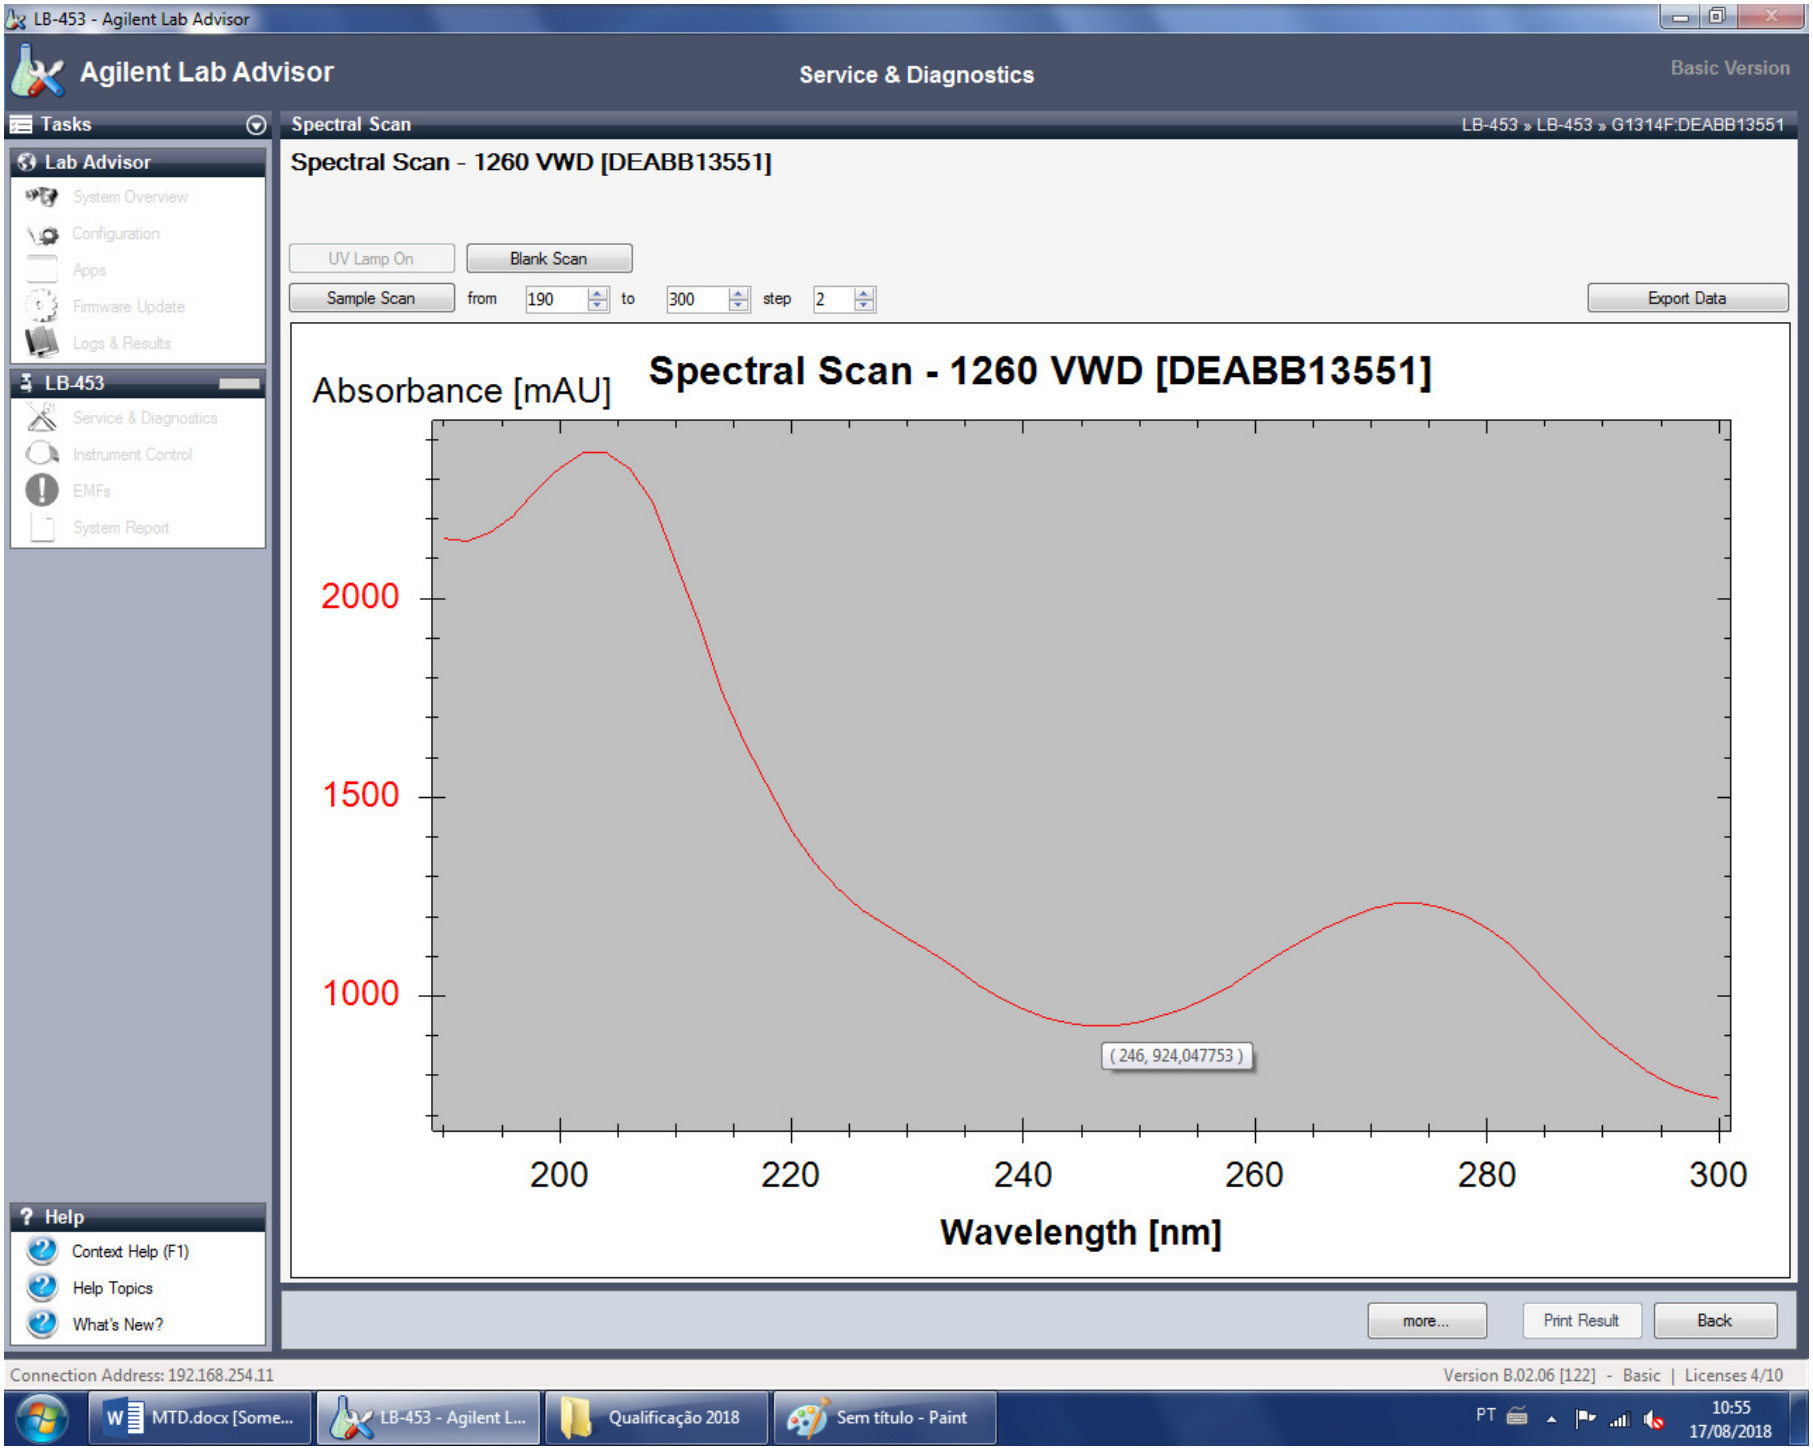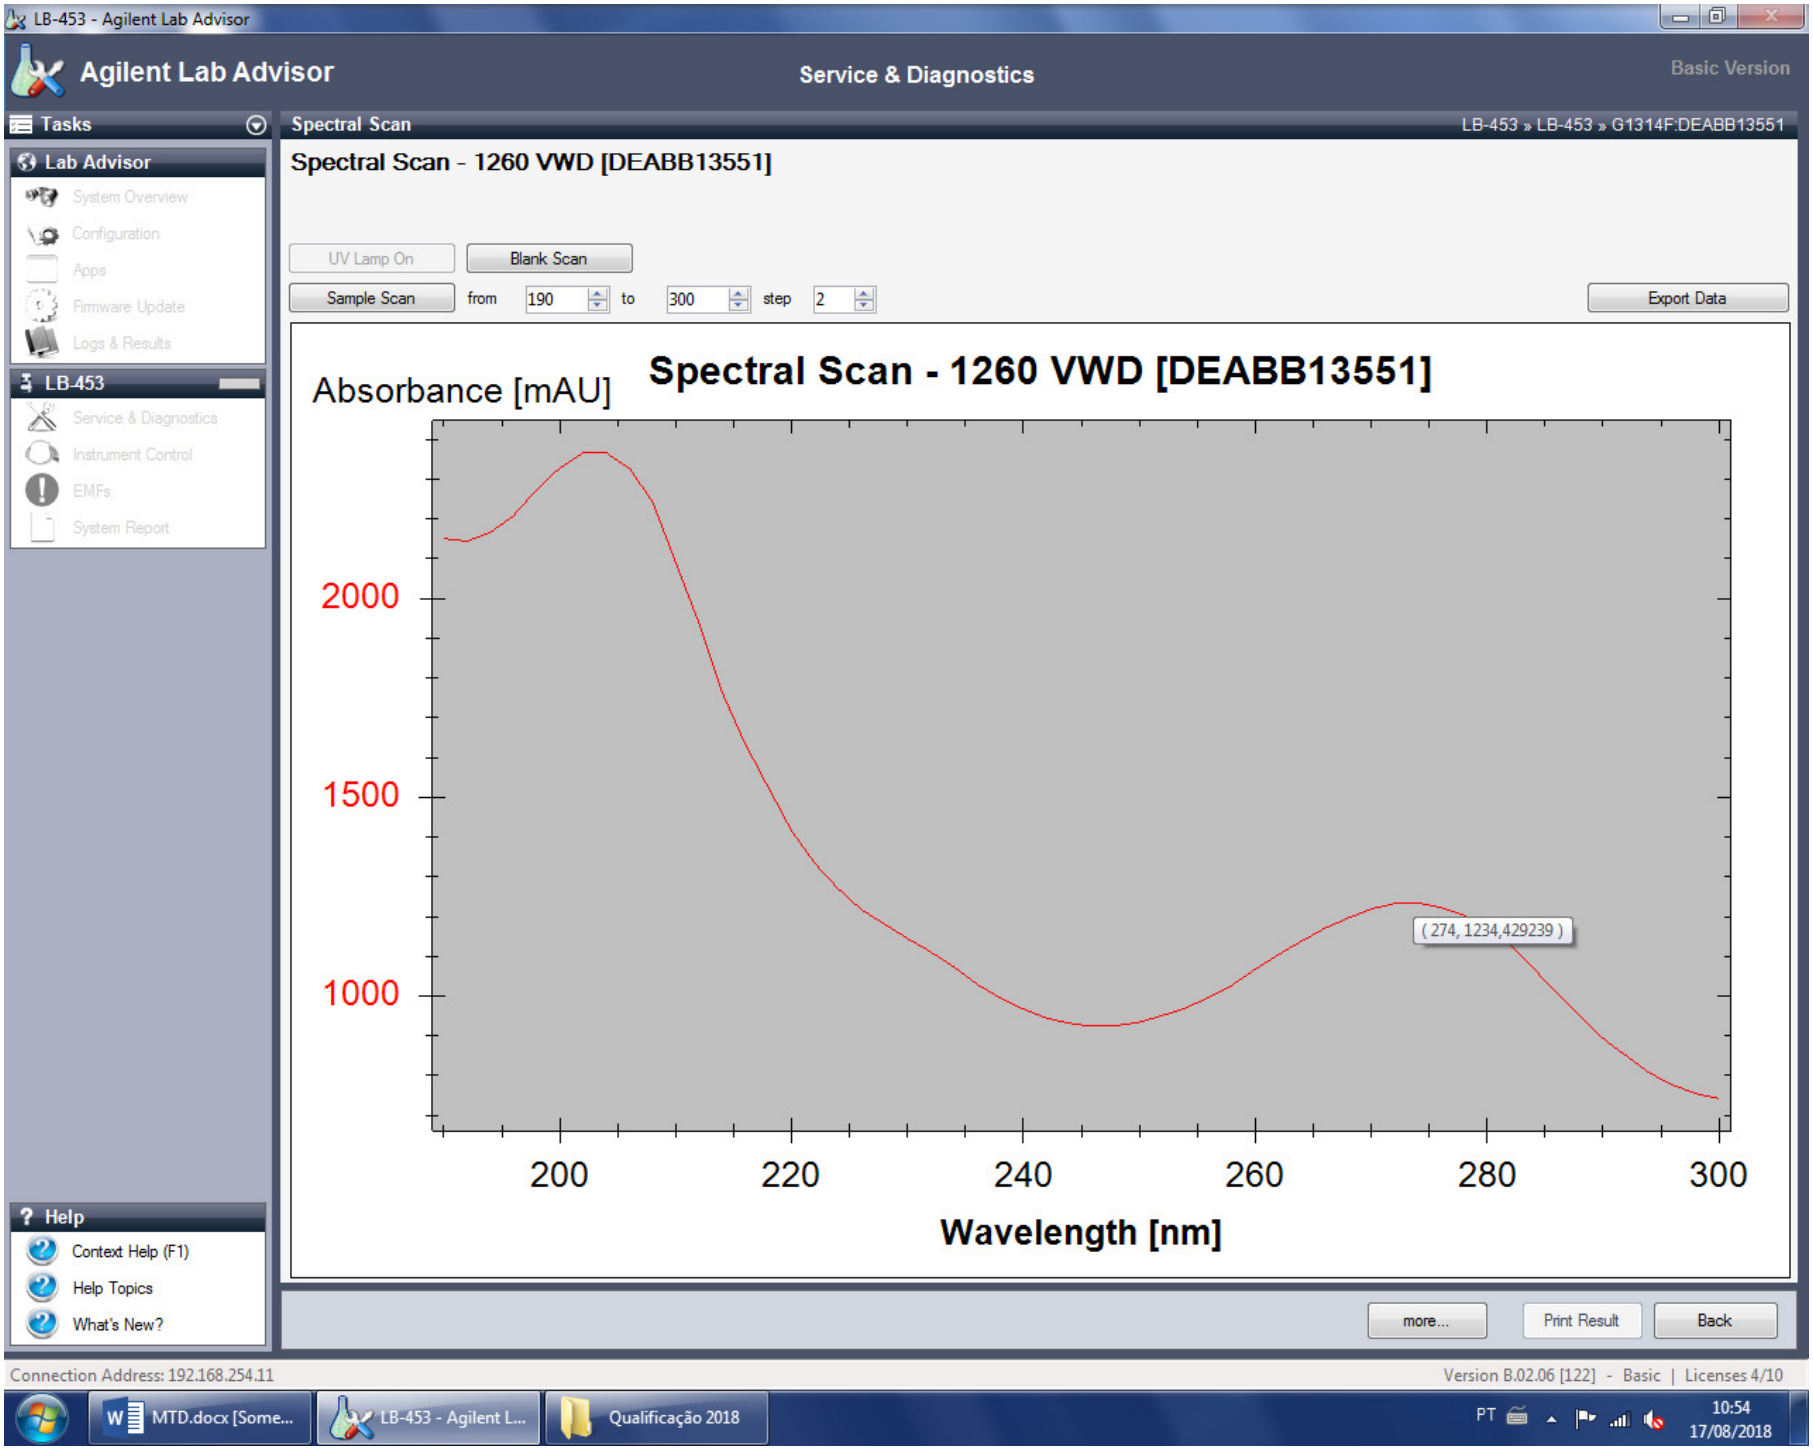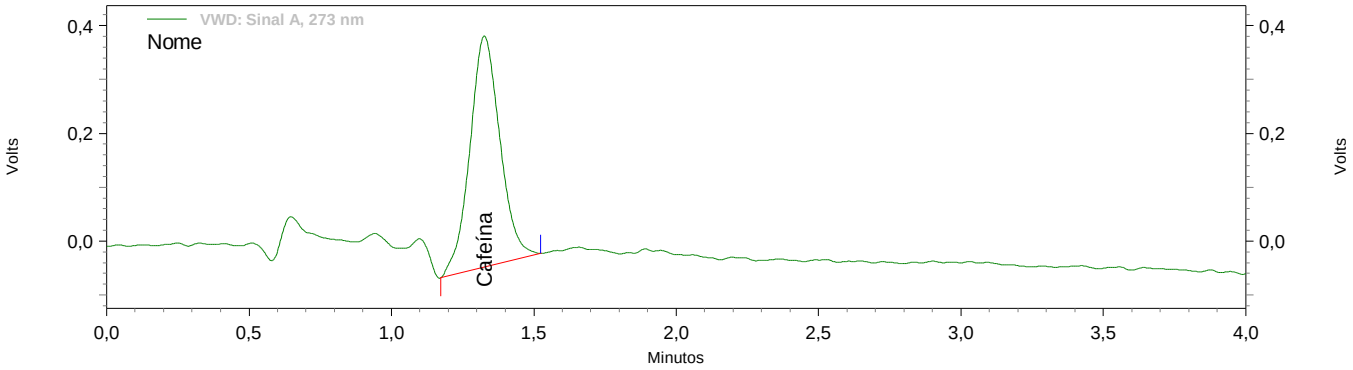


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,327	52874	**0,000**

Totais			52874	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 001.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:17:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:04 (GMT -03:00)**

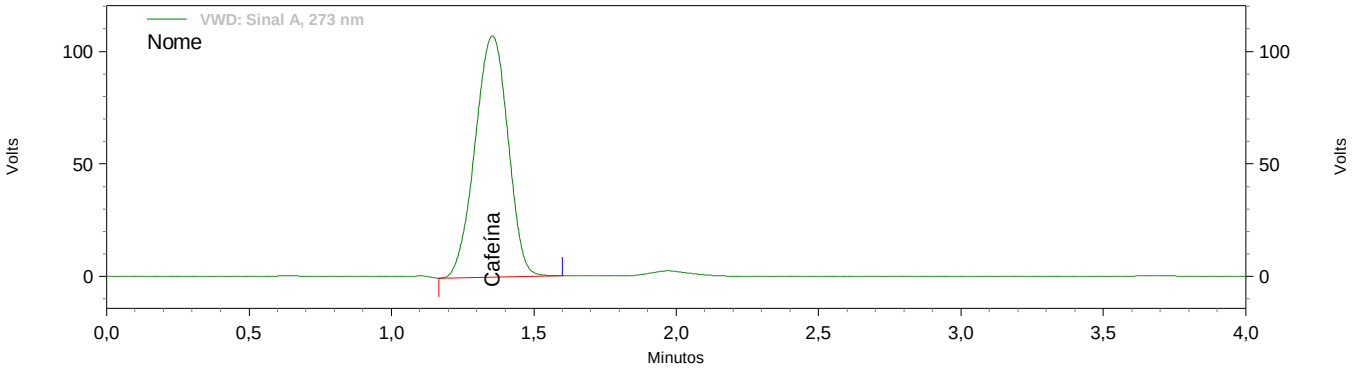


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	14451641	**0,000**

Totais			14451641	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 002.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:22:16 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:06 (GMT -03:00)**

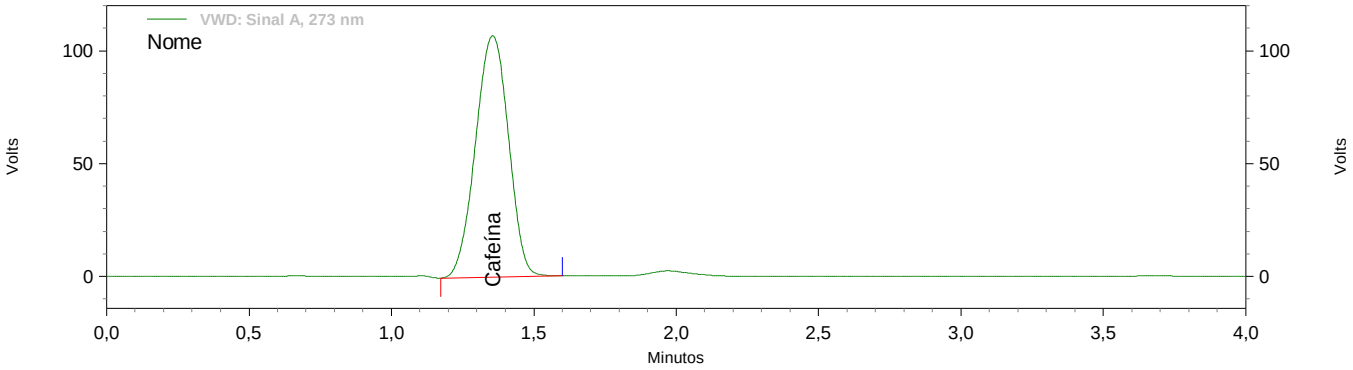


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,357	14472613	**0,000**

Totais			14472613	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 003.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:27:07 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:08 (GMT -03:00)**

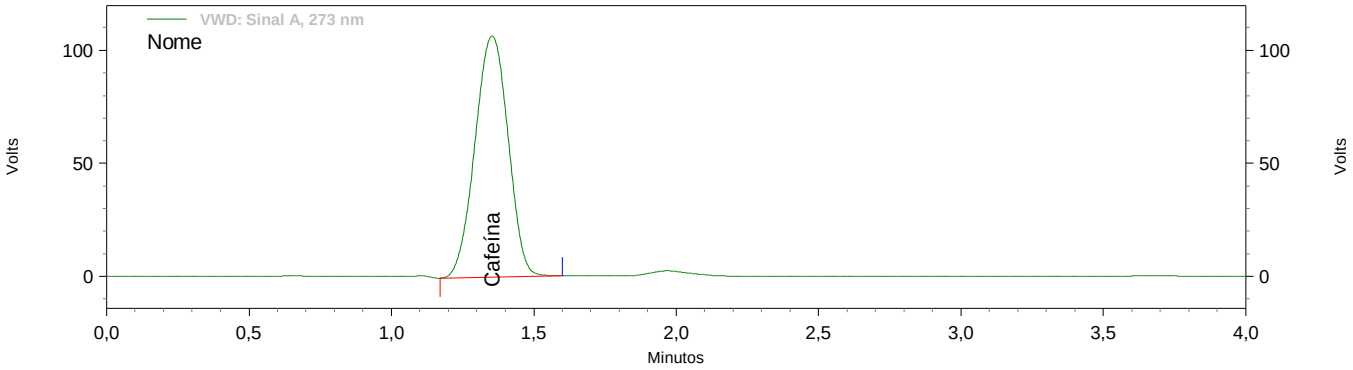


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	14470845	**0,000**

Totais			14470845	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\Branco PCIN 002.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:32:05 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:10 (GMT -03:00)**

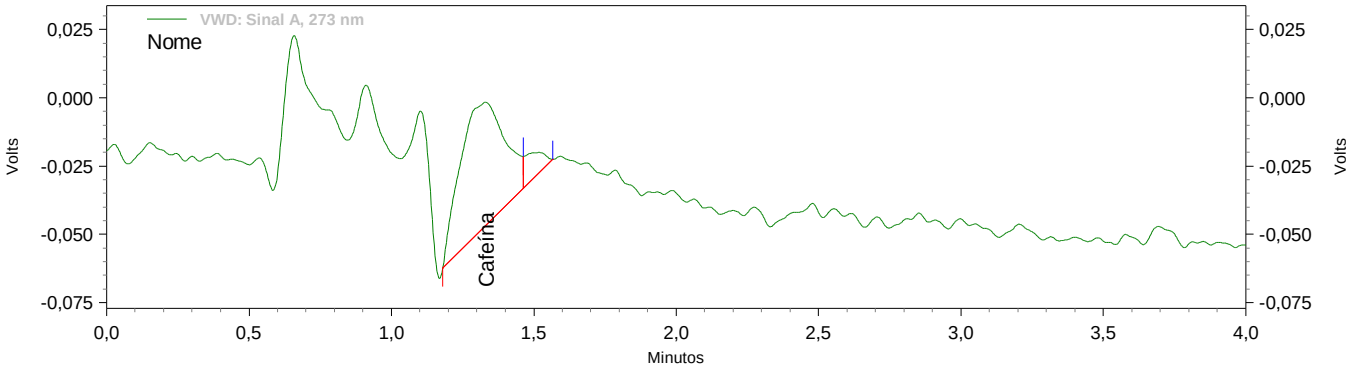


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,333	8510	**0,000**

Totais			8510	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 004.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:37:01 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:11 (GMT -03:00)**

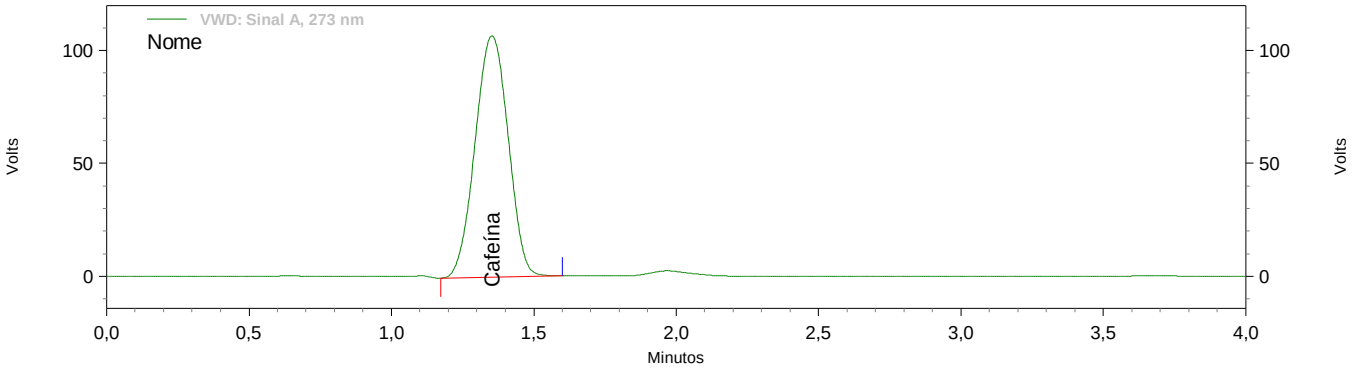


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	14478763	**0,000**

Totais			14478763	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 005.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:42:00 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:13 (GMT -03:00)**

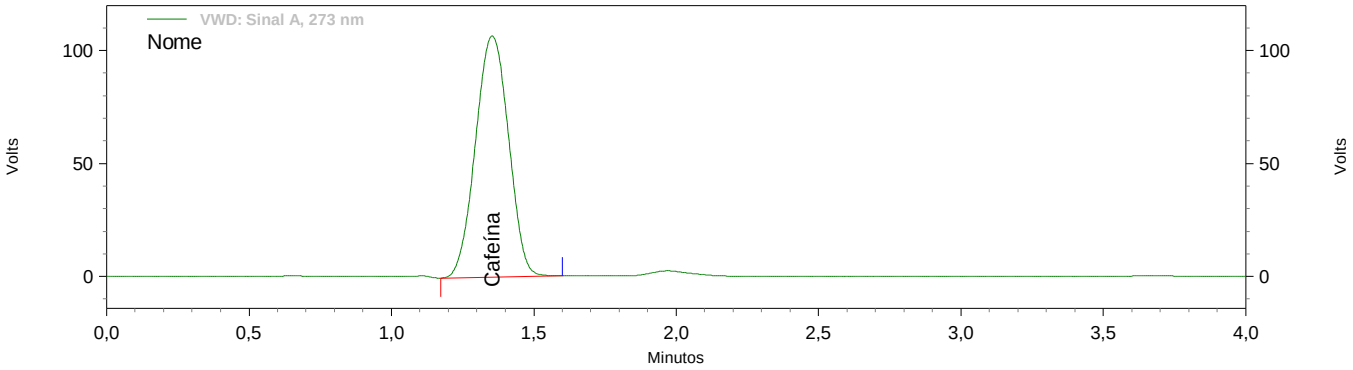


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	14469125	**0,000**

Totais			14469125	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\PCIN 006.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:46:59 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:15 (GMT -03:00)**

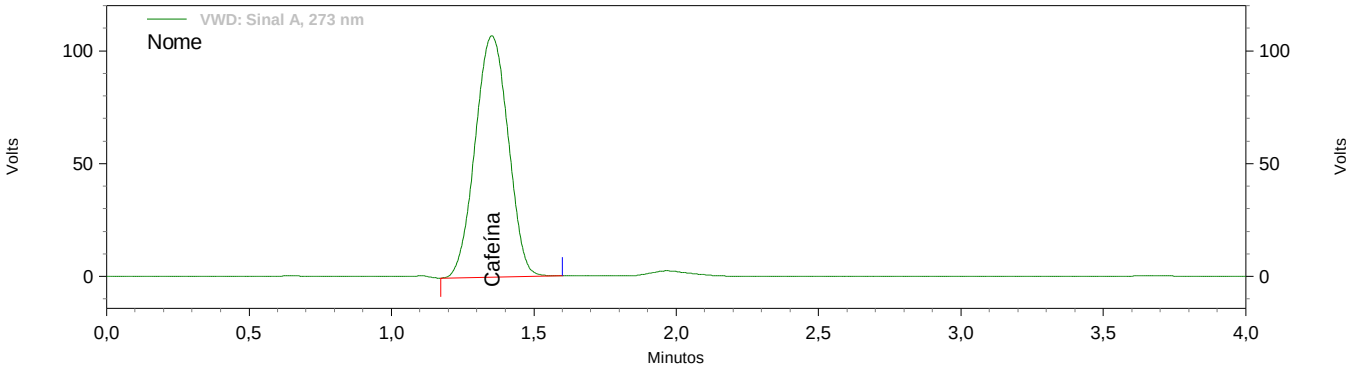


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	14467761	**0,000**

Totais			14467761	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\PCIN.rslt\Branco PCIN 003.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 11:51:59 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 12:01:17 (GMT -03:00)**

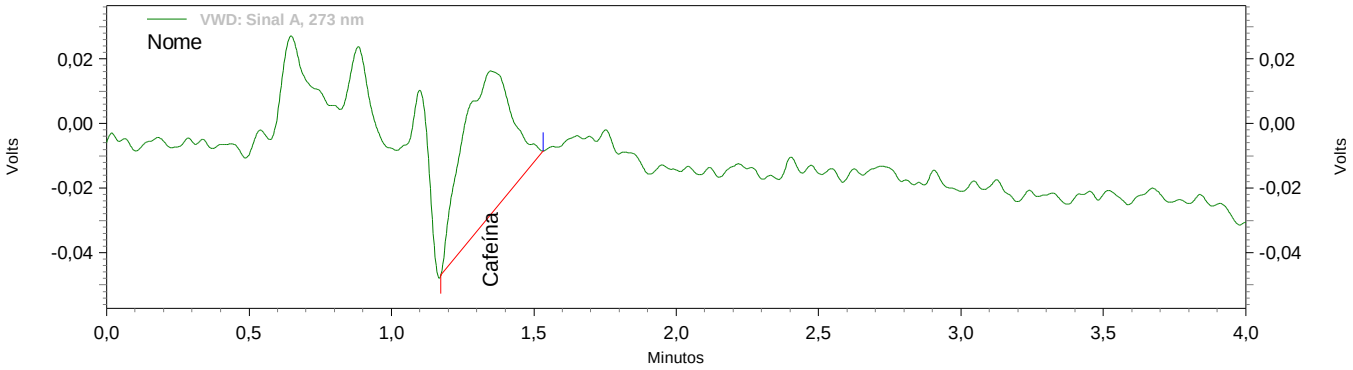


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,347	9332	**0,000**
Totais			9332	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LDUV 002.rslt\LDUV 001.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:37:56 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:03:41 (GMT -03:00)**

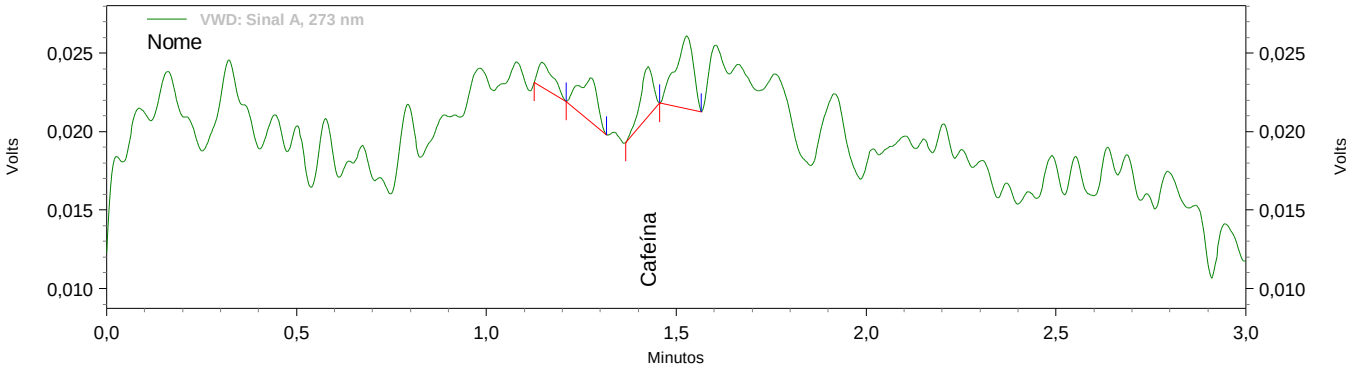


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
3	Cafeína	1,427	127	**0,000**

Totais			127	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LDUV 002.rslt\LDUV 002.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:41:57 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:03:43 (GMT -03:00)**

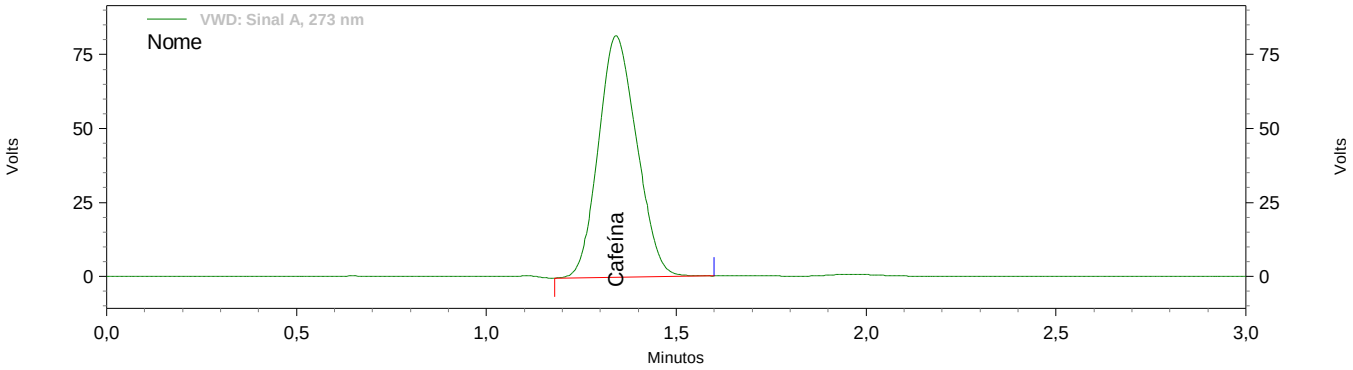


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,340	9588419	**0,000**

Totais			9588419	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LDUV 002.rslt\LDUV 003.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:45:58 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:03:44 (GMT -03:00)**

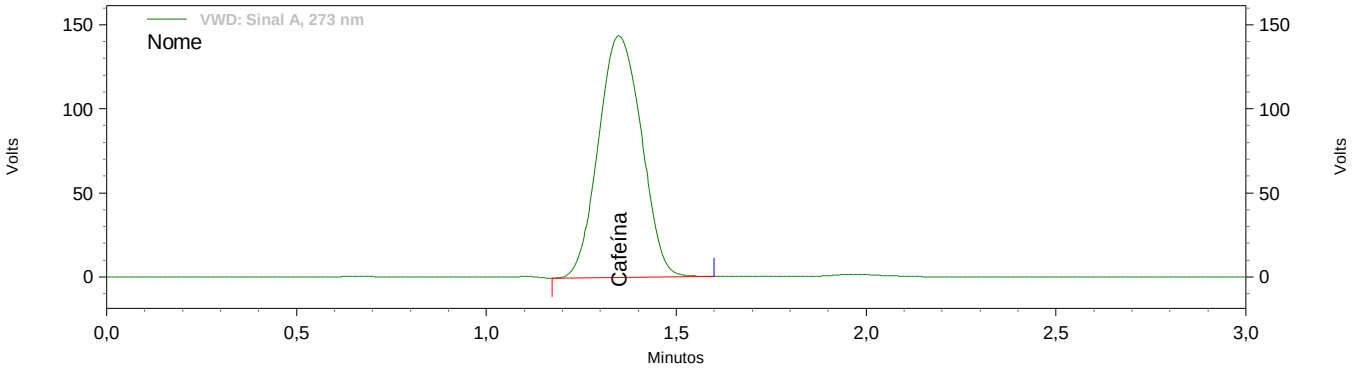


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,350	18981260	**0,000**

Totais			18981260	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LDUV 002.rslt\LDUV 004.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:49:59 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:03:46 (GMT -03:00)**

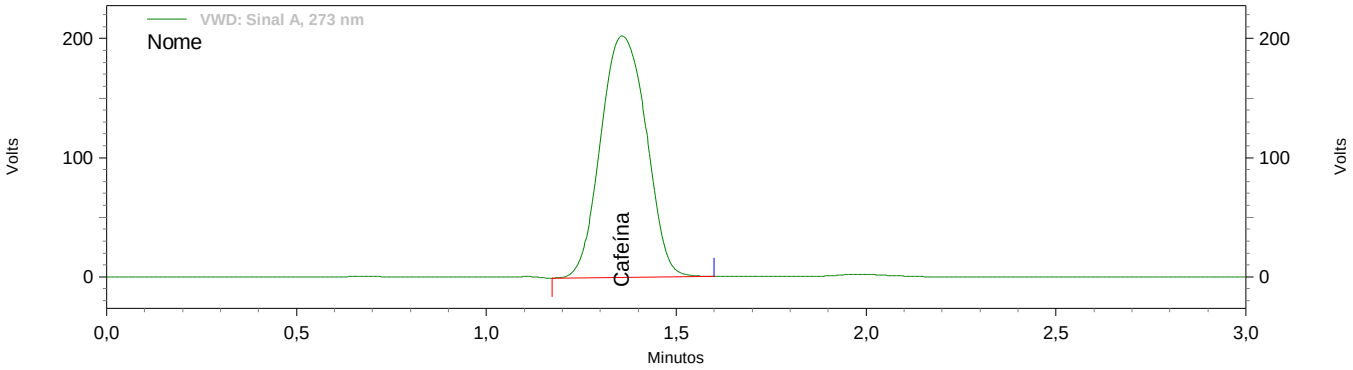


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,357	28340559	**0,000**

Totais			28340559	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LDUV 002.rslt\LDUV 005.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:54:03 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:03:47 (GMT -03:00)**

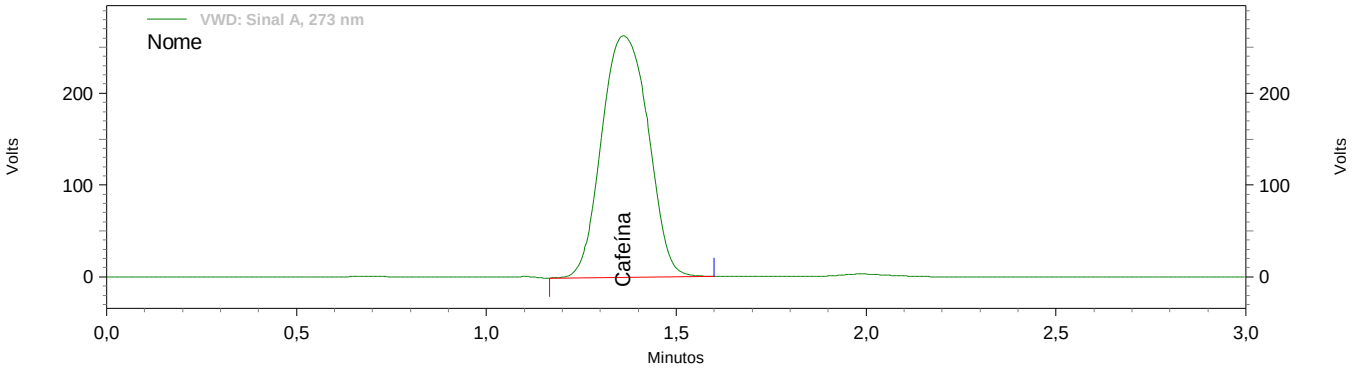


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,360	37714691	**0,000**

Totais			37714691	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LIIN 002.rslt\LIIN 001.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 13:57:37 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:21:33 (GMT -03:00)**

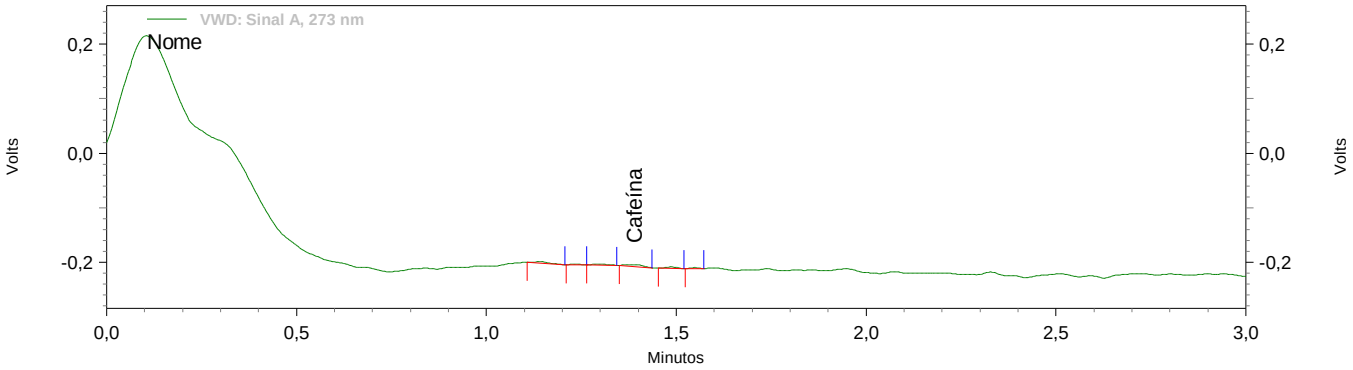


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
4	Cafeína	1,390	166	**0,000**

Totais			166	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LIIN 002.rslt\LIIN 002.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 14:01:42 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:21:35 (GMT -03:00)**

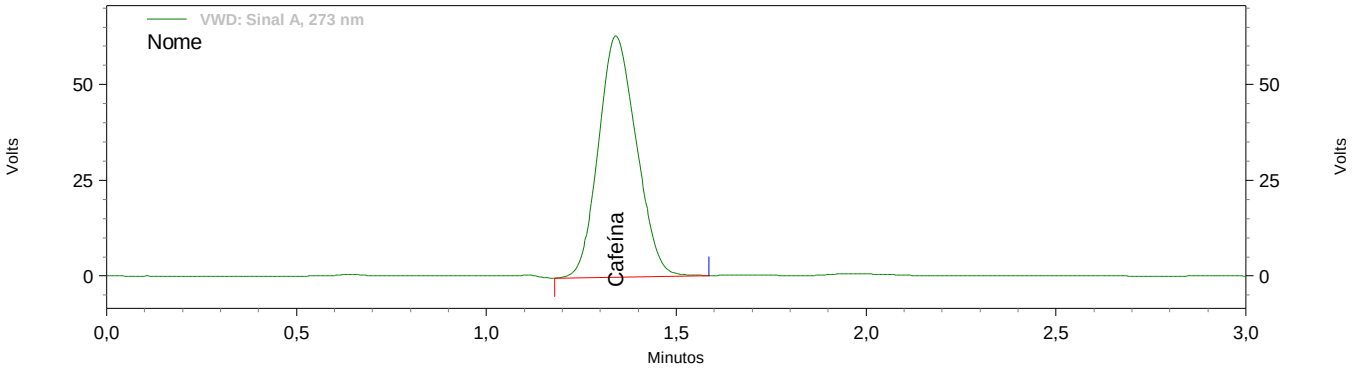


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,340	7299012	**0,000**

Totais			7299012	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LIIN 002.rslt\LIIN 003.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 14:05:39 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:21:36 (GMT -03:00)**

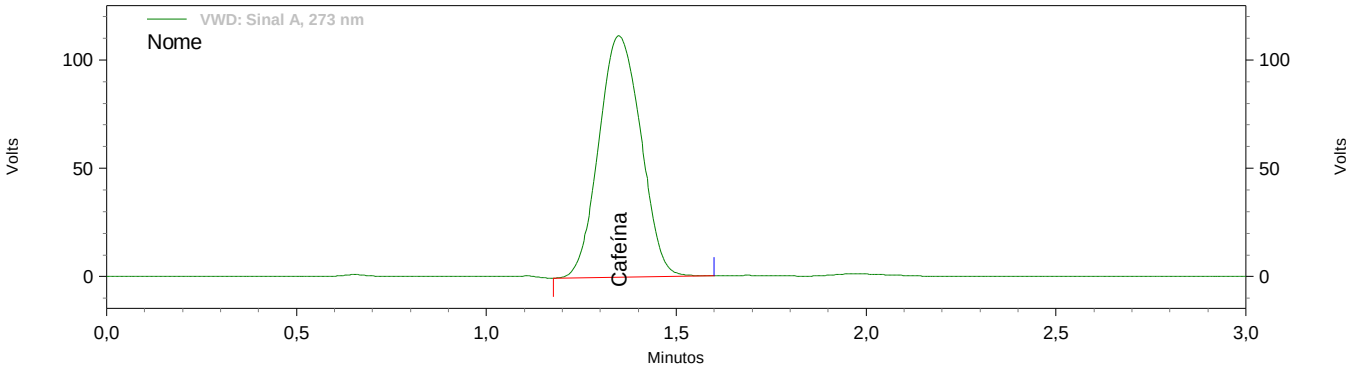


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,350	14390646	**0,000**

Totais			14390646	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LIIN 002.rslt\LIIN 004.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 14:09:40 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:21:38 (GMT -03:00)**

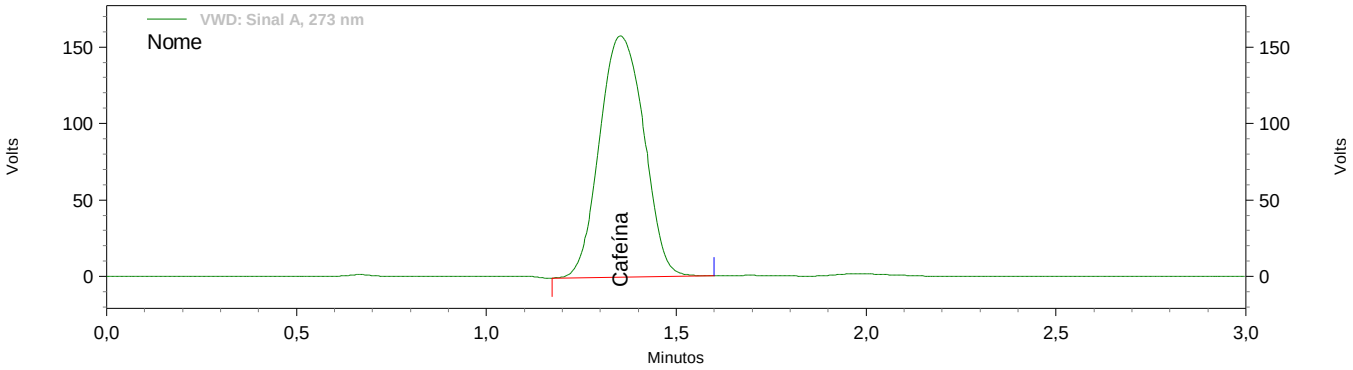


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,353	21487016	**0,000**

Totais			21487016	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Qualificação.met**
Data: **C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\LIIN 002.rslt\LIIN 005.dat**
Usuário: **SYSTEM (SYSTEM)**
Adquirido: **17/08/2018 14:13:46 (GMT -03:00)**
Impresso: **17/08/2018 14:21:40 (GMT -03:00)**

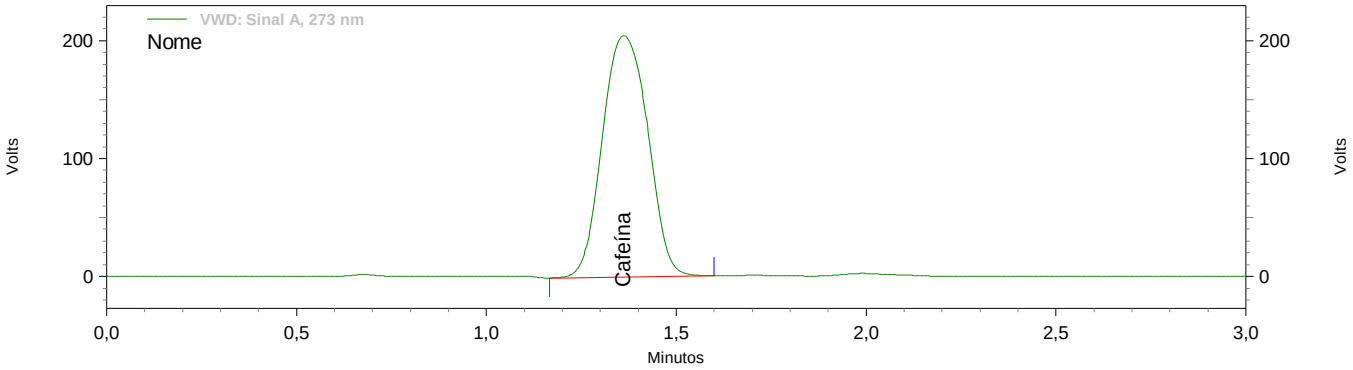


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Concentração ESTD*
1	Cafeína	1,360	28584155	**0,000**

Totais			28584155	**0,000**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Grad AB.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\GRAD.rslt\Grad AB 001.dat
Usuário: SYSTEM (SYSTEM)
Adquirido: 17/08/2018 14:41:38 (GMT -03:00)
Impresso: 17/08/2018 15:17:19 (GMT -03:00)

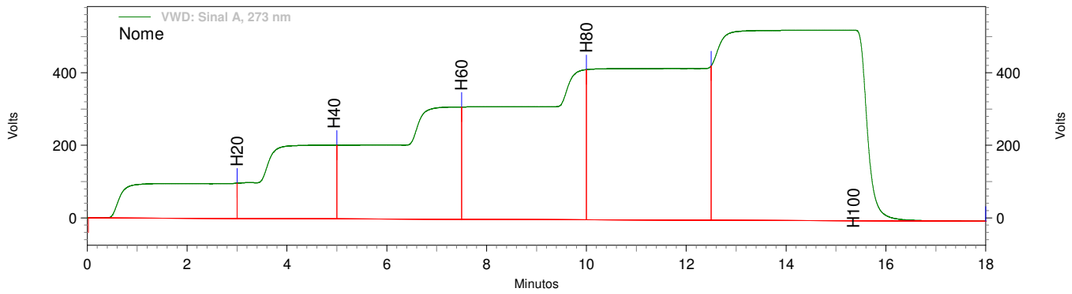


Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	H20	2,997	225919021	**1633434**
2	H40	4,943	340137255	**3406832**
3	H60	7,497	603570427	**5192428**
4	H80	9,997	819519111	**6942407**
6	H100	15,350	1645799726	**8808043**

Totais			3634945540	**25983144**

Relatório de Padrão Externo

Nome do Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\Grad CD.met
Data: C:\Enterprise\Projects\Qualificação 2018\GRAD.rslt\Grad CD 001.dat
Usuário: SYSTEM (SYSTEM)
Adquirido: 17/08/2018 15:00:01 (GMT -03:00)
Impresso: 17/08/2018 15:27:00 (GMT -03:00)

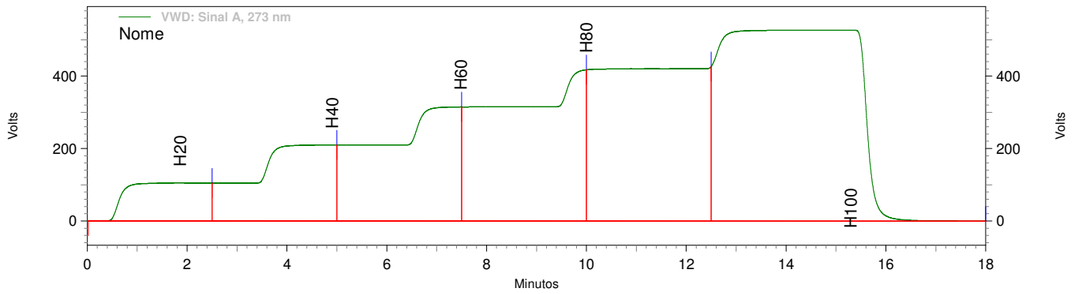

Resultados VWD:
Sinal A, 273 nm

Número do Pico	*Nome*	*Tempo de Retenção*	*Área*	*Altura*
1	H20	1,863	195129722	**1761647**
2	H40	4,907	406588651	**3522292**
3	H60	7,487	618595264	**5286706**
4	H80	9,997	831290912	**7006449**
6	H100	15,293	1654890509	**8841083**

Totais			3706495058	**26418177**